

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-00  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922) 49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)59-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-19-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Surgut (3462)77-98-35  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://biosan.nt-rt.ru> || [bnj@nt-rt.ru](mailto:bnj@nt-rt.ru)

# КАТАЛОГ



На протяжении **более 29 лет миссия BIOSAN** остаётся неизменной — снижение рисков пробоподготовки путем предложения линеек лабораторного оборудования на основе самых передовых научных и производственных технологий.

**Каталог 2021-2022 г.** представляет широкий спектр лабораторного оборудования для осуществления как наиболее простых этапов пробоподготовки таких как перемешивание, встряхивание, центрифугирование, термостатирование, так и для реализации более комплексных и сложных этапов – культивирование микроорганизмов, выделение нуклеиновых кислот, а также аналитические приборы.

Для Вашего удобства мы создали ряд описаний рабочих процессов, которые, мы надеемся, помогут вам выбрать наиболее подходящий продукт. ИФА, экстракция и амплификация нуклеиновых кислот, культивирование микробных клеток - это лишь некоторые из них. Мы предлагаем широкий спектр лабораторного оборудования: от пипеток **Assist** до автоматических промывателей планшетов для ИФА **3D-IW8**, от магнитной стойки **MagSorb-16** для выделения нуклеиновых кислот до системы автоматизированного 12 канального выделения нуклеиновых кислот **Biomagpure 12 Plus**. Наши устройства, как например, прибор для ПЦР в реальном времени **Bioquant 96** или фотометр для микропланшетов **HiPo MPP-96** для ИФА, позволят вам правильно и эффективно подготовить образец и предоставить вам надежные результаты.

Модели приборов постоянно совершенствуются в соответствии с пожеланиями и замечаниями наших клиентов. Особое внимание уделяем показателям надежности, эргономичности и удобству в эксплуатации.

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ

Мы сконцентрированы на решениях проблем воспроизводимости экспериментальных данных. Отсутствие строгого регламента пробоподготовки биоматериала приводит к наибольшему количеству ошибок при реализации методики.

### Ошибки накапливаются в связи с:

1. Существенным уменьшением объемов реактантов (с миллилитров до микролитров);
2. Отсутствием промежуточной температурной логистики технологического процесса (температурная полка);
3. Особенности перемешивания микроколичеств реагентов;
4. Отсутствием систем дезактивации воздуха лабораторий в процессе работы;
5. Не регламентированным способом хранения клеточного материала.

Мы предлагаем решения для пробоподготовки только после того, как сами убедимся, что они являются идеальными для устранения вышеобозначенных ошибок.

## МИР БИОТЕХ-ИННОВАТИКИ

Мы продолжаем развивать планетарную модель Мира БИОТЕХ-ИННОВАТИКИ и готовы предложить Вам новое, уникальное оборудование.

На орбитале **Cellomica** появился **CO<sub>2</sub> инкубатор S-Bt Smart Biotherm**, созданный для работы с клеточными культурами, где необходимо поддержание заданной концентрации углекислого газа, температуры и относительной влажности. Специально для инкубатора разработан встраиваемый шейкер **CPS-20**, при этом модуль управления вынесен из камеры инкубатора наружу, что обеспечивает продолжительную работу шейкера в агрессивной среде угольной кислоты, которая образуется из-за смешивания CO<sub>2</sub> и водяного пара внутри инкубатора.

Такие уникальные устройства, как персональные биореакторы **Reverse-Spinner RTS-1, RTS-1C** стали популярными инструментами в среде ученых-микробиологов. Биореакторы обеспечивают не только необходимые условия для воспроизводимого биопроцесса, но и неинвазивную регистрацию удельной скорости роста культуры клеток в реальном режиме времени.

Разработано следующее поколение биореакторов типа **Reverse-Spinner – RTS-8/RTS-8 plus**. Эти биореакторы могут осуществлять параллельное культивирование в 8 одноразовых пробирках одновременно. Совместно с немецкой компанией Presens GmbH мы предлагаем модель биореактора RTS-8 plus с неинвазивным измерением pH, концентрации кислорода в процессе культивирования.

В линейке денсиметров DEN появился новый фотометр **DEN-600**. Это компактный настольный прибор для измерения оптической плотности с длиной волны 600 нм, рассчитанный на работу либо от источника питания, либо от встроеной аккумуляторной батареи. Прибор имеет отличные технические характеристики для проведения измерений. Подключение по USB позволяет передавать данные на ПК для последующего анализа.

## ВИДЕНИЕ

Мы планируем продолжать наше постоянное совершенствование, чтобы оставаться Вашим партнером и экспертом как в научных исследованиях Life Science, так и медицинской диагностике. Это позволит нам разрабатывать новые перспективные продукты, оставаясь в одном ряду с ведущими мировыми биоинженерными компаниями. Мы будем искренне рады, если продукция BIOSAN заинтересует Вас. Благодарим за сотрудничество!

Василий Банковский,  
Доктор Биологических наук,  
Президент фирмы BIOSAN



# Концепция «Мира Биотех-инноватики»

*«Большинство замечательных инноваций  
возникли в результате взаимодействия  
творческих личностей с командами, которым  
удалось реализовать их идеи».*

— Уолтер Айзексон



Василий Банковский, доктор биологии, директор по научным разработкам, председатель правления Биосан

«**Мир Биотех-инноватики**» отображен в виде планетарных систем со спутниками — приборы, вращающиеся вокруг Terra Innovatica (исследуемого биоматериала). Мы выделили четыре планетарных системы — 4 современных уровня диагностики:

- 1. Terra Genomica** — диагностика на геномном уровне (ДНК-анализ, олигонуклеотидный и мононуклеотидный полиморфизм — ONP, SNP).
- 2. Terra Immunologica** — диагностика на иммунологическом уровне (выявление полиморфизма антител и иммунного ответа).
- 3. Terra Biochemica (метабономика)** — диагностика продуктов метаболизма и активности ферментов.
- 4. Terra Cellomica** — диагностика на уровне клеточного морфогенеза (клеточный полиморфизм).

Расстояние от орбиталей планет до Terra Innovatica соответствует времени выявления болезни на каждом уровне (от недели, как в случае ДНК-анализа, до нескольких лет, когда изменения можно проследить на клеточном уровне). Но в силу генетической природы большинства заболеваний человека, животных, растений, затрагивающей впоследствии иммунный ответ (защитная реакция) и изменение биохимического статуса, а затем и клеточный морфогенез, мы полагаем целесообразным одновременно многоуровневую диагностику. Поскольку полиморфизм на геномном уровне приводит к экспрессии полиморфизма на всех более высоко стоящих уровнях, возникает двусмысленность (если не более) любого принимаемого на основе полученных данных решения. Нет еще определения понятия полиморфизма нормы и патологии (болезни), и потому единственный хотя и дорогостоящий, на сегодня выход — мультидиагностическая технология. Классический детерминизм в диагностике наконец-то уступил место стохастическому, но инструментов, переносящих наше новое знание в русло взвешенных и однозначных решений, пока еще нет. Такова реальность, такова временная жатва прогресса. Биосан — единственная компания в «**Мире Биотехномики**»,

которая разрабатывает, производит и распространяет линейки инструментов для всех 4 уровней диагностики. Это спутники 4 планет — специализированные приборы, обеспечивающие инструментальную базу многоуровневой диагностики, наборы же реагентов приводят в движение эти спутники. Следовательно, под биотехномикой мы подразумеваем направление Биотехнологии, развивающее наборы (линейки инструментов) для реализации многоуровневой лабораторной диагностики. С развитием чиповых технологий в перспективе могут появиться мульти-диагностические чипы, реализующие все вышеуказанные технологии в одном чипе.

С удовлетворением хочу отметить, что многие наши идеи и продукты появились в результате многолетнего сотрудничества ученых Института микробиологии АН Латвии (где 29 лет назад возникла наша фирма и где ныне она располагается) с университетами, а также академическими и прикладными институтами стран СНГ и России. Все наши разработки являются результатом совместных усилий, и мы открыты для сотрудничества. Будем рады, если результат этой деятельности, уже получивший широкое признание научного сообщества, также заинтересует и Вас, в особенности если он послужит очередной отправной точкой для развития инновационных биотехнологий и появления новых планет и их спутников на небосводе «**Мира Биотехномики**».

# Концепция «Мира Биотех-инноватики»

## TERRA CELLOMICA

Диагностика на уровне клеточного морфогенеза (клеточный полиморфизм).

## TERRA BIOCHEMICA (metabolomics)



Диагностика на уровне продуктов метаболизма и биохимической активности ферментов.

## TERRA IMMUNOLOGICA

Диагностика на иммунологическом уровне (выявление полиморфизма антител и иммунного ответа);

## TERRA GENOMICA

Диагностика на геномном уровне (ДНК-анализ, секвенирование олигонуклеотидный и мононуклеотидный полиморфизм — ONP, SNP);

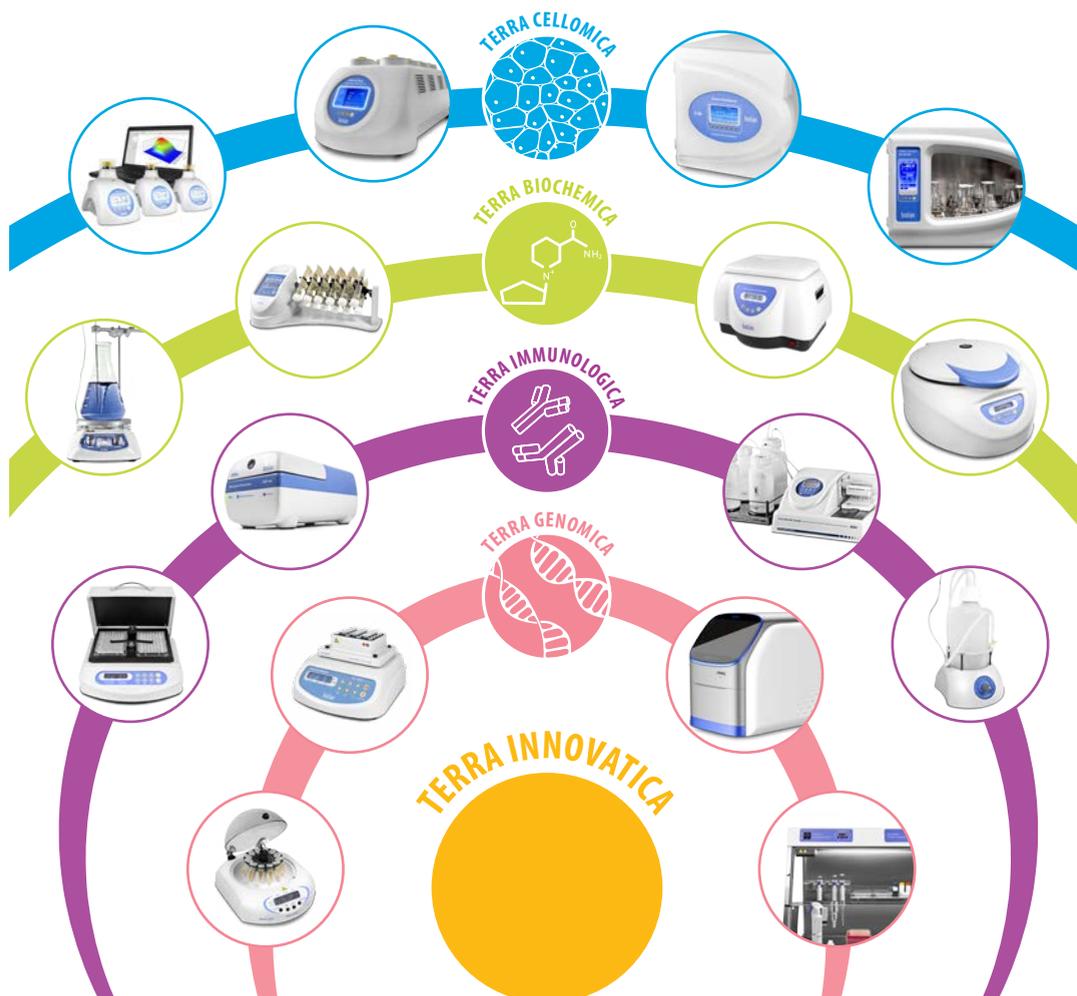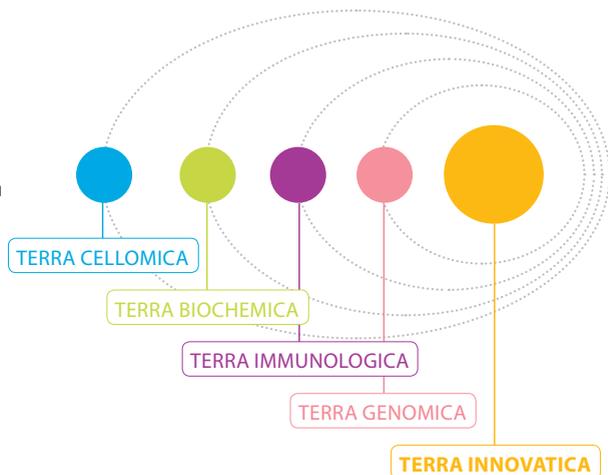

## НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И АНОНСЫ

### НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

**Линейка приборов COVID-19**  
**Фотометр:** DEN-600  
**Параллельные биореакторы:** RTS-8, RTS-8 Plus  
**Шейкер-инкубатор:** ES-20/80  
**Система ПЦР в реальном времени:** BioQuant-96  
**CO<sub>2</sub> шейкер:** CPS-20  
**CO<sub>2</sub> инкубатор:** S-Bt Smart BioTherm  
**Термошейкер:** TS-100C Smart  
**Полки для UV боксов:** P-5, F-1  
**Двухсторонний клеевой коврик:** SPML, SPM  
**Раствор для дезактивации ДНК/РНК, 10 л:** PDS-10

### АНОНСЫ

**Шейкер-инкубатор с охлаждением:** ES-20/80C  
**Центрифуга:** LMC-56  
**Гомогенизатор:** RCP-24

### МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

**Денситометр:** DEN-1

### ОБНОВЛЁННОЕ ПО

**Фотометр для микропланшетов:** HiPo MPP-96

## ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### РОКЕРЫ, ШЕЙКЕРЫ, РОТАТОРЫ, ВОРТЕКСЫ, ГОМОГЕНИЗАТОР . . . . . 15

**Рокеры:** MR-1, MR-12  
**Шейкеры:** 3D, Multi Bio 3D, PSU-10i, PSU-20i, MPS-1, PSU-2T  
**Ротаторы:** Bio RS-24, Multi Bio RS-24, Multi RS-60  
**Вортексы:** V-1 plus, V-32, MSV-3500  
**Гомогенизатор:** RCP-24

### ТЕРМОШЕЙКЕРЫ . . . . . 37

PST-60HL, PST-60HL-4, PST-100HL, TS-DW, TS-100, TS-100C, TS-100C Smart

### МИНИ-ЦЕНТРИФУГИ-ВОРТЕКСЫ . . . . . 45

FV-2400, FVL-2400N, MSC-3000, MSC-6000, CVP-2

### ЦЕНТРИФУГИ . . . . . 51

Microspin 12, LMC-3000, LMC-4200R  
 Роторы для LMC-3000 и LMC-4200R

### ТЕРМОСТАТЫ ТИПА «ДРАЙ-БЛОК» . . . . . 57

Bio TDB-100, TDB-120, CH-100, CH 3-150  
 «Драй блок» термостаты серии QB

### ВОДЯНЫЕ БАНИ . . . . . 65

**Водяная баня с перемешиванием:** WB-4MS  
**Водяные бани без перемешивания:** JB Academy, JB Nova, SUB Aqua Pro  
**Циркулирующие ванны:** LSB Aqua Pro range, OLS26, Optima™ серии, Optima™ R серии, LT ecocool™, SBB серии

### МАГНИТНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ . . . . . 81

**Магнитные мешалки:** MS-3000, MMS-3000, MSH-300, Intelli-Stirrer MSH-300i  
**Механическая мешалка:** MM-1000

### БИОЗАЩИТА ВОЗДУХА, ПОВЕРХНОСТИ - УФ боксы, УФ рециркуляторы воздуха . . . . . 89

**Боксы для стерильных работ:** UVC/T-AR, UVC/T-M-AR, UVT-B-AR, UVT-S-AR  
**Биозащита воздуха:** UVR-M, UVR-Mi  
**Раствор для дезактивации ДНК/РНК:** PDS-250, PDS-10

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ .....	98
Labaqua Trace, Labaqua HPLC, Labaqua Bio	
ДЕНСИТОМЕТРЫ, ФОТОМЕТР .....	101
<b>Денситометры:</b> DEN-1, DEN-1B	
<b>Фотометр:</b> DEN-600	
АСПИРАТОРЫ, ДОЗАТОРЫ .....	105
<b>Аспираторы:</b> FTA-1, FTA-2i	
<b>Дозаторы:</b> Серия Assist; Assistboy	
ПРОМЫВАТЕЛИ ПЛАНШЕТОВ .....	138
3D-IW8, Аквамарин	

## БИОПРОЦЕССЫ

СО <sub>2</sub> ИНКУБАТОР .....	113
S-Bt Smart Biotherm, Компактный СО <sub>2</sub> инкубатор	
CPS-20, СО <sub>2</sub> шейкер	
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БИОРЕАКТОРЫ .....	118
RTS-1, RTS-1C, RTS-8, RTS-8 Plus	
ШЕЙКЕРЫ–ИНКУБАТОРЫ .....	124
ES-20, ES-20/60, ES-20/80	

## ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК/РНК .....	130
Линейка для выделения ДНК/РНК	
BioMagPure 12 Plus, Система для выделения нуклеиновых кислот и реагенты	
MagSorb-16, Магнитный штатив для ручного выделения нуклеиновых кислот	
ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ .....	134
Линейка ПЦР анализа	
BioQuant-96, Система ПЦР в реальном времени	
ИММУНОДИАГНОСТИКА .....	137
ИФА линейка	
Аквамарин, Промыватель планшетов автоматический	
3D-IW8, Промыватель планшетов автоматический	
MPP-96 HiPo, Фотометр для микропланшетов	

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ БИОСАН .....	146
--	-----

## АППЛИКАЦИИ И СТАТЬИ

Ссылки на статьи .....	147
Как правильно выбрать Шейкер, Ротатор, Вортекс для исследований .....	148
Линейки приборов .....	150

# COVID-19

Пандемия коронавируса (COVID-19) показывает необходимость быстрого и надёжного приготовления образцов, а также безопасной рабочей среды. Чтобы облегчить выбор продуктов, здесь показаны готовые линейки продуктов для быстрого начала анализа проб на COVID-19.

## Превентивный

### Обеззараживание



UVR-M/UVR-Mi

Рециркуляторы воздуха  
проточные бактерицидные

Воздух



**НОВИНКА** см. стр. 96

PDS-250, PDS-10L

Раствор для дезактивации ДНК/РНК

Поверхность

## Методы обнаружения на основе ИФА

### Шаги

#### Инкубация



PST-60HL-4  
Термошейкер  
для планшетов



PST-60HL  
Термошейкер  
для планшетов



PSU-2T  
Мини-шейкер  
для иммунологии

#### Отмывка



Assist  
Серия пипеток



Assistboy  
Пипеточный  
дозатор



FTA-2i  
Аспиратор  
с сосудом-  
ловушкой



Аквамарин  
Промыватель  
планшетов  
автоматический

#### Обнаружение и анализ



HiPo MPP-96  
Фотометр для  
микропланшетов



Quant Assay  
ПО для HiPo MPP-96

# Методы обнаружения на основе нуклеиновых кислот

## Ручная пробоподготовка

### Рабочая область



**UVT-S-AR**  
Бокс для стерильных работ

### Ресуспензия проб и реагентов



**V-1 Plus**  
Вортекс персональный



**MSC-3000**  
Центрифуга-вортекс  
Мульти-Спин

### Лизис образца



**TDB-120**  
Термостат типа  
"Драй-блок"



**Assist**  
Серия пипеток



**FTA-2i**  
Аспиратор  
с сосудом-ловушкой

### Отмывка образца



**НОВИНКА** см. стр. 134  
**MagSorb 16**

Магнитный штатив для ручного выделения нуклеиновых кислот



**Microspin 12**  
Высокоскоростная мини-центрифуга

### Элюирование нуклеиновых кислот



**TS-100C Smart**  
Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов



**НОВИНКА** см. стр. 132  
**Biomagpure 12 Plus**

Компактная настольная роботизированная система для автоматического выделения нуклеиновых кислот (+ реагенты)

## Обнаружение образца и анализ

### Подготовка



**CVP-2**  
Центрифугирование и встряхивание планшет



**MSC-6000**  
Центрифугирование и встряхивание пробирок

### Обнаружение ПЦР в реальном времени



**НОВИНКА** см. стр. 135  
**BioQuant-96**

Система ПЦР в реальном времени



**abTes COVID-19 qPCR kit**  
(Реагенты сертифицированы CE-IVD — среди наборов, внесенных в список ВОЗ.)



## RTS-8, RTS-8 Plus **НОВИНКА** см. стр. 122

Параллельные биореакторы с неинвазивным измерением концентрации клеток, pH и  $pO_2$  – RTS-8 Plus) в реальном режиме времени

RTS-8, RTS-8 plus это следующее поколение параллельных одноразовых 50 мл биореакторов, использующих для перемешивания принцип Reverse-Spin®.

### Новые возможности:

- Параллельное проведение одновременно 8 биопроцессов в одном приборе, позволяющих изучить эффект различных факторов на биопроцесс и оптимизировать условия культивирования клеток (температура, скорость вращения пробирки,  $pO_2$ , pH, концентрация различных субстратов).
- Многоугловое фотометрирование пробирки-биореактора в режиме реал-тайм, позволяющее неинвазивно регистрировать ОД в широком диапазоне — до 100 ОД (600 нм).
- Культивирование широкого спектра микроорганизмов, как например, аэробных так и аэротолерантных, а также анаэробных микроорганизмов.
- Выгодное приобретение — пользователь получает один 8 каналный компактный биореактор RTS-8, вместо пяти отдельных RTS-1С.
- Уникальная технология для модели RTS-8 Plus неинвазивного измерения концентрации кислорода  $O_2$  и pH в ходе эксперимента. Данная модель разработана в кооперации с компанией Presens, Germany.
- Компьютерная программа, поставляемая в комплекте с прибором, обеспечивает контроль и регистрацию заданных параметров культивирования в он-лайн и их хранение, а также для загрузки данных в EXCEL с целью дальнейшей обработки полученных результатов.

Пробирки для RTS-8 Plus с сенсорами



Программное обеспечение для ПК





### CPS-20 **НОВИНКА** см. стр. 116

#### CO<sub>2</sub> шейкер

CO<sub>2</sub> шейкер **CPS-20** обеспечивает регулируемое орбитальное движение платформы и разработан специально для CO<sub>2</sub> инкубатора S-Bt производства Биосан. **CPS-20** разработан для использования в агрессивной среде угольной кислоты, обеспечивая воспроизводимые результаты культивации клеток. Выбор из 5 взаимозаменяемых платформ позволяет осуществлять различные техники, используя разнообразную посуду для культивации.

В **CPS-20** используется бесщеточный мотор с гарантированным сроком службы до 35 000 часов. Прибор оборудован тройным эксцентриковым механизмом для движения платформы, который позволяет добиться превосходных характеристик по балансу, надежности и тихой работе. Специально разработанный модуль дистанционного управления позволяет предохранить электронику от неблагоприятного влияния агрессивной среды инкубатора, а также позволяет управлять шейкером не нарушая гомогенности среды внутри инкубатора в процессе эксперимента.



### S-Bt Smart BioTherm **НОВИНКА**

#### Компактный CO<sub>2</sub> инкубатор см. стр. 114

**S-Bt Smart BioTherm** предназначен для работы в областях клеточной биологии (работа с культурами животных клеток и тканей), молекулярной биологии (анализ ДНК/РНК, реакции гибридизации), биотехнологий (синтез целевого белка и др. молекул), иммунологии (синтез антител и др. белков иммунной системы).

Прибор обеспечивает шестисторонний обогрев стенок камеры и двери, тем самым обеспечивая равномерное распределение температуры внутри инкубатора.

Встроенный высокоточный инфракрасный CO<sub>2</sub>-датчик позволяет измерять и контролировать уровень CO<sub>2</sub> и не чувствителен к изменению температуры и влажности внутри инкубатора.

Гладкая поверхность внутренней камеры, сделанной из нержавеющей стали, минимизирует контаминацию и облегчает очистку.

Прибор оснащен системой УФ-рециркуляции воздуха — 1 УФ-лампа и вентиляторы, установленные за задней стенкой инкубатора, обеспечивают деконтаминацию рабочего объема инкубатора.

В стенке прибора встроен удобный порт доступа для вывода проводов датчиков или приборов, установленных в инкубаторе. Порт подогревается, чтобы предотвратить образование конденсата.

Прибор оборудован системами выявления ошибок и оповещений, что существенно снижает возможные риски связанные с работой прибора.

Прибор оборудован системой «чёрного ящика», записывающего такие данные, как температура, влажность и уровень CO<sub>2</sub> во внутреннюю память.

Программное обеспечение для подключения прибора к ПК по Bluetooth® поставляется по запросу клиента.



## ES-20/80C АНОНС

### Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор с охлаждением **ES-20/80C** для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования нового поколения. Устройство дублирует функционал ES-20/80, а также использует элемент Пельтье для охлаждения камеры. Высокоточное распределение температуры по всему объему камеры шейкера инкубатора (от 12,5°C ниже комнатной температуры до +80°C) достигается за счет встроенного бесшумного термостойкого бесщеточного вентилятора. К тому же, при температуре 37°C можно добиться отличной равномерности температуры образца в пределах  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ .



## ES-20/80 НОВИНКА см. стр. 124

### Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор **ES-20/80** для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Стандартное применение – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, а также другие виды применения в области биологии и химии.

Устройство имеет новый трехэксцентриковый механизм вращения платформы, обеспечивающий характеристики отличного балансирования, надежность и тихую работу даже при максимальных оборотах (до 400 об/мин). Стабильность устройства во время интенсивного перемешивания позволяет устанавливать до 3-х устройств друг на друга, помогая сэкономить рабочее пространство. Новый дисплей и простой пользовательский интерфейс обеспечивают четкий и интуитивный контроль параметров и позволяют архивировать, хранить данные и отображать их в динамике. Благодаря таким дополнительным функциям, как датчик дисбаланса и автоматическое выявление отказа термостата, шейкер-инкубатор становится современным и безопасным изделием. Подключение к компьютеру, используя технологию Bluetooth®, позволяет осуществлять управление данными, архивирование, контроль параметров и профилирование в специальном программном блоке.

Высокоточное распределение температуры по всему объему камеры шейкера-инкубатора (от 10°C выше комнатной температуры до +80°C) достигается за счет встроенного бесшумного термостойкого бесщеточного вентилятора. К тому же, при температуре 37°C можно добиться отличной равномерности температуры образца в пределах  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ . Внутренняя камера сделана из нержавеющей стали. Современный тип двигателя, использование новейших теплоизоляционных материалов, микропроцессорное обеспечение мягкого старта движения платформы и современная регуляция термостатирования снижают потребление энергии и делают шейкер-инкубатор высокоэкономичным, несмотря на его относительно большие размеры.



**ОБНОВЛЁННОЕ ПО** см. стр. 142

## HiPo MPP-96

### Фотометр для микропланшетов

Микропланшетный фотометр **HiPo** – это компактное, настольное устройство для замера оптической плотности ИФА и микробиологических исследований в 96-луночных микропланшетах. Управление прибором и анализ данных происходит на компьютере. Программное обеспечение входит в стандартную комплектацию прибора. Также доступен широкий список дополнительных интерференционных фильтров (со сред. шагом 10 нм). Устройство поставляется со специальным программным обеспечением **QuantAssay**.

#### Функции программного обеспечения **QuantAssay**:

- ИФА любой сложности можно программировать через редактор методик с помощью функции Assay Editor;
- Количественный анализ: возможность установки до 20 стандартов;
- Анализы avidности/аффинности антител
- Мультиплексные анализы до 7 анализов на одном планшете;
- Качественный анализ позволяет независимо интерпретировать до 11 типов контролей;
- Функция Best Fit позволяет автоматически выбрать самую лучшую калибровочную кривую;
- Удобный интерфейс: получите результаты в 3 клика;
- Сохранение, загрузка постановки экспериментов и их экспорт;
- Интеграция экспорта данных в Лабораторно-информационную систему (ЛИМС/LIMS);
- Создание визуальных отчетов.



**RCP-24** **АНОНС** см. стр. 35

### Гомогенизатор

Гомогенизатор **RCP-24**, настольное механическое устройство, предназначенное для, перемешивания, измельчения, гомогенизации, эмульгирования биологических объектов в микропробирках за счет встряхивания с твердыми шариками с целью пробоподготовки для последующих академических, фармацевтических, биотехнологических или биомедицинских исследований. Идеально подходит для гомогенизации клещей.



**PDS-10L** **НОВИНКА** см. стр. 96

### Раствор для дезактивации ДНК/РНК

**PDS-250** раствор теперь доступен в канистре объемом 10 л — **PDS-10L**.

**PDS-250** — это раствор для удаления ДНК, РНК, ДНКаз и РНКаз с поверхностей перед постановкой ПЦР реакции. ДНК / РНК удаляются в течение нескольких секунд после применения. Раствор содержит поверхностно-активное вещество, которое является нещелочным и неканцерогенным агентом. **PDS-250** предназначен для использования в ПЦР-боксах, лабораторных устройствах — BioMagPure 12 Plus, термо-шейкерах для пробирок и планшетов, шейкерах-инкубаторах и т.д.



## DEN-600 **НОВИНКА** см. стр. 104

### Фотометр

**DEN-600** — это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600 использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод ОП600, который оценивает общее количество клеток, 2) метод измерения мутности Макфарланда (McF), 3) метод анализа Брэдфорда для измерения концентрации белка.

Устройство служит недорогой альтернативой спектрофотометру, который обычно используется для этих применений. Поскольку **DEN-600** питается от батареи и компактен, его можно удобно разместить в боксе биобезопасности, анаэробной камере или быстро переместить в другое лабораторное помещение. Кроме того, механизм удержания сосуда позволяет размещать стандартные 10-миллиметровые кюветы, пробирки с круглым, коническим дном, или Falcon типа пробирки, что позволяет измерять поглощение и мутность в единицах Abs, OD или McF.

USB-подключение и программное обеспечение DEN позволяют передавать, обрабатывать и вычислять данные, настраивать калибровку для метода анализа белка Брэдфорда или для особых пробирок также для использования персонализированных стандартов мутности.



## DEN-1 **МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ** см. стр. 102

### Денситометр

Обновлён корпус и новый дисплей, также улучшены измерительные характеристики, что соответствует спецификации версии DEN-1B. Отличие составляет отсутствие батарейного отсека.

## P-5, F-1 **НОВИНКА** см. стр. 96

### Полки для ПЦР-боксов

Для ПЦР-боксов разработаны два вида полок: **P-5** — полка держатель для 5 пипеток и полка **F-1**, увеличивающая эффективную площадь бокса. На полке **F-1** можно разместить лабораторную посуду, реагенты и другие предметы, которые удобно держать в непосредственной доступности.





**TS-100C Smart** НОВИНКА см. стр. 40


**Термо-шейкер**

Новая модель позволяет осуществлять управление прибором в следующих режимах:

1. Мануальное, используя интерфейс фронтальной панели.
2. Через компьютерную программу используя технологию Bluetooth® Программное обеспечение позволяет управлять следующими параметрами:
  - Скорость вращения
  - Температура
  - Время
  - Звуковой сигнал
  - Создание профилирующих программ с использованием контролируемых параметров
  - Визуализация диаграмм температуры по времени и скорости по времени
  - Экспорт данных в формат Excel и CSV.
  - Сообщения об ошибках / диагностика неисправностей

К одному компьютеру подключается до 7 приборов с независимой настройкой параметров. Программное обеспечение входит в стандартную комплектацию прибора.

Программное обеспечение для ПК – окно профилирования

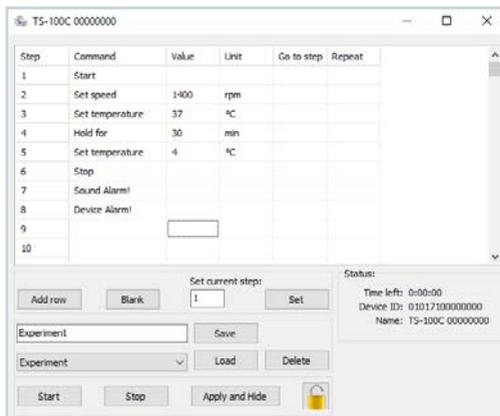

**LMC-56** АНОНС

**Центрифуга**

**LMC-56** — это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов.

Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях.

Предшественником этой центрифуги является лабораторная центрифуга LMC-3000, широко известная среди пользователей в России, Белоруссии, Казахстане, Украине и других странах.

**Новая центрифуга отличается существенно улучшенными характеристиками:**

- Более высокая скорость - максимальная 6000 оборотов в минуту или 3160 g
- Новые бакет роторы, имеющие максимальную общую емкость до 400 мл
- Широкий выбор роторов – до 13 штук
- Автоматическое распознавание роторов и установка максимальной скорости для каждого типа ротора
- Улучшенное вентилирование рабочей камеры для снижения нагрева пробирок во время центрифугирования
- Несколько видов разгона и торможения центрифугирования
- Автоматическая остановка в случае дисбаланса





SPM



SPML

**SPM, SPML** **НОВИНКА** см. стр. 22

**Двухсторонний клеевой коврик**

Удобная альтернатива традиционным стальным держателям, простой способ закрепить пробирки, чашки, колбы и другие лабораторные сосуды на платформах для выращивания, инкубации и смешивания.

SPML, комплект из трёх двухсторонних клеевых ковриков



SPM, двухсторонний клеевой коврик



**BioQuant-96** **НОВИНКА** см. стр. 135

**Система ПЦР в реальном времени**

В ней применены передовые технологии термоэлектрического охлаждения, совершенно новый источник света и дизайн светового пути. Уникальный метод контроля постоянного тока и 6-зонного независимого температурного контроля обеспечивает более быстрый, корректный и стабильный флуоресцентный количественный анализ продукта, сохраняя преимущество исключительной производительности при наиболее возможно низком потреблении электричества.


Доступны версии на 5 и 6 каналов. Так же доступны такие функции, как независимый температурный контроль 6 зон, хранение образцов при низкой температуре в +4°C, автоматическое осушение воздуха между блоком и крышкой а так же режим FAST (просим удостовериться в соответствии реагентов протоколам FAST)

**BioQuant-96** автоматически осуществляет регулировку чувствительности и улучшает опыт работы пользователя. Таким образом, инструмент полностью соответствует требованиям научно-исследовательских лабораторий. Наличие европейской регистрации Медицинского изделия 1 (A) класса позволяет использовать прибор в лабораториях клинической диагностики.



ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА:

# РОКЕРЫ, ШЕЙКЕРЫ, РОТАТОРЫ, ВОРТЕКСЫ, ГОМОГЕНИЗАТОР

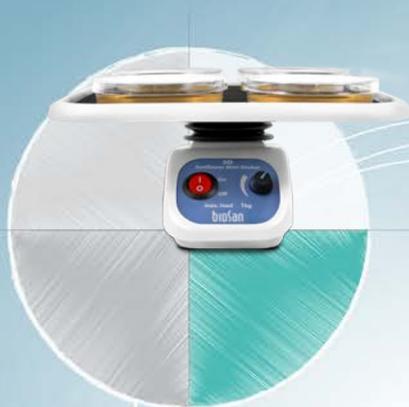

**3D**

Мини-Шейкер («Sunflower» типа)



**MPS-1**

Высокоскоростной шейкер  
для планшетов и микропробирок



**Multi Bio RS-24**

Мульти-ротатор

## MR-1, Мини-рокер шейкер

ОПИСАНИЕ

Мини-рокер-шейкер **MR-1** обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга.

Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.

Нескользящий термо устойчивый силиконовый коврик, расположенный на платформе шейкера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания.

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.

### Приспособления к стандартной платформе:

Дополнительный пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок разного размера.

Basic Plus  
Product Class



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

## MR-12, Рокер-шейкер

ОПИСАНИЕ

Рокер-шейкер **MR-12** обеспечивает как мягкое, так и интенсивное перемешивание растворов или питательных сред в сосудах или пластиковых мешках, размещенных на его платформе. Регулируемая скорость и угол покачивания платформы дают возможность подобрать параметры для оптимальной массопередачи и перемешивания. Идеален для отмывки гелей после электрофореза, при подготовке (гомогенизации) биоэкстракционной смеси. Оптимален для гибридизации биомолекул на полосках бумаги (стрипов), покраски и отмывки стрипов. Установленный в биоинкубатор прибор идеально подходит для выращивания клеточных культур в однокорневых пластиковых мешках-реакторах (рабочие объемы до 10 литров, объем жидкости до 5 литров).

Рокер-шейкер **MR-12** разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C. Внешний блок питания 220/12 В обеспечивает электробезопасную эксплуатацию прибора во влажных помещениях.

Premium  
Product Class



## MR-1, Мини-рокер шейкер и MR-12, Рокер-шейкер

	MR-1	MR-12
Диапазон регулирования частоты перемешивания	1–30 раз/мин	1–99 раз/мин (шаг 1 раз/мин)
Угол наклона платформы	7° (фиксированный)	0°–10° (шаг 1°) (при 1–50 раз/мин.) 10° (при 51–99 раз/мин.)
Максимальное время непрерывной работы	168 ч.	
Цифровая установка времени	1 мин. – 24 ч./непрерывно	1 мин. – 99 ч. 59 мин. (шаг 1 мин.) / непрерывно
Звуковой сигнал таймера	—	+
Платформа с нескользящим силиконовым покрытием для чашек Петри и ванночек (вкл. в станд. комплектацию)	215 × 215 мм	480 × 380 мм
Максимальная нагрузка	1 кг	5 кг
Дисплей	Светодиодный	ЖК, 2 × 16 знаков
Рабочая площадь платформы	215 × 215 мм	480 × 380 мм
Размеры (Д × Ш × В)	220 × 205 × 120 мм	430 × 480 × 210 мм
Вес	2,1 кг	11,9 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 320 мА/3,8 Вт	12 В, 1,1 А/13 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100-240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	

Коврик PDM



MR-1 с ковриком PDM



MR-12



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**MR-1** со стандартной платформой **Bio PP-4S**

**MR-12** со стандартной платформой **PP-480**

**Дополнительные принадлежности для MR-1:**

**PDM**, пупырчатый коврик

Кат. номер

BS-010152-AAG

BS-010130-AAI

PDM



## 3D, Мини-шейкер («Sunflower» типа)

ОПИСАНИЕ

Мини-шейкер **3D** типа Sunflower обеспечивает регулируемое 3-плоскостное мягкое вращение платформы и предназначен для перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, проявления мини-гелей, отмывки образцов и реакции блот-гибридизации.

Мини-шейкер компактен и работает в режиме экономичного энергопотребления. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует многолетнюю надёжную эксплуатацию.

Нескользкий термоустойчивый силиконовый коврик, расположенный на платформе мини-шейкера, обеспечивает устойчивое положение сосудов.

Мини-шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

Basic Plus  
Product Class



3D-движение



3D

Видео  
работы  
прибора

## Multi Bio 3D

### Программируемый Мини-шейкер («Sunflower» типа)

ОПИСАНИЕ

Программируемый 3D шейкер обеспечивает реализацию нескольких видов движения в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов, а также позволяет подобрать вид перемешивания в соответствии с индивидуальными задачами.

Программируемый 3D шейкер **Multi Bio 3D** предназначен для выполнения широкого ряда процедур: для реакций гибридизации, выращивания клеток, отмывки гелей, мягкой экстракции и гомогенизации биологических компонентов в растворах.


Микропроцессорное управление **Multi Bio 3D** позволяет реализовать не только **1** орбитальное 3-плоскостное вращение платформы, но и **2** возвратно-поступательное 3-х плоскостное движение (типа пинг-понг) и **3** вибро-движение. Эти три движения могут быть реализованы отдельно, попарно, а также циклами, включающими последовательное исполнение трех видов движения. Шейкер предназначен для лабораторий с повышенными требованиями к процессам перемешивания, экстракции и выращивания клеточных культур.

Нескользкий термоустойчивый силиконовый коврик, расположенный на платформе шейкера, обеспечивает устойчивое положение сосудов.

Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

Premium  
Product Class

Ø 22 мм  
орбита



3 вида движений

Видео  
работы  
прибора

## 3D, Мини-шейкер и Multi Bio 3D, Программируемый Мини-шейкер («Sunflower» типа)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	3D	Multi Bio 3D
❶ Диапазон регулирования скорости (орбитальное и покачивающее движение)	5–60 об/мин	1–100 об/мин
❷ Угол поворота (покачивающее движение)	—	0–360° (шаг 30°)
❸ Угол поворота (при вибродвижении)	—	0–5° (шаг 1°)
Угол наклона платформы	7°	
Орбита	—	22 мм
Рабочая площадь платформы	215 × 215 мм	
Платформа с нескользящим силиконовым покрытием для чашек Петри и ванночек (включена в стандартную комплектацию)		
Макс. время непрерывной работы	168 ч.	24 ч.
Таймер при движении ❶ ❷	—	0–250 сек.
Таймер при движении ❸	—	0–5 сек.
Число повторений установленного цикла	—	0–125 раз
Звуковой сигнал таймера	—	+
Максимальная нагрузка	1 кг	
Размеры прибора с платформой (Д×Ш×В)	235 × 235 × 140 мм	
Вес	1,2 кг	1,8 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 260 мА/3,1 Вт	12 В, 380 мА/4,6 Вт
Внешний блок питания	вход АС 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	

### Приспособления к стандартной платформе:

Дополнительный пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок разного размера.

Коврик PDM



Multi Bio 3D с ковриком PDM



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**3D** со стандартной платформой **Bio PP-4S**

**Multi Bio 3D** со стандартной платформой **Bio PP-4S**

Дополнительные принадлежности:

**PDM**, пупырчатый коврик

Кат. номер

BS-010151-AAG

BS-010125-AAG

PDM



## PSU-10i, Орбитальный шейкер

ОПИСАНИЕ

Орбитальный шейкер **PSU-10i** обеспечивает регулируемое орбитальное вращение платформы и рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор из пяти (5) разных взаимозаменяемых платформ гарантирует выполнение различных методик и технологий.

Шейкер **PSU-10i** обладает прямым приводом, бесщеточным двигателем с гарантийным лимитом работы 35 000 часов и устройством автобалансировки неравномерной нагрузки на платформу. Эти особенности позволяют осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток, гарантируют надежную эксплуатацию более 2 лет и существенно расширяют диапазоны характеристик прибора (как в сторону его низких, так и высоких значений).

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.

Premium  
Product Class

Ø 10 мм  
орбита



Видео  
работы  
прибора

## PSU-20i, Орбитальный шейкер

ОПИСАНИЕ

Орбитальный шейкер **PSU-20i** обеспечивает три вида движения: ① орбитальное, ② возвратно-поступательное и ③ вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных. **PSU-20i** – идеальный инструмент для лабораторий, проводящих исследования в биофармации и биомедицине.


Орбитальный шейкер **PSU-20i** бесшумен и надежен в работе, обладает прямым приводом, бесщеточным двигателем с гарантийным лимитом работы 35 000 часов. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.

Выбор из девяти (9) разных взаимозаменяемых платформ обеспечивает выполнение различных методик и технологий. Особое внимание обращаем на многоэтажную платформу, которая позволяет размещать большое количество различных планшетов, чашек Петри, культуральных мешков и других невысоких контейнеров.

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.

Premium  
Product Class

Ø 20 мм  
орбита



3 вида движений

## PSU-10i и PSU-20i, Орбитальные шейкеры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	PSU-10i	PSU-20i
Несколько видов движения	—	+
Диапазон регулирования скорости*	50–450* об/мин (шаг 10 об/мин)	20–250* об/мин (шаг 5 об/мин)
Цифровой контроль скорости	+	
Макс. время непрерывной работы	168 ч.	
Орбита	10 мм	20 мм
Цифровая установка времени	1 мин. –96 ч./непрерывно	
Звуковой сигнал таймера	+	
Максимальная нагрузка	3 кг	8 кг
Размеры без платформы (Д × Ш × В)	255 × 255 × 100 мм	410 × 410 × 130 мм
Вес	3,4 кг	11,7 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 800 мА/9,6 Вт	12 В, 3,2 А/40 Вт
Внешний блок питания	вход АС 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	

\* — Макс. скорость зависит от нагрузки и формы сосуда

Платформа Bio PP-4 для PSU-10i



Платформа Bio PP-4 для PSU-10i



Платформа для PSU-20i PP-20/4



Платформа P-6/250 для PSU-10i



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**PSU-10i**, шейкер без платформы

BS-010144-AAN

**PSU-20i**, шейкер без платформы

BS-010145-ACI

Виды движения PSU-20i	Описание	Скорость	Регулируемое изменение амплитуды сдвига платформы	Диапазон установки времени*	Цифровая установка времени
Орбитальное	Орбитальное движение с возможностью менять направление	20–250 об/мин	—	0–250 сек.	1 мин.–96 ч. ( шаг 1 мин.)/ непрерывно
Возвратно-поступательное	Возвратно-поступательное движение	20–250 об/мин	0–360° (шаг 30°)	0–250 сек.	
Вибрационное	Вибрационный режим, перемешивание по малой амплитуде	—	0–5° (шаг 1°)	0–5 сек.	

\* — Для перехода на следующий вид движения

Описание и фотографии всех платформ см. на стр. 22–23

## Платформы для OS-20, PSU-10i и ES-20

Платформа	Описание	Размер (Рабочий размер)	Кат. номер
<b>UP-12</b> для OS-20, PSU-10i, ES-20	 Универсальная платформа с силиконовым ковриком	285 × 220 × 40 мм (270 × 185 × 40 мм)	BS-010108-AK
<b>Bio PP-4</b> для OS-20, PSU-10i	 Платформа с силиконовым ковриком для чашек Петри и планшет	255 × 255 мм (230 × 230 мм)	BS-010116-AK
<b>PP-4</b> для ES-20, PSU-10i	 Металлическая платформа с силиконовым ковриком для чашек Петри и планшет	220 × 220 мм (215 × 215 мм)	BS-010108-BK
<b>SPM</b>	 Двухсторонний клейкий коврик в качестве альтернативы обычным держателям колб (для PP-4)	220 × 220 мм	BS-010111-BK
<b>P-12/100</b> для OS-20, PSU-10i, ES-20	 Платформа для колб 100–150 мл (12 мест)	250 × 190 мм (250 × 190 мм)	BS-010108-EK
<b>P-6/250</b> для OS-20, PSU-10i, ES-20	 Платформа для колб 250–300 мл (6 мест)	250 × 190 мм (250 × 190 мм)	BS-010108-DK
<b>P-16/88</b> для OS-20, PSU-10i, ES-20	 Платформа с универсальными пружинными держателями для 88 пробирок, диаметром до 30 мм	275 × 205 × 75 мм (275 × 205 × 75 мм)	BS-010116-BK

## SPML, SPM, Двухсторонние клейкие коврики **НОВИНКА**

ОПИСАНИЕ

Удобная альтернатива традиционным стальным держателям, простой способ закрепить пробирки, чашки, колбы и другие лабораторные сосуды на платформах для выращивания, инкубации и смешивания. Доступны два варианта размеров.

**SPML** совместим с платформой UP-168, которая устанавливается как на орбитальный шейкер PSU-20i, так и на шейкеры-инкубаторы ES-20/60, ES-20/80.

**SPM** совместим с платформой PP-4, которая устанавливается как на орбитальный шейкер PSU-10i, так и в шейкер-инкубатор ES-20.

Изготовлен из полиуретана с клеевым слоем, прост в очистке и долговечен, выдерживает до 1000 раз размещения / снятия или 12 месяцев использования. Дополнительная информация об ограничениях температуры, рабочего объема и скорости доступна в руководстве пользователя.

SPM на платформе PP-4



СПЕЦИФИКАЦИЯ

**SPML**  
размеры (Д×Ш×В) 390 × 80 × 3 мм  
(двусторонний полиуретан  
1,5 мм с клеем ПЭТ)

**SPM**  
размеры (Д×Ш×В) 210 × 210 × 3 мм  
(двусторонний полиуретан  
1,5 мм с клеем ПЭТ)


Цвет прозрачный

Продолжительность использования до 1000 раз размещения / снятия или 12 месяцев

Диапазон температуры +4°C ... +80°C

Диапазон скорости 0–400 об/мин

SPML на платформе UP-168

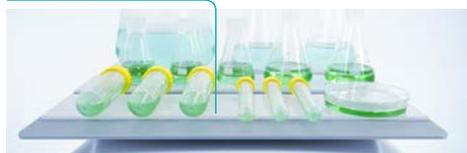

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**SPM**, Двухсторонний клейкий коврик

**SPML**, Набор из трёх двусторонних клейких ковриков

Кат. номер

BS-010111-BK

BS-010135-MK

## Платформы для PSU-20i и ES-20/60

Платформа	Описание	Размер (Рабочий размер)	Кат. номер
<b>UP-330</b> для PSU-20i	 Универсальная платформа для различных видов колб	345 × 430 × 105 мм (300 × 400 × 80 мм)	BS-010145-AK
<b>P-30/100</b> для PSU-20i, ES-20/60	 Платформа для колб 100-150 мл (30 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-BK
<b>P-16/250</b> для PSU-20i, ES-20/60	 Платформа для колб 250-300 мл (16 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-CK
<b>P-9/500</b> для PSU-20i, ES-20/60	 Платформа для колб 500 мл (9 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-AK
<b>P-6/1000</b> для PSU-20i, ES-20/60	 Платформа для колб 1000 мл (6 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-DK
<b>PP-400</b> для PSU-20i, ES-20/60, ES-20/80	 Платформа с нескользящим силиконовым покрытием	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-FK
<b>UP-168</b> для ES-20/60, ES-20/8	 Универсальная платформа для различных колб	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-JK
<b>FC-50</b> <b>FC-100</b> <b>FC-250</b> <b>FC-500</b> <b>FC-1000</b> <b>FC-2000</b> для PSU-20i	 Зажим для 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 мл колб (для UP-168)	Ø 50 мм Ø 65 мм Ø 85 мм Ø 105 мм Ø 130 мм Ø 165 мм	BS-010126-MK BS-010126-HK BS-010126-JK BS-010126-LK BS-010126-IK BS-010126-NK
<b>SPML</b>	 <b>НОВИНКА</b> Набор из трёх двусторонних клейких ковриков в качестве альтернативы обычным держателям колб (для UP-168)	390 × 80 × 3 мм	BS-010135-MK
<b>TR-21/50</b>	 Штатив для 50 мл пробирок, 21 место (для UP-168)	340 × 124 мм (2 на платформу)	BS-010135-KK
<b>TR-44/15</b>	 Штатив для 15 мл пробирок, 44 места (для UP-168)	340 × 124 мм (2 на платформу)	BS-010135-LK
<b>PP-20/4</b> для PSU-20i	 Плоская многоэтажная платформа (4 этажа)	380 × 480 × 510 мм (365 × 465 × 510 мм)	BS-010126-EK
<b>PP-20/3</b> для PSU-20i	 Плоская многоэтажная платформа (3 этажа)	380 × 480 × 340 мм (365 × 465 × 340 мм)	BS-010126-DK
<b>PP-20/2</b> для PSU-20i	 Плоская многоэтажная платформа (2 этажа)	380 × 480 × 170 мм (65 × 465 × 170 мм)	BS-010126-CK
<b>PP-20</b> для PSU-20i	 Платформа с нескользящим резиновым покрытием	380 × 480 мм (365 × 465 мм)	BS-010126-BK

## MPS-1, Высокоскоростной шейкер для планшетов и микропробирок



Видео  
работы  
прибора

Глубоколуночный  
планшет 1000 мкл

Ø 3 мм  
орбита

Платформа  
для 24 × 1,5-2 мл  
микропробирок

Платформа  
для 32 × 0,5 мл  
микропробирок



Вортекс



Платформа  
для 96 × 0,2 мл  
микропробирок

96-луночный  
планшет

ПЦР-планшет с полуюбкой/  
без юбки 200 мкл

Глубоколуночный  
планшет 500 мкл

### ОПИСАНИЕ

Шейкер **MPS-1** разработан для перемешивания образцов малых объемов. Он компактен и прост в управлении, что делает его идеальным для персонального пользования.

Высокоскоростной шейкер **MPS-1** осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР-планшетах, глубоколуночных планшетах и микропробирках. Функция шейкера доступна для микропробирок объемом 0,2–2 мл, а функция вортекса позволяет перемешивать любой объем до 50 мл.

**MPS-1** имеет **встроенный вортекс** для перемешивания одной пробирки.

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.

В **MPS-1** реализован инновационный алгоритм перемешивания **Pulse Mode**, который работает по принципу подачи периодических импульсов: жидкость в пробирке разгоняется до заданной скорости, перемешивается в течение 3 секунд, а затем останавливается на короткий момент. Данный алгоритм повторяется, пока не закончится время на таймере. Благодаря меняющемуся ускорению, алгоритм обеспечивает постоянное ресуспендирование частиц внутри пробирки. Преимуществом метода является интенсивное перемешивание образцов в полуавтоматическом режиме без участия руки лаборанта.

### Особенности

- Высокая скорость перемешивания до 3200 оборотов в минуту (мин<sup>-1</sup>)
- Стабильное перемешивание с диаметром орбиты 3 мм
- 5 программ перемешивания
- Инновационный алгоритм перемешивания **Pulse Mode**
- Низкий уровень шума при максимальной скорости
- Универсальные крепления для иммунопланшетов, глубоколуночных планшетов и платформ для пробирок
- Дополнительные 4 платформы для ПЦР-планшетов с полу-юбкой/без юбки 200 мкл, а также для микропробирок объемом 0,2–2 мл

**P-02/96**, платформа  
для ПЦР-планшета  
с полуюбкой/без юбки 200 мкл

**P-2/24**, платформа  
для 24 × 1,5-2 мл микропробирок



**P-05/32**, платформа для 32 × 0,5 мл микропробирок

# MPS-1, Высокоскоростной шейкер для планшетов и микропроиорк

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вортексирование пробирки (50 мл)



Вортексирование пробирки (15 мл)



Работа со встроенной универсальной платформой



Диапазон скорости перемешивания 300–3200 об/мин

Платформы:

Для ПЦР-планшеты (96 лунок, с полуюбкой, без юбки) 0,2 мл P-02/96

Для 24 микропробирок 1,5–2 мл P-2/24

Для 32 микропробирок 0,5 мл P-05/32

Для 24 микропробирок 0,5 мл и 48 микропробирок 0,2 мл P-02/05

Универсальная платформа для глубоколоночных планшетов, 96-луночных микропланшетов (с плоским, U- и V-образным дном), 384-луночных микропланшетов

Программы перемешивания:

VORTEX («Вортекс») 3200 об/мин

HARD («Сильное») 2600 об/мин

MEDIUM («Среднее») 1800 об/мин

SOFT («Мягкое») 1000 об/мин

CUSTOM («Регулируемое») регулируемая скорость

Алгоритм перемешивания — **Pulse Mode**

Функция вортекса

Максимальная нагрузка 0,3 кг

Орбита 3 мм

Время разгона до максимальной скорости 5 сек.

Цифровая установка времени 0–60 мин. (шаг 15 сек.)/непрерывно

Звуковой сигнал таймера +

Максимальное время непрерывной работы 8 ч.

Уровень шума, не более 65 дБ

Вес 5,1 кг

Размеры (Д×Ш×В) 225 × 215 × 150 мм

Потребляемый ток/мощность 12 В, 800 мА/10 Вт

Внешний блок питания вход АС 100-240 В 50/60 Гц, выход DC 12 В

Глубоколоночный планшет 96/1000 мкл

Иммунопланшет 200 мкл

Глубоколоночный планшет 96/500 мкл



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

MPS-1, шейкер с универсальной платформой BS-010216-A03

MPS-1, шейкер с универсальной платформой и набором из 4 платформ (P-02/96, P-2/24, P-05/32, P-02/05) BS-010216-A11

### Дополнительные платформы:

Кат. номер

1 P-02/96 Для ПЦР-планшеты (96 лунок, с полуюбкой, без юбки) 0,2 мл

BS-010216-CK

2 P-2/24 Для 24 микропробирок 1,5-2 мл

BS-010216-AK

3 P-05/32 Для 32 микропробирок 0,5 мл

BS-010216-BK

4 P-02/05 Для 24 микропробирок 0,5 мл и 48 микропробирок 0,2 мл

BS-010216-DK

1 Платформа P-02/96

2 Платформа P-2/24

3 Платформа P-05/32

4 Платформа P-02/05



## PSU-2T, Мини-шейкер для иммунологии

ОПИСАНИЕ

Мини-шейкер **PSU-2T** предназначен для иммунологического анализа и обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов в планшетах. Прибор обеспечивает равномерное движение платформы даже при низких скоростях.

Мини-шейкер компактен и удобен в работе, занимает мало места на рабочем столе. Идеален для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет. На дисплее прибора попеременно отображаются значения времени и скорости.

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	150–1200 об/мин
Цифровая установка времени	1 мин. – 24 ч./непрерывно
Цифровой контроль скорости и времени	
Макс. время непрерывной работы	168 ч.
Система прямого привода	
Орбита	2 мм
Размеры (Д×Ш×В)	220×205×90 мм
Вес	2 кг
Потребляемый ток/ мощность	12 В, 280 мА/3,4 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В

Платформы для иммунопланшетов:

- A** **IPP-2** (станд. платформа)  
для 2 иммунопланшетов 184 × 132 мм
- B** **IPP-4** (доп. платформа)  
для 4 иммунопланшетов 266 × 170 мм



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**PSU-2T** со станд. платформой **IPP-2** BS-010155-AAG

Дополнительные платформы:

**IPP-4** BS-010102-AK

Basic Plus  
Product Class

Ø 2 мм  
орбита




Видео  
работы  
прибора

**A** Платформа **IPP-2**



**B** Платформа **IPP-4**

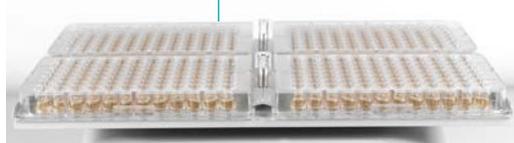

## OS-20, Орбитальный шейкер

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

🛒

Basic Plus  
Product Class

Ø 20 мм  
орбита



Орбитальный шейкер **OS-20** осуществляет орбитальное вращение платформы.

Микропроцессор шейкера обеспечивает контроль времени и оборотов. Предусмотрены два режима эксплуатации шейкера: (1) с таймером (1-999 мин.), (2) без таймера, время максимальной эксплуатации в режиме *non-stop* составляет 24 часа. Пять (5) видов сменных платформ расширяют возможности его использования в различных лабораториях: в микробиологии, химии, иммунологии, биохимии, молекулярной биологии. Двухсантиметровая амплитуда сдвига платформы позволяет равномерно перемешивать жидкости в плоских планшетах при выполнении таких диагностических тестов, как VDRL-тест.

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.

Платформа **Bio PP-4**



Диапазон регулирования скорости 50–250 об/мин

Максимальная скорость при нагрузке 2,5 кг 165 об/мин

Диаметр орбиты 20 мм

Максимальная нагрузка 2,5 кг

Цифровая установка времени 1–999 мин

Размеры (Д×Ш×В) 270 × 260 × 80 мм

Вес 3,2 кг

Потребляемый ток/мощность 12 В, 500 мА/6 Вт

Внешний блок питания вход AC 100–240 В  
50/60 Гц, выход DC 12 В

Платформа **P-6/250**



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: Кат. номер

**OS-20** без платформы BS-010108-AAG

Дополнительные платформы:

**UP-12** BS-010108-AK

**Bio PP-4** с силиконовым ковриком BS-010116-AK

**P-6/250** BS-010108-DK

**P-12/100** BS-010108-EK

**P-16/88** BS-010116-BK

Описание и фотографии  
всех платформ см. на стр. 22

## Multi Bio RS-24 и Multi RS-60, Мульти-ротаторы


Мульти-ротаторы обеспечивают реализацию нескольких видов движения: **1 Вращательное движение**, **2 Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, **3 Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность прободготовки тестируемых материалов, позволяя настраивать характер перемешивания в соответствии с индивидуальными задачами.

Ротаторы предназначены для выполнения широкого ряда процедур в современных Life Sciences лабораториях: для реакций гибридизации, выращивания клеток, отмывки гелей, мягкой экстракции и гомогенизации биологических компонентов в растворах, а также реакции связывания и отмывки магнитных частиц.

Мульти-ротаторы разработаны для использования в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

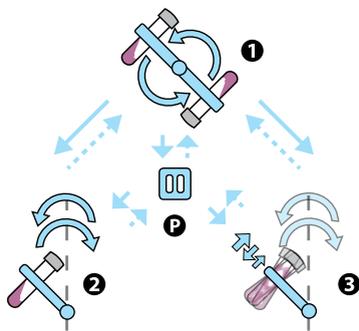

Программируемый ротатор обеспечивает 3 типа вращения и паузу:

- 1** Круговое вращательное движение
- 2** Возвратно-поступательное (покачивающее) движение
- 3** Встряхивающее движение
- P** Пауза

В режиме остановки платформа не делает лишней оборот и останавливается в горизонтальной плоскости. Дополнительно есть возможность установки плоскости, относительно которой колеблется платформа вертикально или горизонтально.



Multi Bio RS-24



Видео  
работы  
прибора



Multi RS-60



Видео  
работы  
прибора

## Multi Bio RS-24 и Multi RS-60, Мульти-ротаторы

	Multi Bio RS-24	Multi RS-60
<b>1 Вращательное движение:</b>		
Диапазон регулирования скорости	1–100 об/мин (шаг 1 об/мин)	
Вертикальное вращение	360°	
Диапазон установки времени	0–250 сек.	
<b>2 Возвратно-поступательное (покачивающее) движение:</b>		
Диапазон регулирования скорости	1–100 об/мин (шаг 1 об/мин)	
Регулирование угла наклона	1–90° (шаг 1°)	
Диапазон установки времени	0–250 сек.	
<b>3 Встряхивание:</b>		
Регулирование угла наклона	0–5° (шаг 1°)	
Диапазон установки времени в режиме встряхивания/паузы	0–5 сек.	
<b>Общая спецификация:</b>		
Цифровая установка времени	1 мин. – 24 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)	
Звуковой сигнал таймера	+	
Максимальная нагрузка	0,5 кг	0,8 кг
Размеры (Д × Ш × В)	365 × 195 × 155 мм	430 × 230 × 230 мм
Вес	1,7 кг	3,8 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 660 мА/8 Вт	24 В, 750 мА/18 Вт
Внешний блок питания	вход АС 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	вход АС 100–240 В, 50/60 Гц, выход DC 24 В

Multi Bio RS-24 с доп. платформой PRSC-22



Multi RS-60 со станд. платформой PRS-48



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**Multi Bio RS-24** со станд. платформой **PRS-26**

Кат. номер

BS-010117-AAG

**Multi RS-60** со станд. платформой **PRS-48**

BS-010118-AAI

Дополнительные платформы для **Multi Bio RS-24:**

**PRS-5/12**

BS-010117-HK

**PRS-10**

BS-010117-IK

**PRSC-22**

BS-010117-LK

**PRSC-10**

BS-010117-JK

**PRS-1DP**

BS-010149-DK

**M-8/50**

BS-010117-PK

Дополнительные платформы для **Multi RS-60:**

**PRS-8/22**

BS-010118-AK

**PRS-14**

BS-010118-BK

Описание и фотографии всех платформ см. на стр. 30

## Платформы для Multi Bio RS-24

Стандартные:	Вместимость	Объем пробирок	Диаметр пробирок	Кат. номер									
1 PRS-26	26	1,5–15 мл	10–16 мм	BS-010117-GK									
Дополнительные:													
2 PRS-5/12	5 и 12	до 50 и 1,5–15 мл	20–30 и 10–16 мм	BS-010117-НК									
3 PRS-10	10	до 50 мл	20–30 мм	BS-010117-ИК									
4 PRSC-22	22	15 мл	16 мм	BS-010117-LK									
5 PRSC-10	10	50 мл	BS-010117-JK	6 M-8/50	8	50 мл	25–30 мм	BS-010117-PK	7 PRS-1DP	Платформа для глубоколоночных планшетов и штативов для высоких пробирок 0,5 и 1 мл (например, Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX)			BS-010149-DK
6 M-8/50	8	50 мл	25–30 мм	BS-010117-PK									
7 PRS-1DP	Платформа для глубоколоночных планшетов и штативов для высоких пробирок 0,5 и 1 мл (например, Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX)			BS-010149-DK									

1 PRS-26



2 PRS-5/12



3 PRS-10



4 PRSC-22



5 PRSC-10



6 M-8/50



7 PRS-1DP



Платформа с клипсами на PRSC-10



**PRS** — платформы с универсальными резиновыми зажимами для пробирок.

**PRSC** — оснащенные клипсами платформы, способные выдерживать пробирки с более тяжелыми растворами (песок, почва и т.д.).

## Платформы для Multi RS-60

Стандартные:	Вместимость	Объем пробирок	Диаметр пробирок	Кат. номер
1 PRS-48	48	1,5–15 мл	10–16 мм	BS-010118-СК
Дополнительные:				
2 PRS-8/22	8 и 22	до 50 и 1,5–15 мл	20–30 и 10–16 мм	BS-010118-AK
3 PRS-14	14	до 50 мл	20–30 мм	BS-010118-BK

1 PRS-48



2 PRS-8/22



3 PRS-14



Basic Plus  
Product Class



Видео  
работы  
прибора



Вертикальное  
вращение 360°



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

Bio RS-24 в движении



## Bio RS-24, Мини-ротатор

Мини-ротатор **Bio RS-24** осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор – идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Прибор прост в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим бюджетом. Может эксплуатироваться в закрытых лабораторных помещениях, инкубаторах (кроме CO<sub>2</sub> инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.

Диапазон регулирования скорости	5–30 об/мин
Вертикальное вращение	360°
Цифровая установка времени	1 мин. – 24 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера	+
Максимальное время непрерывной работы	8 ч.
Размеры (Д×Ш×В)	325 × 190 × 155 мм
Вес	1,4 кг
Рекомендуемая нагрузка от номинального объема	75%
Потребляемый ток/мощность	12 В, 110 мА/1,3 Вт
Внешний блок питания	вход АС 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: Кат. номер

<b>Bio RS-24</b> со станд. платформой <b>PRS-22</b>	BS-010133-AAG
<b>Дополнительные платформы:</b>	
<b>PRS-4/12</b>	BS-010117-AK
<b>PRSC-18</b>	BS-010117-EK

Модель	Вместимость	Объем пробирок	Диаметр пробирок, Ø
1 PRS-22 (станд.)	22	1,5–15 мл	10–16 мм
2 PRS-4/12 (доп.)	4 и 12	до 50 и 1,5–15 мл	20–30 мм и 10–16 мм
3 PRSC-18 (доп.)	18	15 мл	16 мм

1 PRS-22



2 PRS-4/12



3 PRSC-18



**PRS** — платформы для пробирок с универсальными резиновыми зажимами.

**PRSC** — платформы, оснащенные клипсами, способные выдерживать пробирки с более тяжелыми растворами (песок, почва и т.д.).



## V-1 plus, Вортекс персональный и V-32, Мульти-вортекс

Вортекс **V-1 plus / V-32** предназначен для перемешивания образцов в пробирках при помощи механизма-эксцентрика.

Вортекс может быть использован для различных работ:

- Перемешивание образцов тканей;
- Взвешивание клеточных образцов;
- Перемешивание химических образцов;
- Перемешивание бактериальных и дрожжевых клеток при отмывании их от питательной среды;
- Вортексирование при метаболической экстракции из клеток и клеточных культур и т.д.

Вортекс может использоваться при проведении различных операций с ДНК/РНК, очистке низкомолекулярных фрагментов ДНК/РНК при проведении ПЦР-диагностики.

Вортекс можно использовать во всех областях лабораторных исследований по биотехнологии, микробиологии и медицине.

Вортекс имеет два режима работы:

- Продолжительное встряхивание;
  - Кратковременное встряхивание.
- (**V1 plus** — при нажатии на насадку)

Модель **V-1 plus** — это персональный вортекс с фторопластовой насадкой для вортексирования одной пробирки.

Модель **V-32** — это универсальный вортекс с разными насадками. Вместе с прибором в комплекте поставляется 32-местная универсальная платформа PV-32 для пробирок типа Эппендорф (1,5/0,5/0,2 мл – 16/8/8 гнезд) и насадка PL-1 для встряхивания одной пробирки с номинальным объемом до 50 мл. Дополнительно поставляется 6-местная насадка PV-6/10 для встряхивания 10 мл пробирок (максимальный диаметр пробирки 15 мм) и насадка PV-48 для 6 стрипов по 8 микропробирок объемом 0,2 мл.

Платформа PL-1 для V-32



Basic Plus  
Product Class



Видео  
работы  
прибора



Прибор зарегистрирован  
Министерством  
здравоохранения РФ

Ø 4 мм  
орбита



Вортекс

Basic Plus  
Product Class

V-32 с платформой PV-32



Ø 2 мм  
орбита



Вортекс

## V-1 plus, Вортекс персональный и V-32, Мульти-вортекс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	V-1 plus	V-32
Метод перемешивания	Виброэксцентричный	
Диапазон регулирования скорости	500–3000 об/мин	
Время ускорения	< 1 сек.	3 сек.
Время непрерывной работы	24 ч.	
Для пробирок объемом	от 0,2 до 50 мл	от 0,2 до 10 мл
Максимальный объем перемешивания	30 мл	45 мл
Максимальная нагрузка	30 г	70 г
Орбита	4 мм	2 мм
Размеры (Д×Ш×В)	90 × 150 × 80 мм	120 × 180 × 100 мм
Вес	0,8 кг	1,5 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 320 мА/3,8 Вт	
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц, выход DC 12 В	

V-1 Plus




V-1 Plus




V-1 Plus



Платформа PV-6/10 для V-32

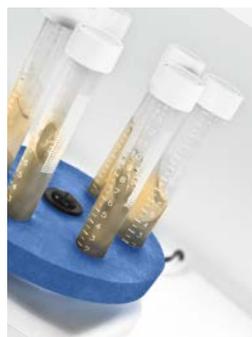

Платформа PV-48 для V-32

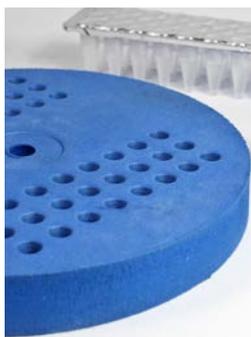

V-32 с платформой PV-48



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**V-1 plus**

**V-32** со станд. платформами PL-1 и PV-32

**Дополнительные платформы для V-32:**

**PV-6/10**, 6-местная платформа для 10 мл пробирок (макс. Ø 15 мм)

**PV-48**, платформа для 6 стрипов по 8 × 0,2 мл или для 48 пробирок по 0,2 мл

Кат. номер



BS-010203-AAG

BS-010207-AAG

BS-010207-BK

BS-010207-GK

## MSV-3500, Пробирочный вортекс

ОПИСАНИЕ

Пробирочный вортекс **MSV-3500** создан для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров (от 0,2 до 50 мл).

Пробирочный вортекс **MSV-3500** предназначен для life-science лабораторий, работающих в области биохимии, клеточной и молекулярной биологии.

Предусмотрены четыре (4) вида сменных платформ: для пробирок типа Эппендорф, для 10/15/50 мл пробирок диаметром 12/16/30 мм. Прибор можно приобрести как без платформ, так и в комплекте со всеми платформами.

Пробирочный вортекс **MSV-3500** снабжен жидкокристаллическим дисплеем, который отображает одновременно два ряда значений: установленные и текущие значения скорости и времени.

Благодаря высоким максимальным оборотам платформы эффективно перемешиваются микрообъемы образцов (объем менее 5 мкл).



MSV-3500  
с платформой SV-8/15



Ø 4 мм  
орбита



Вортекс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	300–3500* об/мин
Цифровая установка времени	0–60 мин./непрерывно (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Орбита	4 мм
Максимальная нагрузка	0,2 кг
Время непрерывной работы (макс.)	8 ч.
Размеры (Д×Ш×В)	180 × 170 × 145 мм
Вес	2,6 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 1 А/12 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100-240 В, 50/60 Гц, выход DC 12 В

\* — Макс. скорость зависит от нагрузки



**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:** Кат. номер


**MSV-3500** со всеми платформами BS-010210-TAH

**MSV-3500** без платформ BS-010210-AAH

Видео  
работы  
прибора

Дополнительные платформы:		Кат. номер
❶ SV-16/8	Платформа для 16 × 1,5 мл + 8 × 0,5 мл + 8 × 0,2 мл пробирок, Ø11/8/6 мм	BS-010210-CK
❷ SV-10/10	Платформа для 10 × 10 мл пробирок диаметром 12 мм	BS-010210-BK
❸ SV-8/15	Платформа для 8 × 15 мл пробирок диаметром 16 мм	BS-010210-DK
❹ SV-4/30	Платформа для 4 × 50 мл пробирок диаметром 30 мм	BS-010210-AK

❶ SV-16/8



❷ SV-10/10



❸ SV-8/15



❹ SV-4/30



Basic Plus  
Product Class



**АНОНС RCP-24, Гомогенизатор**

Гомогенизатор **RCP-24**, настольное механическое устройство, предназначенное для перемешивания, измельчения, гомогенизации, эмульгирования биологических объектов в микропробирках за счет встряхивания с твердыми шариками с целью пробоподготовки для последующих академических, фармацевтических, биотехнологических или биомедицинских исследований.

Инструмент облегчает образование супернатанта, содержащего нуклеиновые кислоты и белки, подходящие для последующей очистки, экстракции или анализа. Инструмент оптимизирован для извлечения ДНК, РНК или тРНК из различных источников ткани. Его можно также использовать для других применений, в которых требуется разрушение тканей и клеток. Этот прибор выполняет эффективную гомогенизацию ткани млекопитающих, растительной ткани или других материалов.

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество мест для пробирок	до 24
Пробирки	2 мл
Диапазон регулирования скорости	100–2000 об/мин (шаг 100 об/мин)
Диапазон регулирования времени	1–15 мин. (шаг 1 мин.)
Амплитуда осцилляции	44 мм, вертикально
Размеры прибора (Д×Ш×В)	285 × 400 × 440 мм
Потребляемый ток / мощность	230 В, 50 Гц / 220 Вт (1,3 А)
Вес	19,1 кг





# ТЕРМОШЕЙКЕРЫ



**PST-60HL**

Термошейкер для планшетов



**TS-100C**

Термошейкер для микропробирок  
и ПЦР планшетов



**TS-DW**

Термошейкер  
для глубоколоночных планшетов

## PST-60HL, PST-60HL-4 и PST-100HL, Термошейкеры для планшетов

Термошейкеры моделей **PST-60HL**, **PST-60HL-4** и **PST-100HL** предназначены для перемешивания образцов в стандартных 96-луночных планшетах (96-well microtiter plates) в режиме термостатирования. Модели **PST-60HL** и **PST-100HL** вмещают 2 планшета, модель **PST-60HL-4** вмещает 4 планшета.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию и управление прибором, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов:

- Инкубатора
- Планшетного шейкера
- Термошейкера

Отличительной особенностью иммуноплатшетных термошейкеров является наличие запатентованного фирмой Биосан двухстороннего нагрева планшета, позволяющего достичь полного соответствия установленной и реальной температуры в лунках планшетов. Стандартные версии термошейкеров предусматривают нагрев до 60°C, что является достаточным для проведения реакции ИФА.

Специально для реакции гибридизации разработана версия термошейкера PST-100HL с возможностью температурной стабилизации до 100°C.

### Термошейкер обеспечивает:

- Мягкое или интенсивное перемешивание образцов;
- Регулирование, стабилизацию и индикацию скорости вращения;
- Равную амплитуду вращения по всей платформе термошейкера;
- Установку и индикацию рабочего времени;
- Автоматическую остановку движения по истечении установленного интервала времени;
- Установку и индикацию температуры платформы;
- Автодиагностику неисправностей (температурных датчиков, нагревателя платформы, нагревателя крышки и др.);
- Пользователь может откалибровать прибор для компенсации отличий в теплопроводимости планшетов от разных производителей с помощью встроенной функции калибровки; (**PST-60HL**, **PST-60HL-4**).

### Термошейкеры PST могут применяться в различных сферах таких как:

- **Иммунохимия** — ELISA (ИФА - Иммуноферментный анализ). Уникальный одновременный, двухсторонний (сверху и снизу) подогрев с перемешиванием обеспечивает наиболее качественную реакцию между аналитом и адсорбентом что, в свою очередь позволяет достигать наилучшего результата;
- **Молекулярная биология** — Микро и макро чипы - инкубация в термошейкере позволяет достичь наиболее качественную гибридизацию проб, напечатанных на чипе с ДНК-мишенью. (Необходим специальный держатель).



Прибор PST-60HL-4 зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ



Ø 2 мм  
орбита

PST-60HL



Видео  
работы  
PST-60HL



Ø 2 мм  
орбита

PST-60HL-4



Ø 2 мм  
орбита


PST-100HL




## PST-60HL, PST-60HL-4 и PST-100HL, Термошейкеры для планшетов

	PST-60HL	PST-60HL-4	PST-100HL
Диапазон установки температуры	+25°C... +60°C		+25°C... +100°C
Диапазон регулирования температуры	+5°C выше комн. ... +60°C		+5°C выше комн. ... +100°C
Шаг установки температуры	0,1°C		
Стабильность температуры	±0,1°C		
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0,25°C		±0,2°C
Диапазон калибровки темп. коэф.	0,936–1,063 (±0,063)		—
Нагрев	Двухсторонний обогрев планшет (платформа и крышка)		Двухсторонний обогрев планшет (платформа и крышка) + двойной контур обогрева платформы
Орбита	2 мм		
Диапазон регулирования скорости	250–1200 об/мин (шаг 10 об/мин)		
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)		
Звуковой сигнал таймера	+		
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков		
Макс. высота планшета	18 мм		
Кол-во планшетов на платформе	2	4	2
Вес	6,1 кг	8,8 кг	5,9 кг
Размеры платформы (Д×Ш)	250 × 150 мм	290 × 210 мм	250 × 150 мм
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	270 × 260 × 125 мм	380 × 390 × 140 мм	270 × 260 × 125 мм
Потребляемый ток/мощность	12 В DC, 3,3 А/40 Вт	12 В DC, 4,15 А/50 Вт	12 В, 5 А/60 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100–240, В 50/60 Гц; выход DC 12 В		
Зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ	—	+	—

### Время нагрева PST-60HL и PST-60HL-4



### Время нагрева PST-100HL



PST-60HL-4 пружинные зажимы



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**PST-60HL**  
**PST-60HL-4**  
**PST-100HL**

Кат. номер

BS-010119-AAI  
BS-010128-AAI  
BS-010142-AAI

## TS-100, TS-100C и TS-100C Smart, Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшето

ОПИСАНИЕ

Термошейкеры **TS-100**, **TS-100C** и **TS-100C Smart** предназначены для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках и ПЦР планшетах в условиях температурного контроля. Термошейкеры **TS-100C** и **TS-100C Smart** отличаются от модели **TS-100** возможностью охлаждения образцов до +4°C. Функции **TS-100**, **TS-100C** и **TS-100C Smart** отвечают повышенным требованиям пользователя, включая:

- Быстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержание равной амплитуды вращения по всему блоку термошейкера;
- Стабильное поддержание температуры в широком диапазоне по всей поверхности термоблока;
- Функция калибровки температуры, позволяющая пользователю калибровать прибор в пределах  $\pm 6\%$  для компенсации разницы в термических свойствах пробирок от разных производителей;
- Отображение установленных и текущих значений температуры, скорости и времени работы на жидкокристаллическом дисплее;
- Тихая работа двигателя, компактный размер прибора, продолжительный срок службы.

Термошейкер может выполнять функции нагрева и перемешивания как одновременно, так и независимо друг от друга, что позволяет использовать термошейкеры **TS-100**, **TS-100C** и **TS-100C Smart** в качестве трёх независимых приборов:

- Термостат
- Шейкер
- Термошейкер

Предлагаем пять типов алюминиевых термоблоков для микропробирок объемом от 0,2 мл до 2 мл, в том числе и термоблок с крышкой для ПЦР-планшетов. Все термоблоки взаимозаменяемы (среди одной модели термошейкера) и легко устанавливаются на термошейкере.



TS-100

Видео  
работы TS-100



TS-100C

Видео  
работы TS-100C

### НОВИНКА

**Новая модель позволяет осуществлять управление прибором в следующих режимах:**

1. Мануальное, используя интерфейс фронтальной панели.
2. Через компьютерную программу используя технологию Bluetooth®

**Программное обеспечение позволяет управлять следующими параметрами:**

- Скорость вращения
- Температура
- Время
- Звуковой сигнал
- Создание профилирующих программ с использованием контролируемых параметров
- Визуализация диаграмм температуры по времени и скорости по времени
- Экспорт данных в формат Excel и CSV.
- Сообщения об ошибках / диагностика неисправностей

К одному компьютеру возможно подключить до 7 приборов с независимой настройкой параметров.



TS-100C Smart




Bluetooth®  
соединение

## TS-100, TS-100C и TS-100C Smart, Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшето

	TS-100	TS-100C, TS-100C Smart
Диапазон установки температуры	+25°C ... +100°C	+4°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +100°C	15°C ниже комн. ... +100°C
Шаг установки температуры		0,1°C
Стабильность температуры		±0,1°C
Точность поддержания темп. при +37°		±0,5°C
Средняя скорость нагрева	4°C/мин от +25°C до +100°C	5°C/мин от +25°C до +100°C
Средняя скорость охлаждения:	—	от +100°C до +25°C от +25°C до +4°C
		5°C/мин 1,8°C/мин
Равномерность распределения темп.	при +37°C ±0,1°C при +60°C ±0,2°C при +100°C ±0,2°C	при +4°C ±0,6°C при +37°C ±0,1°C при +100°C ±0,3°C
Диапазон калибровки темп. коэф.		0,936–1,063 (±0,063)
Диапазон регулирования скорости		250–1400 об/мин
Время разгона до макс.		3 сек.
Орбита		2 мм
Дисплей		ЖК, 2 × 16 знаков
Микропроцессор, контролирующий время, скорость и температуру		
Цифровая установка времени		1 мин. – 96 ч. (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера		+
Макс. время непрерывной работы		96 часов
Размеры, без блока (Д×Ш×В)		220 × 240 × 90 мм
Вес		3,7 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 3,5 А/42 Вт	12 В, 4,9 А/60 Вт
Внешний блок питания		вход АС 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В
Программное обеспечение	—	только для TS-100C Smart

### Время нагрева TS-100:



### Время нагрева и охлаждения TS-100C и TS-100C Smart:



Термошейкер предназначен для разных задач таких как:

- **Молекулярная диагностика** — Лизис образцов для последующего выделения нуклеиновых кислот ручным или автоматическим методом;
- **Генетика** — Денатурация ампликонов перед секвенированием NGS;
- **Биохимия** — Энзиматические реакции;
- **Геномика** — Исследования деградации протеинов;
- **Клеточная биология** — Экстракция метаболитов из клеточного материала (дебриса).

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

 Кат. номер 
**TS-100** без блока

BS-010120-AAI

**TS-100C** без блока

BS-010143-AAI

**TS-100C Smart** с программным обеспечением, без блока

BS-010171-A01

Описание и фотографии всех блоков смотрите на следующей странице

## Блоки для термошейкера TS-100

Сменные блоки:	Вместимость	Объем	Кат. номер
❶ SC-18	20 и 12 пробирок	0,5 мл и 1,5 мл	BS-010120-AK
❷ SC-18/02	20 и 12 пробирок	0,2 мл и 1,5 мл	BS-010120-CK
❸ SC-24	24 пробирки	2 мл	BS-010120-EK
❹ SC-24N	24 пробирки	1,5 мл	BS-010120-GK
❺ SC-96A	96-луночный ПЦР планшет без юбки или с полуюбкой (0,2 мл)		BS-010120-FK

❶ SC-18



❷ SC-18/02



❸ SC-24



❹ SC-24N



❺ SC-96A



## Блоки для термошейкера TS-100C и TS-100C Smart

Сменные блоки:	Вместимость	Объем	Кат. номер
❶ SC-18C	20 и 12 пробирок	0,5 мл и 1,5 мл	BS-010143-AK
❷ SC-18/02C	20 и 12 пробирок	0,2 мл и 1,5 мл	BS-010143-CK
❸ SC-24C	24 пробирки	2 мл	BS-010143-EK
❹ SC-24NC	24 пробирки	1,5 мл	BS-010143-GK
❺ SC-96AC	96-луночный ПЦР планшет без юбки или с полуюбкой (0,2 мл)		BS-010143-FK

❶ SC-18C



❷ SC-18/02C



❸ SC-24C



❹ SC-24NC



❺ SC-96AC



# TS-DW, Термошейкер для глубоколоночных планшетов



ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

## 1 Блок В-2Е



Платформа для планшета является съемной и может быть изготовлена по заказу.

### Термошейкер обеспечивает:

- Мягкое или интенсивное перемешивание образцов
- Регулирование, стабилизацию и индикацию скорости вращения
- Превосходную равномерность распределения температуры в планшете
- Равную амплитуду вращения по всей платформе термошейкера
- Установку и индикацию рабочего времени
- Автоматическую остановку движения по истечении установленного интервала времени
- Установку и индикацию температуры платформы
- Разнообразие сменных блоков, предназначенных для различных глубоколоночных планшетов
- Автодиагностику неисправностей (температурных датчиков, нагревателя платформы, нагревателя крышки и др.)

### Области применения:

- **Цитохимия** — для проведения реакций *in situ*
- **Иммунохимия** — для проведения иммуноферментной реакции (ИФА)
- **Биохимия** — для анализа белков и ферментов
- **Молекулярная биология** — выделение нуклеиновых кислот

**TS-DW**, термошейкер предназначен для перемешивания образцов в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термошейкера.

**TS-DW** обеспечивает превосходную равномерность распределения температуры в планшете благодаря запатентованному двустороннему нагреву блока и крышки и контурному нагреву блока, а также непосредственной близости нагревательных элементов к стенкам планшета.

Предлагаем ряд взаимозаменяемых блоков, разработанных для различных глубоколоночных планшетов, таких как Eppendorf® 96/1000 мкл, Sarstedt® Megablock 96/2200 мкл, Corning Axygen® 96/600 мкл, Starlab® 96/1200 мкл. и др. (см. таблицу ниже). Кроме того, мы можем изготовить индивидуальные блоки по запросу.

Диапазон установки температуры	+25°C ... +100°C
Диапазон регулирования темп.	5°C выше комн. ... +100°C
Шаг установки температуры	0,1°C
Равномерность распределения темп. при 37°C	±0,1°C*
Стабильность температуры при 37°C	±0,5°C*
Время нагрева термоблока от +25°C до +37°C	6 мин.*
Диапазон калировки темп. коэф.	0.936 – 1.063 (± 0.063)
Диапазон регулирования скорости	250–1400 об/мин
Орбита	2 мм
Дисплей	LCD, 2 × 16 знаков
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера	+
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	240 × 260 × 160 мм
Вес	5,1 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 4,8 А/58 Вт
Внешний блок питания	Вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В

\* — Для блока В-2Е

### По желанию заказчиков возможно изготовление блоков для следующих планшетов

Глубоколоночный планшет NUNC®	96/2000 мкл
Глубоколоночный планшет Eppendorf®	96/0,5 мл

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**TS-DW** без блока BS-010159-A02

Сменные блоки:		Кат. номер
1 В-2Е	Блок для одного глубоколоночного планшета Eppendorf® 96/1000 мкл	BS-010159-AK
2 В-2S	Блок для одного глубоколоночного планшета Sarstedt® Megablock 96/2200 мкл	BS-010159-CK
3 В-2P	Блок для одного глубоколоночного планшета Porvair® 96/2000 мкл	BS-010159-EK
4 В-2A	Блок для одного глубоколоночного планшета Axygen® 96/2200 мкл	BS-010159-FK
5 В-06А	Блок для одного глубоколоночного планшета Corning Axygen® 96/600 мкл	BS-010159-KK



# МИНИ-ЦЕНТРИФУГИ-ВОРТЕКСЫ, МИНИ-ЦЕНТРИФУГА, ЦЕНТРИФУГИ



**FVL-2400N**

Мини-центрифуга-вортекс  
Комби-Спин



**MSC-6000**

Центрифуга-вортекс  
Мульти-Спин



**CVP-2**

Центрифуга-вортекс  
для ПЦР-планшетов

## FV-2400, Мини-центрифуга-вortex Микроспин и FVL-2400N, Мини-центрифуга-вortex Комби-Спин

ОПИСАНИЕ

Мини-центрифуги-вortexы Микроспин **FV-2400** и Комби-Спин **FVL-2400N** разработаны специально для генно-инженерных исследований (экспериментов в ПЦР-диагностике). Используются в биомедицинских и биотехнологических лабораториях.

Мини-центрифуги-вortexы обеспечивают возможность одновременного центрифугирования 12 микротест пробирок и последующего индивидуального перемешивания образца в пробирке. Модули центрифугирования и перемешивания выполнены единым блоком. Последовательное сочетание этих операций позволяет полностью собрать исследуемый материал на дне пробирки.

**FV-2400** является традиционной центрифугой-вortexом «открытого типа» (без крышки), что повышает скорость проведения операций центрифугирования и ресуспендирования.

Центрифуга **FVL-2400N** имеет дизайн «Биоформа» и оснащена прозрачной защитной крышкой. Безопасность пользователя обеспечивается специальным механизмом, останавливающим вращение ротора при открытой крышке.

Ротор R-1.5



Basic Plus  
Product Class



FV-2400

Basic Plus  
Product Class



FVL-2400N

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	FV-2400	FVL-2400N
Постоянная скорость вращения		2800 об/мин
Относительная центробежная сила (RCF)		500 × g
Два режима работы – непрерывный и импульсный		
Безопасность	—	Автостоп при открытой крышке
Размеры (Д×Ш×В)	120 × 170 × 120 мм	190 × 235 × 125 мм
Вес	1,4 кг	1,7 кг
Питание	230 В, 50 Гц	120 или 230 В; 50 Гц
Потребляемая мощность (230 В)		30 Вт (0,13 А)

## Роторы для FV-2400 и FVL-2400N

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер 

**FV-2400** белый со станд. роторами **R-1.5M** и **R-0.5/0.2M**

BS-010201-AAA

**FVL-2400N** со станд. роторами **R-1.5** и **R-0.5/0.**

BS-010202-AAA

Роторы: смотрите таблицу ниже

Роторы для FV-2400:		Кол-во гнезд	Комплектация	Кат. номер
1 R-0.5/0.2M	12 × 0,5 мл и 12 × 0,2 мл пробирок	24	Стандартная	BS-010201-БК
2 R-1.5M	12 × 1,5/2 мл пробирок	12	Стандартная	BS-010201-АК
3 R-2/0.5	8 × 1,5/2 мл и 8 × 0,5 мл пробирок	16	По доп. заказу	BS-010205-СК
4 R-2/0.5/0.2	6 × 1,5/2 мл, 6 × 0,5 мл и 6 × 0,2 мл пробирок	18	По доп. заказу	BS-010205-ДК
5 SR-16	Два 8 × 0,2 мл стрипа	16	По доп. заказу	BS-010202-АК
6 SR-64*	Восемь 8 × 0,2 мл стрипов	64	По доп. заказу	BS-010201-ЕК

\* — Для любого типа стрипов, в т.ч. спаренных

1 R-0.5/0.2M



2 R-1.5M



3 R-2/0.5



4 R-2/0.5/0.2




5 SR-16



6 SR-64



Вортексирование пробирки на FV-2400

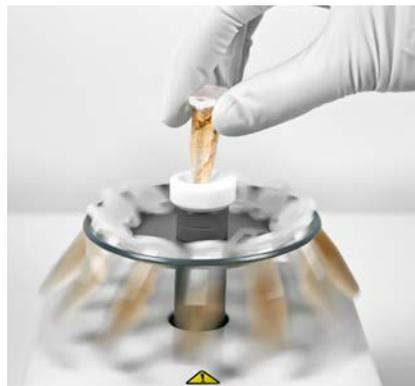


Роторы для FVL-2400N:		Кол-во гнезд	Комплектация	Кат. номер
1 R-0.5/0.2	12 × 0,5 мл и 12 × 0,2 мл пробирок	24	Стандартная	BS-010205-БК
2 R-1.5	12 × 1,5/2 мл пробирок	12	Стандартная	BS-010205-АК
3 R-2/0.5	8 × 1,5/2 мл и 8 × 0,5 мл пробирок	16	По доп. заказу	BS-010205-СК
4 R-2/0.5/0.2	6 × 1,5/2 мл, 6 × 0,5 мл и 6 × 0,2 мл пробирок	18	По доп. заказу	BS-010205-ДК
5 SR-16	Два 8 пробирочных стрипа для 0,2 мл пробирок	16	По доп. заказу	BS-010202-АК
6 SR-32*	Четыре 8 пробирочных стрипа для 0,2 мл пробирок	32	По доп. заказу	BS-010205-ФК

\* — Не совместимы с Мини-центрифугой-вортексом «Комбиспин» выпущенной до 2015 года

1 R-0.5/0.2




2 R-1.5



3 R-2/0.5



4 R-2/0.5/0.2



5 SR-16



6 SR-32



## MSC-3000 и MSC-6000, Центрифуги-вортексы Мульти-Спин

Центрифуга-вортекс Мульти-Спин является продуктом многолетней эволюции «Спин-Микс-Спин» – технологии, предназначенной для «сброса» микрообъемов реагентов на дно пробирки (первое центрифугирование – спин), последующего перемешивания (микс) и повторного сбора реагентов (повторный спин) со стенок и пробки микропробирок. Этот повторяющийся алгоритм операций, имеющий целью снизить ошибки пробоподготовки для ПЦР-анализа, мы назвали «смс-алгоритмом».

Мульти-Спин является полностью автоматизированным устройством, воспроизводит реализующим «смс-алгоритм» для 12 пробирок одновременно, позволяя значительно экономить время. Необходимый инструмент для ПЦР-анализа.

Мульти-Спин объединяет в себе 4 прибора:

1. Центрифуга  
Относительная центробежная сила:  
**MSC-3000:** до  $800 \times g$   
**MSC-6000:** до  $2350 \times g$
2. Вортекс (3 режима перемешивания: мягкое, среднее, жесткое. Регулируемое время вортексирования: 1–20 сек.)
3. Центрифуга/вортекс
4. Смс-циклер для реализации «смс-алгоритма»



Premium  
Product Class



Видео  
работы MSC-3000

Premium  
Product Class



Видео  
работы MSC-6000

### ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ С МУЛЬТИСПИН

Мульти-Спин MSC-3000 и MSC-6000 значительно экономят время проведения операций по сравнению с Комби-Спином FVL-2400N (предыдущая страница) благодаря автоматическому осуществлению вортексирования и центрифугирования, которые называются «смс-алгоритмом»



	FVL-2400N	MSC-3000	MSC-6000
Макс. скорость	2800 об/мин	3500 об/мин	6000 об/мин
Относительная центробежная сила (RCF)	$500 \times g$	$800 \times g$	$2350 \times g$
Кол-во вортексируемых пробирок	1 индивид.	12 одновременно	
Время проведения алгоритма «Спин-Микс-Спин» :			
для 2 пробирок	60 сек.	25 сек.	15 сек.
для 12 пробирок	5–6 мин	90 сек.	60 сек.
для 100 пробирок	60 мин	15 мин	10 мин
Пропорциональная стоимость прибора	1 ×	1,5 ×	1,6 ×

# MSC-3000 и MSC-6000, Центрифуги-вortexы Мульти-Спин

	MSC-3000	MSC-6000
Диапазон регулирования скорости (шаг 100 об/мин)	1000–3500 об/мин	1000–6000 об/мин
Относительная центробежная сила (RCF)	800 × g	2350 × g
Цифровая установка времени	1 с – 99 мин	1 с – 30 мин
Звуковой сигнал таймера	+	
Типы vortexирования	Мягкое, среднее, жесткое	
Время vortexирования	0–20 сек. (шаг 1 сек.)	
Программируемое число «смс-циклов»	1–999 циклов	
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков	
Меры безопасности	Автостоп при незакрытой крышке	Крышка оснащена замком
Размеры (Д×Ш×В)	190 × 235 × 125 мм	
Вес	2,1 кг	2,5 кг
Потребляемая мощность	12 В, 11 Вт (0,9 А)	24 В, 24 Вт (1 А)
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 24 В

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ротор R-1.5



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер


**MSC-3000** со станд. роторами **R-1.5, R-0.5/0.2** BS-010205-AAN

**MSC-6000** со станд. роторами **R-1.5, R-0.5/0.2** BS-010211-AAL

**Роторы:** смотрите таблицу ниже

Роторы:	Кол-во гнезд	Комплектация	Кат. номер	
<b>1 R-0.5/0.2</b>	12 × 0,5 мл и 12 × 0,2 мл пробирок	24	Стандартная	BS-010205-BK
<b>2 R-1.5</b>	12 × 1,5/2 мл пробирок	12	Стандартная	BS-010205-AK
<b>3 R-2/0.5</b>	8 × 1,5/2 мл и 8 × 0,5 мл пробирок	16	По доп. заказу	BS-010205-CK
<b>4 R-2/0.5/0.2</b>	6 × 1,5/2 мл, 6 × 0,5 мл и 6 × 0,2 мл пробирок	18	По доп. заказу	BS-010205-DK
<b>5 SR-16</b>	Два 8-пробирочных стрипа для 0,2 мл пробирок	16	По доп. заказу	BS-010202-AK
<b>6 SR-32*</b>	Четыре 8-пробирочных стрипа для 0,2 мл пробирок	32	По доп. заказу	BS-010205-FK

\* — Не совместим с Центрифугой-вortexом «Мультиспин» выпущенной до 2015 года

**1** R-0.5/0.2

**2** R-1.5

**3** R-2/0.5

**4** R-2/0.5/0.2

**5** SR-16

**6** SR-32


## CVP-2, Центрифуга-вортекс для ПЦР-планшетов

ОПИСАНИЕ

После многолетнего успеха концепции комбинированной центрифуги-вортекса мы с гордостью представляем на рынке приборов для прободготовки должжданную центрифугу-вортекс для ПЦР-планшетов **CVP-2**.

Технология «Спин-Микс-Спин» предназначена для сброса микрокапель реагентов на дно лунки (первое центрифугирование), последующего перемешивания (микс) и повторного сброса реагентов (повторное центрифугирование) со стенок и лунки. Цель этого повторяющегося алгоритма — снизить ошибки прободготовки для ПЦР-анализа. Мы назвали его «смс-алгоритмом». Данный алгоритм запатентован фирмой Биосан.

**CVP-2** является полностью автоматизированным устройством, воспроизводит реализующим «смс-алгоритм» для 2 ПЦР-планшет одновременно, позволяя значительно сэкономить время. Необходимый инструмент в лабораториях для ПЦР и ДНК-анализов.

**CVP-2** объединяет в себе 4 прибора:

1. Центрифуга для сброса капель — максимальная относительная центробежная сила:  $245 \times g$  (1500 об/мин)
2. Вортекс (300–1200 об/мин; таймер для регулирования вортексирования от 0 до 60 сек.)
3. Центрифуга-вортекс
4. Смс-циклер для реализации «смс-алгоритма»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулировки скорости центрифугирования	300–1500 об/мин
Мин. относительная центробежная сила (RCF) при 1500 об/мин	$175 \times g$
Диапазон регулирования скорости вортексирования	300–1200 об/мин
Шаг установки скорости	100 об/мин
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Цифровая установка времени для режима центрифуги	0–30 мин. (шаг 1 сек.; после 1 мин. – 1 мин.)
Цифровая установка времени для режима вортекса	0–60 с (шаг 1 сек.)
Звуковой сигнал таймера	+
Программируемое число «смс-циклов»	1–999
Диаметр рабочей камеры	210 мм
Размеры (Д×Ш×В)	285 × 350 × 190 мм
Вес	6,15 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 1,5 А/18 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц, выход DC 12 В



**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:** Кат. номер

**CVP-2** BS-010219-A02

С ротором для двух ПЦР-планшетов, защитной крышкой и с адаптерами AP-96\* (2 адаптера для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки)

**AP-384\*** BS-010219-EK

2 адаптера для 384-луночных планшетов

Premium  
Product Class



Видео работы прибора

Адаптеры AP-96 для ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки



Адаптер AP-384 для 384-луночных планшетов



Типы планшетов:

**Без адаптера:**  
96-луночные ПЦР-планшеты с юбкой, ПЦР-стрипы в рамке;

**С адаптером AP-96:**  
96-луночные ПЦР-планшеты с полуюбкой и без юбки

**С адаптером AP-384:**  
384-луночные планшеты

\* — Адаптеры сделаны из Ertacetal® С. Автоклавируемы

## Microspin 12, Высокоскоростная мини-центрифуга

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Basic Plus  
Product Class



Видео  
работы  
прибора



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ



Защитная крышка  
для ротора



1 A-02 адаптеры



2 A-05 адаптеры



Высокоскоростная мини-центрифуга **Microspin 12** представляет собой компактную настольную центрифугу, разработанную для медико-биологических лабораторий.

**Microspin 12** используется при выделении РНК/ДНК, осаждении биологических компонентов, в биохимических и химических анализах микропроб веществ.

Дисплей показывает одновременно три ряда значений:

1. Время центрифугирования;
2. Установленные и текущие значения скорости;
3. Относительную центробежную силу.

Бесщеточный двигатель обеспечивает бесшумную работу при максимальных скоростях и длительный срок эксплуатации прибора. Угловой ротор предназначен для 12 микропробирок типа Эппендорф, а также для спин-колонок. Ротор изготовлен из алюминия, оснащен фиксирующей крышкой и включен в стандартную комплектацию центрифуги. Постоянный обдув ротора во время работы снижает риск перегрева образцов.

Металлические защитные вставки во внутренних частях корпуса и крышки центрифуги, автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу. Окончание работы центрифуги сопровождается звуковым сигналом.

Внешний блок питания позволяет эксплуатировать **Microspin 12** в холодных комнатах (при температуре окружающей среды от +4°C до +40°C).

Диапазон регулируемой скорости	1000–14 500 об/мин (шаг 100 об/мин)
Относительная центробежная сила	50–12 400 × g
Цифровая установка времени	15 сек. – 30 мин
Звуковой сигнал таймера	+
Шаг установки таймера	шаг до 1 мин. – 15 сек. после 1 мин. – 1 мин.
Время разгона до макс. скорости (14 500 об/мин)	20 сек.
Время торможения, не более	10 сек.
Дисплей	ЖК, 2 строки
Диагностика несбалансированности ротора	
Размеры (Д×Ш×В)	200 × 240 × 125 мм
Вес	3,5 кг
Потребляемый ток/мощность	24 В, 2,5 А/60 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц, выход DC 24 В

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер



**Microspin 12** BS-010213-AA1  
Со встроенным ротором MSR-12 (12 гнезд для пробирок 1,5/2 мл), с защитной крышкой MSL-SC и адаптерами A-02, A-05

#### Принадлежности:

MSL-SC, защитная крышка для ротора	BS-010213-EK
1 A-02, 12 адаптеров × 0,2 мл пробирок	BS-010213-BK
2 A-05, 12 адаптеров × 0,5 мл пробирок	BS-010213-AK

## LMC-3000, Центрифуга медицинская лабораторная

ОПИСАНИЕ

**LMC-3000** современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл, иммунопланшетами и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

### Особенности:

- Удобный ввод параметров центрифугирования (скорости и времени) и одновременное отображение на дисплее как установленных, так и реальных значений
- Безопасное проведение анализов: металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу на всех скоростях
- Низкий уровень шума
- Плавный пуск и остановка ротора
- Выбор ротора
- Преобразование об/мин в RCF (Относительная Центробежная Сила) Выбор режима набора скорости (Медленно, Средне, Быстро), торможения (0, Медленно, Средне, Быстро) и возможность отключения принудительного торможения
- Широкий выбор роторов (см. стр. 54)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Регулируемая скорость для пробирок	100–3000 об/мин (1610 × g)
------------------------------------	-------------------------------

Регулируемая скорость для планшетов	100–2000 об/мин (560 × g)
-------------------------------------	------------------------------

Шаг установки скорости	100 об/мин
------------------------	------------

Диагностика дисбаланса ротора (автоматическая остановка, предупреждение IMBALANCE)

Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
---------	-------------------

Цифровая установка времени	1–90 мин. (шаг 1 мин.)
----------------------------	---------------------------

Звуковой сигнал таймера	+
-------------------------	---

Диаметр рабочего объема	340 мм
-------------------------	--------

Размеры (Д×Ш×В)	495 × 410 × 235 мм
-----------------	--------------------

Вес	11,8 кг
-----	---------

Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц
---------	-------------------------------------


Потребляемая мощность (230/120 В)	110 Вт (0,5 А)/ 120 Вт (1 А)
-----------------------------------	---------------------------------



**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:** Кат. номер

**LMC-3000** без ротора BS-010208-AAA

Basic Plus  
Product Class



Видео работы прибора



Ротор R-12/15



Описание и фотографии всех роторов см. на стр. 54

## LMC-4200R, Центрифуга лабораторная с охлаждением



Видео  
работы  
прибора



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

Ротор R-24/10



**Описание и фотографии  
всех роторов см. на стр. 54**

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия для воспроизводимости этапа пробоподготовки. Отсутствие температурного контроля на данном этапе приводит к непредсказуемым результатам

**LMC-4200R** — современная центрифуга, предназначенная для работы с микропланшетами, а также иммунопланшетами, лабораторными пробирками от 2 до 50 мл и гелевыми картами.

### Особенности:

- Низкий уровень шума
- Удобный режим набора скорости и остановки: разгон за 20 сек. торможение до полной остановки: до 30 сек.
- Эффективная скорость охлаждения камеры: до 10 мин.
- Стабильность поддержания установленной температуры во время работы
- Удобный ввод параметров центрифугирования (скорости, температуры и времени) и отображение на дисплее как установленных, так и реальных значений
- Безопасное проведение анализов: металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое отключение при дисбалансе (аварийный стоп, индикация IMBALANCE), а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу
- Возможно отключение принудительного торможения
- Широкий выбор роторов (см. стр. 54)
- Выбор ротора
- Преобразование об/мин в RCF (Относительная Центробежная Сила)
- Выбор режима набора скорости (Медленно, Средне, Быстро), торможения (0, Медленно, Средне, Быстро) и возможность отключения принудительного торможения

Диапазон установки температуры -10°C ... +25°C

Диапазон регулирования температуры 25°C ниже комн. до +25°C

Шаг установки температуры 1°C

Регулируемая скорость для пробирок 100–4200 об/мин (3160 × g)

Регулируемая скорость для планшетов 100–2000 об/мин (560 × g)

Шаг установки скорости 100 об/мин

Диагностика несбалансированности ротора (автоматическая остановка, предупреждение IMBALANCE)

Время остановки вращения ротора, не более 30 сек.

Дисплей ЖК, 2 строки

Цифровая установка времени 1–90 мин. (шаг 1 мин.)

Звуковой сигнал таймера

Диаметр рабочей камеры 360 мм

Размеры (Д×Ш×В) 635 × 580 × 335 мм

Вес 56 кг

Питание 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность (230 В) 990 Вт (4,3 А)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**LMC-4200R** без ротора

BS-010212-AAA

## Взаимозаменяемые роторы для LMC-3000 и LMC-4200R



Штатив RR-U

	Ротор R-12/10	Ротор R-24/10	Ротор R-6	Ротор R-6P
Тип ротора	Колебательный (Swing-out)			
Размеры пробирок (Ø × длина)	16 × 105 мм		29 × 115 мм	
Количество мест	12	24	6	
Объем	10–15 мл		50 мл	
Макс. скорость	4200 об/мин	4000 об/мин	4200 об/мин	
Макс. RCF:	LMC-3000	Не применяется	1610 × g	
	LMC-4200R	3160 × g	3160 × g	
Кат. номер:	BS-010208-BK	BS-010212-JK	BS-010208-DK	BS-010208-XK




ГИД ПО ВЫБОРУ РОТОРОВ

### Пластиковые пробирки с коническим дном и крышкой

Производители: **Falcon, Greiner Bio-one, Sarstead, Corning, Nunc, TPP** и т.д.




15 мл



R-12/15




50 мл



Материал: Алюминий



R-6



Материал: Kocetal® POM I (Макс. температура +150°C)



R-6P

### Пластиковые пробирки с круглым дном, вакутайнеры

Производители: **Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP** и т.д.



12 шт.



2–10 мл


Адаптеры

+



R-12/10

24 шт.



2–10 мл

Адаптеры

+



R-24/10

Только для LMC-4200R

10–15 мл

## Взаимозаменяемые роторы для LMC-3000 и LMC-4200R




Штатив RR-U



Ротор R-12/15	Ротор R-2		Ротор R-24GC
Угловой колебательный (Angled Swing-out)	Тип ротора		Колебательный (Swing-out)
17 × 120 мм	Размеры (Д×Ш)	128 × 85,6 мм	53 × 74 мм
12	Количество мест	2	24
15 мл	Макс. высота	до 45 мм	—
4200 об/мин	Макс. скорость	2000 об/мин	1500 об/мин
1610 × g	Макс. RCF:	560 × g	280 × g
3160 × g		560 × g	280 × g
BS-010208-EK	Кат. номер:	BS-010208-AK	BS-010208-VK

Стандартные 96-луночные планшеты, ПЦР-планшеты с юбкой и глубоколоночные до 45 мм высотой


Производители: **Nunc, Greiner, Greiner Bio-one** и т.д



R-2


96-луночные ПЦР-планшеты с полуюбкой и без юбки

Производители: **Nunc, Greiner, Greiner Bio-one** и т.д



Адаптер

AP-96



R-2

Материал: **Ertacetal® POM-C**. Автоклавируемый

Гелевые карты

Производители: **Grifols®, DiaMed®** и т.д



Ротор **R-24GC** предназначен для гелевых ID-карт, применяемых в серологических тестах для определения группы крови, резус-фактора и скрининга антител. Рекомендованное время центрифугирования 9 мин.



R-24GC

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:** доп. принадлежности для роторов

Кат. номер

**Адаптеры\*** для R-2:

**AP-96** 2 адаптера для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки

BS-010219-DK

**Адаптеры\*\*** для R-12/10, R-24/10: Размеры вакутайнеров (Ø × длина)

**BN-13/75** для вакутайнеров® 2–5 мл 13 × 80 мм

BS-010208-PK

**BN-13/100** для вакутайнеров® 4–8 мл 13 × 105 мм

BS-010208-QK

**BN-16/100** для вакутайнеров® 8–10 мл 16 × 105 мм

BS-010208-RK

**Штатив для роторов**

**RR-U**

BS-010208-UK

\* — Комплект из 2 адаптеров, сделанных из **Ertacetal® POM-C**. Автоклавируемый

\*\* — Комплект из 12 адаптеров, сделанных из **Kocetal® POM**. Макс. температура +100°C



ГИД ПО ВЫБОРУ РОТОРОВ





# ТЕРМОСТАТЫ ТИПА «ДРАЙ-БЛОК», СИСТЕМЫ НАГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ



## CH-100

Термостат с функцией  
охлаждения и нагрева



## CH 3-150

Термостат с функцией  
охлаждения и нагрева,  
Combitherm-2



## TDB-120

Термостат типа «Драй-блок»

## Bio TDB-100 и TDB-120, Термостаты типа «Драй-блок»

ОПИСАНИЕ

**Bio TDB-100 / TDB-120** – компактный, простой в использовании термостат для микропробирок. Разработан специально для длительной инкубации в различных диапазонах температур. Термостаты имеют неоспоримые преимущества при работе с микроколичествами реагентов, используемых в микропробирках. Отличается беспрецедентно высокой точностью и равномерностью распределения температуры по блоку.

Термостаты имеют функцию калибровки, позволяющую пользователю калибровать прибор в пределах нескольких процентов для компенсации разницы в термических свойствах пробирок от разных производителей.



Прибор **TDB-120** зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ



Спецификация блоков (встроены в прибор):

### Bio TDB-100

1 Блок 24 × 2,1,5 мл + 15 × 0,5 мл + 10 × 0,2 мл микропробирок

### TDB-120

2 Блок А-53 21 × 0,5 мл + 32 × 1,5 мл микропробирок

3 Блок А-103 21 × 0,5 мл + 32 × 1,5 мл + 50 × 0,2 мл микропробирок

1 Блок для Bio TDB-100



Basic Plus  
Product Class



Видео работы Bio TDB-100

Время нагрева **Bio TDB-100**:



Basic Plus  
Product Class



Видео работы TDB-120

Время нагрева **TDB-120**:



## Bio TDB-100 и TDB-120, Термостаты типа «Драй-блок»

	Bio TDB-100	TDB-120
Диапазон установки температуры	+25°C ... +100°C	+25°C ... +120°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +100°C	5°C выше комн. ... +120°C
Шаг установки температуры		0,1°C
Стабильность температуры		±0,1°C
Равномерность распределения температуры по блоку при 37°C		±0,1°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0,936 – 1,063 (± 0,063)	0,968 – 1,031 (± 0,031)
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)	
Звуковой сигнал таймера	+	
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков	
Вместимость блока	24 × 2/1,5 мл + 15 × 0,5 мл + 10 × 0,2 мл микропробирок	A-53 21 × 0,5 мл + 32 × 1,5 мл микропробирок A-103 21 × 0,5 мл + 32 × 1,5 мл + 50 × 0,2 мл микропробирок
Размеры (Д×Ш×В)	210 × 230 × 115 мм	230 × 210 × 110 мм
Вес	2,8 кг	
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	200 Вт (870 мА)	

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер



Bio TDB-100 со встроенным блоком

BS-010412-AAА

TDB-120 со встроенным блоком А-103

BS-010401-QAA

TDB-120 со встроенным блоком А-53


BS-010401-PAА



2 Блок А-53



3 Блок А-103

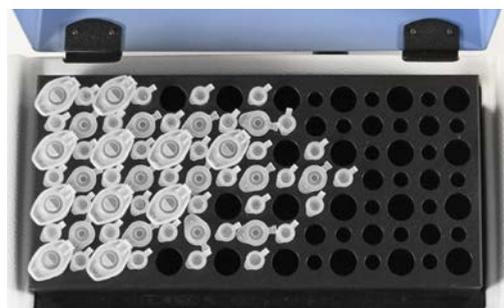

## CH-100, Термостат с функцией охлаждения и нагрева

ОПИСАНИЕ

**CH-100**, Термостат типа «dry block» предназначен для равномерного нагрева, охлаждения и поддержания установленной температуры в блоке, имеющем специальные гнезда для пробирок объема 0,5–2 мл.

Термостат обеспечивает хорошую теплопроводность и равномерность поддержания температуры по всему блоку.

Комбинированная конструкция алюминиевого блока для пробирок и модуля элементов Пельтье, охлаждаемого радиатором с принудительной вентиляцией, позволяет добиться быстрой смены режимов охлаждения и нагрева.

**CH-100** является эффективным инструментом пробоподготовки для постановки ферментативных реакций, реакций гибридизации, пробоподготовки ДНК.

Применяется в научных и клинико-диагностических лабораториях биомедицинского профиля.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры –10°C ... +100°C

Диапазон регулирования температуры 30°C ниже комн. температуры ... +100°C

Шаг установки температуры 0,1°C

Стабильность температуры ±0,1°C

Равномерность распределения температуры по блоку при 37°C ±0,25°C

Диапазон калибровки темп. коэф. 0,936–1,063 (± 0,063)

Цифровая установка времени 1 мин. – 96 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)

Звуковой сигнал таймера +

Дисплей ЖК, 2 × 16 знаков

Размеры (Д×Ш×В) 240 × 260 × 165 мм

Вес 3,2 кг

Потребляемый ток/мощность 12 В, 4,4 А/55 Вт

Внешний блок питания вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**CH-100** с блоком **CH-1** BS-010410-BAI

**CH-100** с блоком **CH-2** BS-010410-CAI

**CH-100** с блоком **CH-3** BS-010410-UAI

Ледяной покров на блоке CH-2




Basic Plus  
Product Class



Видео работы прибора

### Время нагрева и охлаждения CH-100:

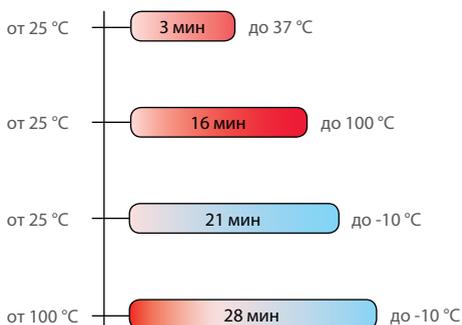

### Количество гнезд в блоках (встроены в прибор):

Блок **CH-1** 20 × 0,5 мл + 12 × 1,5 мл пробирок

Блок **CH-2** 20 × 1,5 мл пробирок

Блок **CH-3** 20 × 2 мл пробирок



# CH 3-150, Термостат с функцией охлаждения и нагрева, Combitherm-2

Premium  
Product Class



### Время нагрева и охлаждения CH3-150:



### Взаимозаменяемые термоблоки:

- 1 B2-50 2 × Ø 48 мм, глубина гнезда 58 мм
- 2 B10-16 10 × Ø 16 мм, глубина гнезда 56 мм
- 3 B6-25 6 × Ø 25 мм, глубина гнезда 40 мм
- 4 B23-1.5 23 × 1,5 мм, глубина гнезда 35 мм
- 5 B10-13 10 × Ø 13 мм, плоское дно, глубина гнезда 30 мм
- 6 B5-29 5 × Ø 29 мм, плоское дно, глубина гнезда 40 мм
- 7 B18-12 18 × Ø 12 мм, круглое дно, глубина гнезда 58 мм



По желанию заказчика возможно изготовление других блоков

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: Кат. номер

CH 3-150 без блоков BS-010418-AAA

#### Блоки:

- 1 B2-50 BS-010418-AK
- 2 B10-16 BS-010418-BK
- 3 B6-25 BS-010418-CK
- 4 B23-1.5 BS-010418-DK
- 5 B10-13 BS-010418-LK
- 6 B5-29 BS-010418-KK
- 7 B18-12 BS-010418-EK

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от  $-3^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$  в соответствии с методикой анализа.

Для повышения функциональности прибора и экономии используемой площади на рабочем столе **Combitherm-2** состоит из 2 независимых заменяемых и объединенных в общем корпусе термоблоков.

Панель управления разделена на две части: левая — для установки и контроля температуры охлаждающего блока, правая — нагревающего. Управление блоками выполняется независимо, т.е. для каждого блока можно задать до 16 программ, позволяющих установить различные температуру и время термостатирования.

Для охлаждения (от комнатной температуры до  $-3^{\circ}\text{C}$ ) используется элемент Пельтье, для нагрева (до  $+150^{\circ}\text{C}$ ) — электрическая нагревательная плита.

### Нагревательный блок, спецификация:

Диапазон установки температуры	$+25^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
Диапазон регулирования температуры	$5^{\circ}\text{C}$ выше комн. ... $+150^{\circ}\text{C}$
Шаг установки температуры	$1^{\circ}\text{C}$
Стабильность температуры	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Диапазон калибровки темп. коэф.	0,936...1,063 ( $\pm 0.063$ )

### Охлаждающий блок, спецификация:

Диапазон установки температуры	$-3^{\circ}\text{C} \dots +20^{\circ}\text{C}$
Диапазон регулирования температуры	$23^{\circ}\text{C}$ ниже комн. ... $5^{\circ}\text{C}$ ниже комн.
Шаг установки температуры	$0,1^{\circ}\text{C}$
Стабильность температуры	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

### Общая спецификация:

Цифровая установка времени	1 мин. – 99 ч. 59 мин. (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера	+
Количество программ (температура и время)	16 (для нагревания) + 16 (для охлаждения)
Дисплей	ЖК
Размеры (Д×Ш×В)	295 × 285 × 220 мм
Вес, не более (без блоков)	5,6 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	430 Вт (1,8 А)



## «Драй-блок» термостаты серии QB, с взаимозаменяемыми блоками

ОПИСАНИЕ

Серия универсальных, высококачественных термостатов типа «драй-блок» с функцией нагрева занимает лидирующую позицию на рынке. Приборы обладают превосходным контролем температуры и обеспечивают высокоточный нагрев для чувствительных аналитических процедур.

### Приборы премиум-класса по доступной цене:

- Точный, воспроизводимый и безопасный нагрев ваших образцов – превосходный контроль температуры в сочетании с высококачественными блоками обеспечивают отличную теплопередачу
- Универсальный ассортимент сменных нагревательных блоков – готовое решение для любых пробирок и планшетов
- Термостаты серии QB и аксессуары к ним подходят как для решения основных задач, так и для более сложных задач в лаборатории
- Широкий ассортимент аксессуаров



Видео  
работы  
приборов



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель (кат. номер)	QBD1/QBD2/QBD4	QBH2
Тип	цифровые	цифровые
Кол-во мест для блоков	1/2/4	2
Диапазон нагрева	комн. +5°C до 130°C	комн. +5°C до 200°C
Диапазон регулирования температуры	+15°C до 130°C	+15°C до 200°C
Стабильность температуры при 37°C	±0,1	±0,1
Температурное распределение темп. внутри блоков при 37°C	±0,1	±0,1
Дисплей/разрешение	ЖК/0,1°C	ЖК/0,1°C
Безопасность: перегрев	термопредохранитель	
Таймер со звуковым сигналом	1 мин. до 72 часов	
Время нагрева от 25°C до 100°C	15 мин.	
Мощность нагрева, Вт	150/300/600 Вт	300 Вт
Блок питания	120 В или 230 В	

## «Драй блок» термостаты серии QB с взаимозаменяемыми блоками: аксессуары

Взаимозаменяемые блоки (Кат. номер)		QBD1	QBD2	QBD4	QBH2	QBA1	QBA2
<b>Кол-во блоков</b>		1	2	4	2	1	2
<b>QB-0</b> Плоский блок без гнезд, для покровных стекол		+	+	+	+	+	+
<b>QB-10</b> 24 × Ø10 мм, глубина гнезд 50 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-12</b> 24 × Ø12 мм, глубина гнезд 50 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-13</b> 12 × Ø13 мм, глубина гнезд 50 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-16</b> 12 × Ø16 мм, глубина гнезд 50 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-17H</b> 10 × Ø17 мм пробирок типа Falcon, глубина гнезд 75 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-18</b> 12 × Ø18 мм, глубина гнезд 50 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-24</b> 5 × Ø24 мм пробирок и универсальных бутылочек, глубина гнезд 50 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-50</b> 4 × 50 мл центрифужные пробирки, стеклянные пробирки, глубина гнезд 50 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-H</b> 56 × 0,2 мл микропробирок, глубина гнезд 14 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-E0</b> 24 × 0,5 мл микропробирки, глубина гнезд 30 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-E1</b> 24 × 1,5 мл микропробирки, глубина гнезд 35 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-E2</b> 24 × 2,0 мл микропробирки, глубина гнезд 35 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-E5</b> 12 × 5,0 мл микропробирки, глубина гнезд 53,5 мм, Ø16,7 мм		+	+	+	+	+	+
<b>QB-DN</b> пробирки типа Dolphin nose 24 × Ø11,13 мм до Ø6,1 мм		+	+	+	+	+	+
<b>Pt1000 внешний температурный датчик (для цифровых моделей)</b>							
	Стандартный датчик для контроля температуры образца или блока. В защитной оболочке из нержавеющей стали, Ø3 мм × 30 мм, кабель 350 мм	+	+	+	+	-	-
	Укороченный датчик для контроля температуры образца или блока. В защитной оболочке из нержавеющей стали, Ø3 мм × 14 мм, кабель 350 мм	+	+	+	+	-	-
<b>Блоки для микропланшетов, применяемые для приложений в молекулярной биологии и биотехнологии 140 × 100 × 75 мм</b>							
	Блок на 96 гнезд для микропланшетов на 0,2 мл, стрипов и микропробирок. Равномерность распределения температуры ± 0,3°C между гнездами блока; диаметр гнезд 6,2 мм, глубина гнезд 14 мм	-	+	-	+	-	+
	Блок для стандартных 96-луночных планшетов (с различной формой дна: U-образной, V-образной, плоской) с прикрепленной крышкой, создающей идеальные условия инкубации. Равномерность распределения температуры ± 0,5°C между гнездами блока	-	+	-	+	-	+
<b>Защитная крышка (не требуется для блока QDP-FL)</b>							
	Защитная крышка предотвращает случайные прикосновения к горячему блоку, а также защищает от контаминации образцов брызгами. Крышка сделана из крепкого прозрачного поликарбоната для обеспечения максимального обзора. Высота крышки 85 мм	QBL1	QBL2	QBL4	QBL2	QBL1	QBL2





# ВОДЯНЫЕ БАНИ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ, БАНИ-ШЕЙКЕРЫ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ И БЕЗ, БАНИ-ШЕЙКЕРЫ С ОРБИТАЛЬНЫМ И ЛИНЕЙНЫМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ, ЦИРКУЛЯТОРЫ



## Grant Optima™

Перемешивающие  
термостатируемые бани  
и циркуляторы



## LT ecocool™

Энергоэффективный циркулятор  
с охлаждением и нагревом



## WB-4MS

Баня-термостат водяная  
(с перемешиванием)

**WB-4MS, Баня-термостат водяная (с перемешиванием)**

ОПИСАНИЕ

Водяная баня-термостат **WB-4MS** предназначена для проведения химических, фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°C.

Модель **WB-4MS** обеспечивает повышенную стабилизацию температуры (до 0,1°C) за счет работы встроенной магнитной мешалки (диапазон регулирования скорости 250–1000 об/мин).

Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты и современный дизайн.

Одновременно можно установить до 2 штативов для пробирок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем	4 л
Диапазон установки температуры	+25°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры	комн. +5°C ... +100°C
Шаг установки температуры	0,1°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0,1°C
Диапазон регулирования скорости перемешивания	250–1000 об/мин
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Цифровая установка температуры, времени и скорости перемешивания	+
Крышка из пластика и нержавеющей стали	+
Бесшумен в работе	+
Рабочий объем	235 × 135 × 110 мм
Размеры (Д×Ш×В)	340 × 270 × 250 мм
Вес	3,4 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	230 В, 50 Гц / 600 В (2,6 А)

Basic Plus  
Product Class



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

WB-4MS с платформой BP-1 (на дне)



1 Штатив TR-16/19

Платформа BP-1

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:**

Кат. номер

**WB-4MS** с платформой BP-1 и крышкой

BS-010406-AAA

Дополнительные принадлежности:

Штативы:	Диаметр/объем пробирок	Вместимость	Кат. номер
1 TR-5/30	Ø 30 мм	5 пробирок	BS-010406-KK
2 TR-16/19	Ø 16–19 мм	16 пробирок	BS-010406-FK
3 TR-30/13	Ø 10–13 мм	30 пробирок	BS-010406-IK
4 TR-44/11	2/1,5 мл	44 пробирки	BS-010406-JK

## OLS26, Водяная баня-шейкер со сменным орбитальным и линейным перемешиванием



Оборудование, представленное на страницах 62-63, 67–79 произведено компанией Grant Instruments (Англия, Кембридж). Биосан является эксклюзивным дистрибьютором продукции Grant Instruments в России, странах СНГ и Прибалтике (Латвия, Литва, Эстония) и официальным дистрибьютором в ряде других стран.

Запатентованный механизм комбинированного орбитального и линейного перемешивания, реализованный в **OLS26**, позволяет оптимизировать аэрацию и поперечные силы смешивания для получения воспроизводимых результатов.

- Высокоточный цифровой контроль температуры
- Диапазон регулирования температуры от 0°C до 99°C\*
- Стабильность температуры  $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Легкий переход от линейного перемешивания к орбитальному
- Регулируемая скорость перемешивания и частота хода
- Универсальный штатив и крышка из поликарбоната входят в стандартный комплект
- Кран для слива воды
- 3 года гарантии
- Для удобства пользователя платформы продаются отдельно
- Универсальная платформа входит в стандартный комплект

\* — Для работы при температурах ниже комнатной необходимо дополнительное охлаждающее устройство

Объем	26 л
Мин./макс. уровень жидкости	70 мм / 134 мм
Диапазон регулирования температуры	комн. +5°C до +99°C 0°C до +99°C с дополнительным охлаждающим устройством
Равномерность распределения температуры при +70°C	$\pm 0,1^\circ\text{C}$
Стабильность температуры при 70°C	$\pm 0,1^\circ\text{C}$
Дисплей	2 × LED (отдельные дисплеи и элементы управления для температуры и скорости перемешивания)
Диапазон регулирования скорости перемешивания	20–200 об/мин (в зависимости от нагрузки)
Радиус орбиты	9 мм
Шаг установки скорости	1 об/мин
Длина хода	18/28/36 мм
Размеры рабочей поверхности	380 × 235 мм
Размеры (В × Ш × Д)	475 × 590 × 335
Таймер	1 до 999 мин.
Потребляемая мощность 120/230 В	1,05/1,4 кВт
Сливной кран	+
Безопасность	защита от перегрева/ отключение при низком уровне жидкости
Напряжение	110–120 В или 220–230 В

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**OLS26**, баня-шейкер с TU26 платформой

Кат. номер

OLS26

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Бани-шейкеры с линейным перемешиванием – серия LSB Aqua Pro

ОПИСАНИЕ

Широко известные во всем мире водяные бани с перемешиванием. Высококачественный дизайн с уникальным магнитно-связанным перемешивающим механизмом для максимальной надежности и бесшумной работы. Широкий ассортимент аксессуаров – готовое решение для любого метода. Разнообразные сосуды могут быть надежно закреплены с использованием высококачественных пружин, зажимов или штативов.

### Особенности:

- Диапазон регулирования температуры от комн. +5°C до +99°C
- Стабильность температуры  $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Две модели на выбор – 12 и 18 литров
- Кран для слива воды
- 3 года гарантии
- Универсальный штатив и крышка из поликарбоната входит в стандартный комплект
- Широкий выбор аксессуаров. Платформы не входят в стандартный комплект
- Универсальная платформа входит в стандартный комплект



СПЕЦИФИКАЦИЯ

	LSB12	LSB18
	8,9 кг в: 425 мм ш: 385 мм д: 360 мм	11,2 кг в: 425 мм ш: 565 мм д: 335 мм
Объем	12 л	18 л
Мин./макс. уровень жидкости	60 мм / 93 мм	
Диапазон регулирования температуры	комн. +5°C ... +99°C	
Равномерность распределения температуры при +70°C	$\pm 0,1^\circ\text{C}$	
Стабильность температуры при 70°C	$\pm 0,1^\circ\text{C}$	
Дисплей	Светодиодный	
Скорость линейного перемешивания	от 20 до 200 ход/мин (в зависимости от нагрузки)	
Шаг установки скорости линейного перемешивания	1 ход/мин	
Длина хода	20 мм	
Размеры рабочей поверхности (Ш × Д)	240 × 235 мм	420 × 235 мм
Таймер	от 1 до 999 мин.	
Потребляемая мощность 120/230 В	0,8/0,8 кВт	1,05/1,4 кВт
Сливной кран	+	
Безопасность	защита от перегрева/отключение при низком уровне жидкости	
Напряжение	110–120 В или 220–230 В	



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**LSB12**, баня-шейкер на 12 л с TU12 платформой

LSB12

**LSB18**, баня-шейкер на 18 л с TU18 платформой

LSB18

Описание и фотографии всех платформ см. на стр. 69

## Аксессуары для водяных бань с перемешиванием: LSB 12, LSB 18 и OLS 26

Аксессуары для LSB и OLS Aqua Pro		OLS26	LSB12	LSB18
		Кат. номер		
	Универсальная платформа с пружинами предназначена для сосудов различных размеров и конфигурации. Регулируемые пружины обеспечивают максимальную вместимость.	TU26	TU12	TU18
	Платформа с отверстиями для колб/планшетов позволяет одновременно разместить зажимы для колб разного объема или адаптер для глубоколоночных планшетов. Смотрите таблицу ниже.	TF26	TF12	TF18
	Платформа для штативов совместима с SR - штативами для пробирок и микропробирок или может быть использована без штативов для размещения биотехнологических мешков и разнообразных сосудов. Смотрите таблицу ниже.	TS26 (вмещает до 5 SR - штативов для пробирок)	TS12 (вмещает до 3 SR - штативов для пробирок)	TS18 (вмещает до 5 SR - штативов для пробирок)
	Платформа с отверстиями позволяет использовать водяную баню как баню без перемешивания.	SBT26	SBT12	SBT26
	Погружной кулер – источник постоянного охлаждения, необходимый для работы при температуре окружающей среды или ниже (до 0°C). Рекомендуем крышку LS200 с отверстием для погружного кулера.	CC26	—	—
	Контур охлаждения помещается под перемешивающую платформу и предназначен для подсоединения к крану подачи холодной воды или к охлаждающему циркулятору. Рекомендуем крышку LS200 с отверстием для погружного кулера.	CW26	—	—
	Остроконечная крышка из нержавеющей стали.	LS200	LU14	LU28
	Остроконечная крышка из поликарбоната, прозрачная.	AQL26	AQL12	AQL26

Держатели для колб и планшетов

Количество зажимов для колб, платформа TF				
Кат. номер	Описание	OLS26	LSB12	LSB18
SC-25	для 25 мл колбы	28	18	33
SC-50	для 50 мл колбы	24	14	26
SC-100	для 100 мл колбы	15	9	17
SC-250	для 250 мл колбы	8	5	14
SC-500	для 500 мл колбы	6	4	6
SC-1000	для 1000 мл колбы	3	2	4
SH-DWP	1 × адаптер для глубоколоночных планшетов	4	1	4

Штативы для пробирок и микропробирок, платформа TS		
Кат. номер	Диаметр пробирки (мм)	Вместимость
SR-10	10	48
SR-13	13	44
SR-16	16	24
SR-19	19	21
SR-25	25	12
SR-30	30	10
Кат. номер	Размер пробирки (мл)	Вместимость
SR-SE	0,5	119
SR-LE	1,5	48



## Водяные бани без перемешивания

**SUB Aqua Pro** – улучшенная серия водяных бань, состоящая из 8 моделей. Пластиковая крышка, базовая платформа и слив (для бань с большим объемом) включены в стандартный комплект.



**JB Nova** – серия водяных бань общего назначения, состоящая из 4 моделей. Пластиковая крышка, базовая платформа и слив (для бань с большим объемом) включены в стандартный комплект.



**JB Academy** – стандартная серия водяных бань, состоящая из 3 моделей. Базовая платформа входит в стандартный комплект.



**SBB Aqua Plus boiling bath range** – серия водяных бань для кипячения, состоящая из 4 моделей. Пластиковая крышка и базовая платформа включены в стандартный комплект.



- Благодаря качеству и надежности выпускаемой продукции **Grant Instruments** является ведущей компанией среди мировых производителей водяных бань
- Новая эра для водяных бань **Grant Instruments** – теперь все модели, от базовых до продвинутых, с цифровым управлением
- Проверенная эффективность – технология контроля температуры, на которую вы можете положиться
- Технология **Set and Forget™** «Установил и забыл» – минимальное время установки параметров, максимальное время для вашей работы

## Водяные бани без перемешивания SUB Aqua Pro



Водяные бани **SUB Aqua Pro** произведены в соответствии с самыми высокими стандартами. Новейшие технологии в серии **SUB Aqua Pro** позволяют осуществить даже самые сложные методики, требующие высокоточного контроля температуры. Предлагаем восемь (8) моделей бань на ваш выбор, базовая платформа и пластиковая крышка включены в стандартную комплектацию.

- Диапазон регулирования температуры: от 5°C выше комнатной температуры до 99°C
- Технология **Set and Forget™** («Установил и забыл») – быстрый нагрев, точный контроль температуры
- Стабильность  $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Защита от перегрева
- Защита от старта без воды и высыхания
- Три программируемых температуры
- Гарантия 3 года
- Пригодны для использования с теплопровод. шариками (исключая SAP2 и SAP25)

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Краткое содержание спецификации	Стандартные водяные бани без перемешивания							
	SAP2	SAP25	SAP5	SAP12	SAP18	SAP26	SAP34	SAPD
	2,5 кг в: 200 мм ш: 185 мм д: 200 мм	3 кг в: 150 мм ш: 335 мм д: 215 мм	3 кг в: 200 мм ш: 335 мм д: 215 мм	6 кг в: 225 мм ш: 360 мм д: 380 мм	9,5 кг в: 275 мм ш: 335 мм д: 590 мм	9 кг в: 275 мм ш: 335 мм д: 590 мм	14,5 кг в: 370 мм ш: 335 мм д: 770 мм	9 кг в: 225 мм ш: 545 мм д: 380 мм
Объем бани	2 л	2 л (неглубокая)	5 л	12 л	18 л	26 л	34 л	5 и 12 л
Диапазон регулир. темп., °C	от 5°C выше комнатной температуры до 99°C							
Разрешение дисплея и шаг установки темп.	0,1°C							
Стабильность (DIN 12876) при 70°C	$\pm 0,2^\circ\text{C}$							
Установка темп./Регуляция энергии	цифровая							
Сигнал о перегреве бани (пороговая температура устанавливается пользователем)	+							
Защита от сухого старта/выкипания воды	+							
Защита от работы сухой бани	+							
Возможность запрограммировать температурные пресеты	3							
Цифровая установка времени со звуковым сигналом	от 1 до 999 мин.							
Рабочий объем (Ш × Д) мм	131 × 117	289 × 139	281 × 131	306 × 281	281 × 485	278 × 481	281 × 635	281 × 131 и 306 × 281
Минимальный уровень заполнения	50 мм	32 мм	50 мм	50 мм	50 мм	70 мм	70 мм	50 мм
Максимальный уровень заполнения	на 25 мм ниже верхнего края ванны							
Сливной кран	-	-	-	+	+	+	+	+
Потребляемая мощность (120 В/230 В) кВт	0,25/0,25	0,35/0,35	0,35/0,35	0,8/0,8	1,4/1,05	1,4/1,05	1,8/1,3	1,15/1,15
Питание, В	120 или 230							



## Водяные бани без перемешивания SUB Aqua Pro

Опции и аксессуары							
SAP2	SAP25	SAP5	SAP12	SAP18	SAP26	SAP34	SAPD
2 л	2 л (неглубокая)	5 л	12 л	18 л	26 л	34 л	5 и 12 л
Остроконечные крышки из поликарбоната, прозрачные*							
AQL2	AQL5	AQL5	AQL12	AQL26	AQL26	—	AQL5, AQL12
Предотвращает образование конденсата на стенках сосудов, позволяет избежать контаминации образцов, уменьшает испарение жидкости и снижает расход энергии							
Остроконечные крышки из нержавеющей стали*							
—	LU6	LU6	LU14	LU28	LU28	LU36	LU6 и LU14
Плоские крышки*							
—	—	LF6 (2 набора колец)	LF14 (4 набора колец)	LF28 (6 наборов колец)	LF28 (6 наборов колец)	LF36 (8 наборов колец)	LF6/LF14
Наборы колец для различных типов колб и сосудов позволяют стабильно установить высокие сосуды и снизить испарение жидкости							
Полипропиленовые шарики* (кол-во упаковок на одну водяную баню)							
1 × PS20	1 × PS20	1 × PS20	1 × PS20	2 × PS20	2 × PS20	3 × PS20	2 × PS20
Эффективная замена крышки. Полипропиленовые шарики уменьшают испарение жидкости и потерю тепла, а также обеспечивают легкий доступ к сосудам в бане; особенно удобно для высоких сосудов							
Платформы двусторонние, две платформы разной высоты в одной. В = высота платформы от основания водяной бани (мм)							
—	—	—	RS14H (В: 40 или 78) платформа занимает половину площади SAP12	RS18H (В: 40 или 135) платформа занимает половину площади SAP18	RS28H (В: 45 или 135) платформа занимает половину площади SAP26	RS36H (В: 45 или 135) платформа занимает половину площади SAP34	RS14H (В: 40 или 78) платформа занимает половину площади SAPDUAL
Штативы для пробирок (кол-во на одну водяную баню)							
—	—	1 × J2	2 × J2	4 × J2	4 × J2	6 × J2	1 + 2 × J2
8 моделей для пробирок и микропробирок различного диаметра (см. ниже)							
Базовая платформа (перфорированная нержавеющая сталь)							
AQBT2	AQBT5	AQBT5	AQBT12	AQBT26	AQBT26	SBT36	AQBT5 и AQBT12
Необходимо использовать, если плоскдонные колбы устанавливаются на дно бани; способствуют тепловой конвекции в водяной бане							

\* — Крышки или полипропиленовые шарики рекомендуется использовать в диапазоне от 60°C – 100°C и ниже комн. t°

Штативы для пробирок (предназначены для водяных бань без перемешивания)					
Штативы J2	Диаметр пробирок, Ø	Вместимость	Штативы J2	Диаметр пробирок, Ø	Вместимость
J2-10	10 мм	84	J2-25	25 мм	18
J2-13	13 мм	55	J2-30	30 мм	12
J2-16	16 мм	36	J2-SE	0,5 мл	105
J2-19	19 мм	32	J2-LE	1,5 мл	65

## Термостатирующие бани-циркуляторы Grant Optima™



Серия **Grant Optima™** — это multifункциональные и экономически выгодные термостатируемые бани и циркуляторы, сочетающие в себе легендарные качество и надежность Grant Instruments. Точный контроль температуры позволяет применять приборы для разных лабораторных нужд.

- Точный и безопасный контроль температуры
- Интуитивно понятное программирование и продуманный дизайн
- Качественная и прочная конструкция
- Полный ассортимент — 32 модели для реализации как простых, так и сложных задач. Каждая модель представляет собой отличное соотношение цены и качества

### Применение:

Перемешивающие термостатируемые бани и циркуляторы обеспечивают точный нагрев и охлаждение, что позволяет использовать их как в рутинных, так и в чувствительных к температурным изменениям аналитических процедурах, в том числе для инкубации образцов, калибровки и тестирования контроля качества. Все модели, начиная от **TC120** и выше, могут применяться как в открытой, так и в закрытой системе циркуляции по внешнему контуру.

**Спецификации термостатируемых бань и циркуляторов см. на стр. 74 и аксессуары на стр. 76**

### Выбор модели (см. стр. 74):

Четыре цифровых термостата **Grant Optima™** могут быть скомбинированы с восемью ваннами фирмы Grant (5 стальных и 3 пластиковых), таким образом предоставляя выбор из 32 моделей.

## Спецификации термостатируемых бань и циркуляторов Grant Optima™



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификации:		Общего назначения с цифровым контролем		С цифровым контролем и расширенными возможностями программирования	
		T100	TC120	TX150	TXF200
Стабильность температуры (DIN 12876) при 70°C	°C	±0,05°C	±0,05	±0,01	±0,01
Равномерность распределения температуры (DIN 12876) при 70°C	°C	±0,1	±0,1	±0,05	±0,05
Шаг установки температуры	°C	0,1	0,1	0,1 (0,01 с ПО Labwise™)	
Дисплей		Светодиодный, 4 цифры		цветной QVGA TFT	
Таймер		–	от 1 до 6000 мин.	от 1 мин. до 99 ч. 59 мин.	
Кол-во запрограм. значений температуры		3	3	3	3
Кол-во точек повторной калибровки		2	2	5	5
Регулировка смещения		–	–	+	+
Разъем для внешнего датчика		–	–	+	+
Интерфейс связи		–	–	USB и RS232	USB и RS232
Программирование		–	–	Удаленное через ПК 1 программа 30 сегментов	Непосредственно через пользовательский интерфейс или удаленное с помощью ПК/ноутбука, 10 программ/100 сегментов
Реле		–	–	1	1
Безопасность от перегрева		Фиксирован.		Регулируемый порог выключения	
Безопасность: Уровень жидкости, поплавковый выключатель		+	+	+	+
Сигнал (может быть настроен для переключения реле)		–	Громкий, нет реле	Громкий и тихий	Громкий и тихий
Мощность нагревателя	(230 В) кВт	1,3	1,3	1,9	1,9
Электропитание	(230 В) кВт	1,4 (50–60 Гц)	1,4 (50 Гц)	2,0 (50 Гц)	2,0 (50–60 Гц)
Высота над краем ванны	мм	200	200	200	200
Глубина погружения от края ванны	мм	135	135	135	135
<b>Насосы для термостатов Grant Optima™ (встроенные)</b>					
Максимальное давление	Вода (мбар)	–	210	310	530
Максимальная скорость потока	Вода (л/мин)	–	16	18	23 (регулировка скорости потока)
Внутренний диаметр трубки	Вход/выход	–	6/11	6/11	6/11
Размеры (В × Г × Ш)	мм	315 × 145 × 115			

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер:

T100 EURO

TC120 EURO

TX150 EURO

TXF200 EURO

## Grant Optima™, Возможные комбинации водяных бань и блоков управления и предлагаемые к ним аксессуары

Объем (л) Внешние размеры термостата	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая область (Д x Ш)</li> <li>• Мин./макс. уровень жидкости</li> <li>• Внутренние размеры термостата (Д x Ш x В)</li> <li>• Общие размеры, включая блок управления (Д x Ш x В)</li> </ul>	T100 Диапазон установки температуры	TC120 Диапазон установки температуры	TX150 Диапазон установки температуры	TXF200 Диапазон установки температуры
ST5 – 5 л – 3кг нержавеющая сталь в: 200 мм г: 330 мм ш: 180 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 × 150 мм</li> <li>• 85/140 мм</li> <li>• 300 × 150 × 150 мм</li> <li>• 330 × 180 × 395 мм</li> </ul>	T100-ST5 комн. от +15 °С до 100°С	TC120-ST5 0 до 120°С	TX150-ST5 0 до 150°С	TXF200-ST5 0 до 200°С
ST12 – 12 л – 4,5 кг нержавеющая сталь в: 200 мм г: 360 мм ш: 330 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 205 × 300 мм</li> <li>• 80/140 мм</li> <li>• 325 × 300 × 150 мм</li> <li>• 360 × 330 × 395 мм</li> </ul>	T100-ST12 0 до 100°С	TC120-ST12 0 до 120°С	TX150-ST12 0 до 150°С	TXF200-ST12 0 до 200°С
ST18 – 18 л – 7 кг нержавеющая сталь в: 200 мм г: 540 мм ш: 330 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 385 × 300 мм</li> <li>• 75/130 мм</li> <li>• 505 × 300 × 150 мм</li> <li>• 540 × 330 × 395 мм</li> </ul>	T100-ST18 0 до 100°С	TC120-ST18 0 до 120°С	TX150-ST18 0 до 150°С	TXF200-ST18 0 до 200°С
ST26 – 26 л – 7,5 кг нержавеющая сталь в: 255 мм г: 540 мм ш: 330 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 385 × 300 мм</li> <li>• 125/180 мм</li> <li>• 505 × 300 × 200 мм</li> <li>• 540 × 330 × 405 мм</li> </ul>	T100-ST26 0 до 100°С	TC120-ST26 -15 до 120°С	TX150-ST26 -15 до 150°С	TXF200-ST26 -15 до 200°С
ST38 – 38 л – 11 кг нержавеющая сталь в: 255 мм г: 730 мм ш: 330 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 575 × 300 мм</li> <li>• 125/180 мм</li> <li>• 690 × 300 × 200 мм</li> <li>• 730 × 333 × 405 мм</li> </ul>	T100-S38 0 до 100°С	TC120-S38 -15 до 120°С	TX150-S38 -15 до 150°С	TXF200-S38 -15 до 200°С
P5 – 5 л – 2,5 кг (пластик) в: 180 мм г: 240 мм ш: 330 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 × 150 мм</li> <li>• 85/140 мм</li> <li>• 240 × 160 × 150 мм</li> <li>• 390 × 200 × 380 мм</li> </ul>	T100-P5 комн. +15°С до 99°С	TC120-P5 комн. +15°С до 99°С	TX150-P5 комн. +15°С до 99°С	TXF200-P5 комн. +15°С до 99°С
P12 – 12 л – 3,5 кг(пластик) в: 180 мм г: 415 мм ш: 350 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 210 × 280 мм</li> <li>• 85/140 мм</li> <li>• 325 × 280 × 150 мм</li> <li>• 415 × 350 × 380 мм</li> </ul>	T100-P12 комн. +5°С до 99°С	TC120-P12 комн. +5°С до 99°С	TX150-P12 комн. +5°С до 99°С	TXF200-P12 комн. +5°С до 99°С
P18 – 18 л – 5 кг (пластик) в: 180 мм г: 600 мм ш: 365 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 280 × 325 мм</li> <li>• 85/140 мм</li> <li>• 510 × 290 × 150 мм</li> <li>• 600 × 350 × 380 мм</li> </ul>	T100-P18 комн. +5°С до 99°С	TC120-P18 комн. +5°С до 99°С	TX150-P18 комн. +5°С до 99°С	TXF200-P18 комн. +5°С до 99°С
<b>Опции и аксессуары</b>					
Программное обеспечение Labwise™ для ПК (по запросу)					
Осуществляет двунаправленную связь для отображения статуса, программирования и сбора данных		-	-	+	+
Внешние датчики (по запросу)					
Датчик из мягкого пластика ХТРЕР		-	-	+	+
Датчик из нержавеющей стали ХSPEP		-	-	+	+
Удаленный коммутационный аппарат (по запросу)					
Для включения и выключения приборов (макс. до 8 А)		-	-	1	2
Вертикальные турбинные насосы (по запросу)					
Низкий уровень шума, компактный дизайн. Поставляется с трубными соединениями и специальной крышкой, внутренний диаметр трубки 12,7 мм					
VTP 1	Макс. давление 1000 мбар Максимальная скорость потока 9 л/мин	+	Требуется только там, где необходимо более высокое давление, чем то, которое может обеспечить внутренний насос для поддержания потока		
VTP 2	Макс. давление 1650 мбар Максимальная скорость потока 12 л/мин	+			



## Аксессуары для водяных бань серии Grant Optima™

Аксессуары								
	<b>Крышки</b> Уменьшают испарение/потерю тепла и помогают избежать контаминации образца	<b>Полипропиленовые шарики</b> (кол-во упаковок на одну водяную баню)	<b>Платформы</b> Позволяют оптимально использовать доступное пространство ванны (кол-во платформ)	<b>Высокие полки</b> Позволяют размещать невысокие сосуды в ванне	<b>Система охлаждения</b> позволяет системам работать при комнатной температуре или ниже с помощью охлаждающего змеевика, погруженного в ванну; предназначена для минимального воздействия на рабочую область			
					<b>Холодильные погруженные кулеры</b> Состоят из охлаждающего змеевика, соединенного с холодильной установкой с помощью гибкого шланга. Температура жидкости постоянно контролируется с помощью блока управления температурой		<b>Охлаждающий змеевик</b> Для подсоединения к крану холодной воды или к охлаждающему циркулятору	
					C1G (0 до 40°)	C2G (-15 до 40°)	CW5 (2° выше t° хладагента)	
<b>ST5 – 5 л</b> нержавеющая сталь	<b>STL5</b> плоская, из нержавеющей стали	<b>1 x PS20</b>	<b>1 x QR</b>	—		—		
<b>ST12 – 12 л</b> нержавеющая сталь	<b>STL12</b> остроконечная, из нержавеющей стали	<b>1 x PS20</b>	<b>2 x VR</b>	<b>RS14</b>		—		
<b>ST18 – 18 л</b> нержавеющая сталь	<b>STL26</b> остроконечная, из нержавеющей стали	<b>2 x PS20</b>	<b>4 x VR</b>	<b>RS22</b>		—		
<b>ST26 – 26 л</b> нержавеющая сталь	<b>STL26</b> остроконечная, из нержавеющей стали	<b>2 x PS20</b>	<b>4 x VR</b>	<b>RS28</b>				
<b>ST38 – 38 л</b> нержавеющая сталь	<b>STL38</b> остроконечная, из нержавеющей стали	<b>3 x PS20</b>	<b>6 x VR</b>	<b>RS28 или RS38</b>				
<b>P5 – 5 л</b> пластик	<b>PL5</b> плоская, из нержавеющей стали	<b>1 x PS20</b>	<b>1 x QR</b>	—	—	—	—	
<b>P12 – 12 л</b> пластик	<b>PL12</b> изогнутая, из пластика	<b>1 x PS20</b>	<b>2 x VR</b>	<b>RS14</b>	—	—	—	
<b>P18 – 18 л</b> пластик	<b>PL18</b> изогнутая, из пластика	<b>2 x PS20</b>	<b>4 x VR</b>	<b>RS22</b>		—	—	

## LT ecoscool™

### Энергоэффективные циркуляторы с охлаждением и нагревом



Новая серия инновационных, экологичных циркуляторов с охлаждением и нагревом обеспечивает мощное охлаждение и значительную экономию средств.

- Выбор из двух моделей, температурный диапазон от -30°C до +150°C (в зависимости от модели)
- Лучшая в отрасли 4-х летняя гарантия, обслуживание и поддержка, регистрация не требуется
- Активное охлаждение во всем температурном диапазоне
- Реальное энергосбережение – до 80% по сравнению со стандартным оборудованием компрессорного типа

**Все циркуляторы линейки LT ecoscool™ поставляются в виде укомплектованных, готовых к использованию наборов. Все необходимые аксессуары - трубки, хомуты и разъемы, включены в стандартную комплектацию.**

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

29 кг  
В: 640 мм  
Г: 430 мм  
Ш: 245 мм

		LT ecoscool™ 100	LT ecoscool™ 150
Диапазон установки температуры	С°	-20 to 100	-25 до 150
Стабильность температуры	С°	±0,05	±0,02
Скорость потока (макс.)	л/мин	17	14-22
Давление насоса (макс.)	мбар	250	530
Объем	л	5	6
Кол-во точек калибровки		2	5
Мощность охлаждения	при 20°C Вт	240	385
	при 0°C Вт	200	205
	при -10°C Вт	100	105
	при -20°C Вт	30	60
Программы		—	1 x 30 сегментов (с помощью Labwise™)
Интерфейс передачи данных		—	USB
Тип разъема температурного датчика		—	6 pin mini DIN
Дисплей		ЖК, 4 знака	Цветной, QVGA (320 × 240) TFT
Языки		—	5 (EN, FR, DE, IT, ES)
Вес	кг	29	
Таймер		от 1 мин до 99 часов 59 мин	
Температурные пресеты (кол-во запрогр. значений t°)		3	
Сигнал (звуковой реле)		Высокая температура	Высокая и низкая температура
Потребляемая мощность (макс.), кВт	120 В/230 В	2,16/2,07 (50-60 Гц)	2,28/2,76 (50-60 Гц)
Безопасность		Регулируемый терморезистор	
Комплект поставки		Приборы поставляются в собранном виде со стандартными шлангами, изоляцией, хомутами и разъемами	

## LT ecosool™

### Энергоэффективные циркуляторы с охлаждением и нагревом

#### Применение:

- **ФАРМАЦЕВТИКА** — небольшие полупромышленные установки
- **ОБРАЗОВАНИЕ** — охлаждение ротационных испарителей, замещение проточного водяного охлаждения, погружение небольших образцов, фотометрия, хроматографические системы.
- **ПРОМЫШЛЕННОСТЬ** — контроль качества, подготовка образцов, общее охлаждение, химический синтез, температурный контроль, реометрия
- **ПРОДОВОЛЬСТВИЕ** — рефрактометрия
- **МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ** — охлаждение электрофореза
- **ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ** — действует до 150°C



Опции и аксессуары	LT ecosool™ 100	LT ecosool™ 150
Программное обеспечение для ПК Labwise™		
Обеспечивает двустороннюю связь для отображения статуса, программирования и сбора данных (USB кабель включен в комплект)	—	
<b>Внешние датчики</b>		
Датчик из мягкого пластика PEP	—	+
Датчик из нержавеющей стали SEP	—	+
<b>Вертикальные турбинные насосы. Когда насос установлен, доступная рабочий объем уменьшается.</b>		
Низкий уровень шума, компактный дизайн. Поставляется со штуцерами для подключения и спец. крышкой для установки на резервуар, внутренний диаметр трубки 12,7 мм.		Нужен только если необходимо обеспечить более высокое давление, чем то, которое обеспечивает внутренний насос для поддержания напора
VTP1-LT макс. давление 1,000 мбар; макс. скорость потока 9 л/мин		Замечание: насосы VTP дополнительно нагревают водяную баню, тем самым понижая общую мощность охлаждения.  При заказе насоса VTP, пожалуйста, укажите с каким охлаждающим устройством предполагается его использовать
VTP1-LT макс. давление 1,650 мбар; макс. скорость потока 12 л/мин		
<b>Наборы шлангов</b>		
HOSE100 набор шлангов общего назначения: от -40 до 100°C HOSE200 набор шлангов для высокой температуры: от -50 до 200°C		Набор шлангов 2 x 2м, соединенных с выходной планкой насоса Optima™ и хомуты для шлангов; инструменты не требуются

## Низкотемпературные водяные бани и циркуляторы серии Grant Optima™ R



- Эффективные и экономически выгодные многоцелевые циркуляторы серии Optima™ R для работы при низких температурах
- Мощное охлаждение и высокая точность поддержания температуры, как в открытых, так и в закрытых системах с принудительной циркулирующей жидкости
- Сочетание легендарного качества, надежности и дизайна «Grant Instruments» – набор полезных функций, простое обслуживание, компактный дизайн
- Надежная прочная конструкция обеспечивает долгосрочную эксплуатацию
- Широкий ассортимент – 8 моделей охватывают широкую зону применения, начиная от самых простых и заканчивая сложными аналитическими процедурами, где требуется высокая точность поддержания температуры
- Все низкотемпературные термостаты и циркуляторы имеют гарантийный срок – 3 года

Низкотемпературные циркуляционные водяные бани **Grant Optima™ R** обеспечивают высокоточное охлаждение и могут быть использованы в таких чувствительных аналитических процедурах, как спектрофотометрия, определение вязкости, рефрактометрия и электрофорез.

Рабочая жидкость, рекомендуемая к использованию в охлаждающих термостатируемых банях и циркуляторах:

- **-50 до 50°C:** силиконовое масло низкой вязкости (Bayer Silicone M3)
- **-30 до 30°C:** 50% вода, 50% антифриз (ингибированный этиленгликоль)
- **0 до 30°C:** 80% вода, 20% антифриз (ингибированный этиленгликоль)
- **+5 до 99,9°C:** вода

### Выбор моделей:

Четыре термостата Grant Optima™ могут быть скомбинированы с двумя охлаждающими установками **Optima™ R**, таким образом предоставляя выбор из 8 моделей.

Объем (л) Внешние размеры корпуса водяной бани	• Рабочая область (ДхШ) • Мин./макс. уровень жидкости • Вес	T100	TC120	TX150	TXF200
		в: 315 мм г: 145 мм ш: 115 мм			
<b>R4 – 20 л нерж. сталь</b> в × г × ш: 530 × 490 × 390 мм, <i>кат. номер: R4</i>	• 230 × 305 мм • 80/140 мм • 40 кг	T100-R4 0°C to 100°C	TC120-R4 -25°C to 100°C	TX150-R4 -30°C to 100°C	TXF200-R4 -30°C to 100°C
<b>R5 – 12 л нерж. сталь</b> в × г × ш: 585 × 575 × 415 мм, <i>кат. номер: R5</i>	• 260 × 115 мм • 120/180 мм • 47 кг	T100-R5 0°C to 100°C	TC120-R5 -25°C to 100°C	TX150-R5 -47°C to 100°C	TXF200-R5 -47°C to 100°C

### Опции и аксессуары

Программное обеспечение Labwise™ для ПК

Возможность двусторонней связи для индикации состояния, программирования и сбора данных + в наличии USB кабель

Внешние датчики

Датчик из мягкого пластика XTPEP, 3 м кабель  
Датчик из нержавеющей стали XSPEP, 3 м кабель

Удаленный коммутационный аппарат

Для включения и выключения приборов от электросети (макс. до 8 А)

### Вертикальные турбинные насосы


Низкий уровень шума, компактный дизайн. Поставляется с трубными соединениями и спец. крышкой, внутренний диаметр трубки 12,7 мм

VTP 1, Макс. давление 1000 мбар, макс. скорость потока 9 л/мин

VTP 2, Макс. давление 1650 мбар, макс. скорость потока 12 л/мин

Требуется только там, где необходимо более высокое давление, чем то, которое может обеспечить внутренний насос для поддержания напора

## Как выбрать термостат?

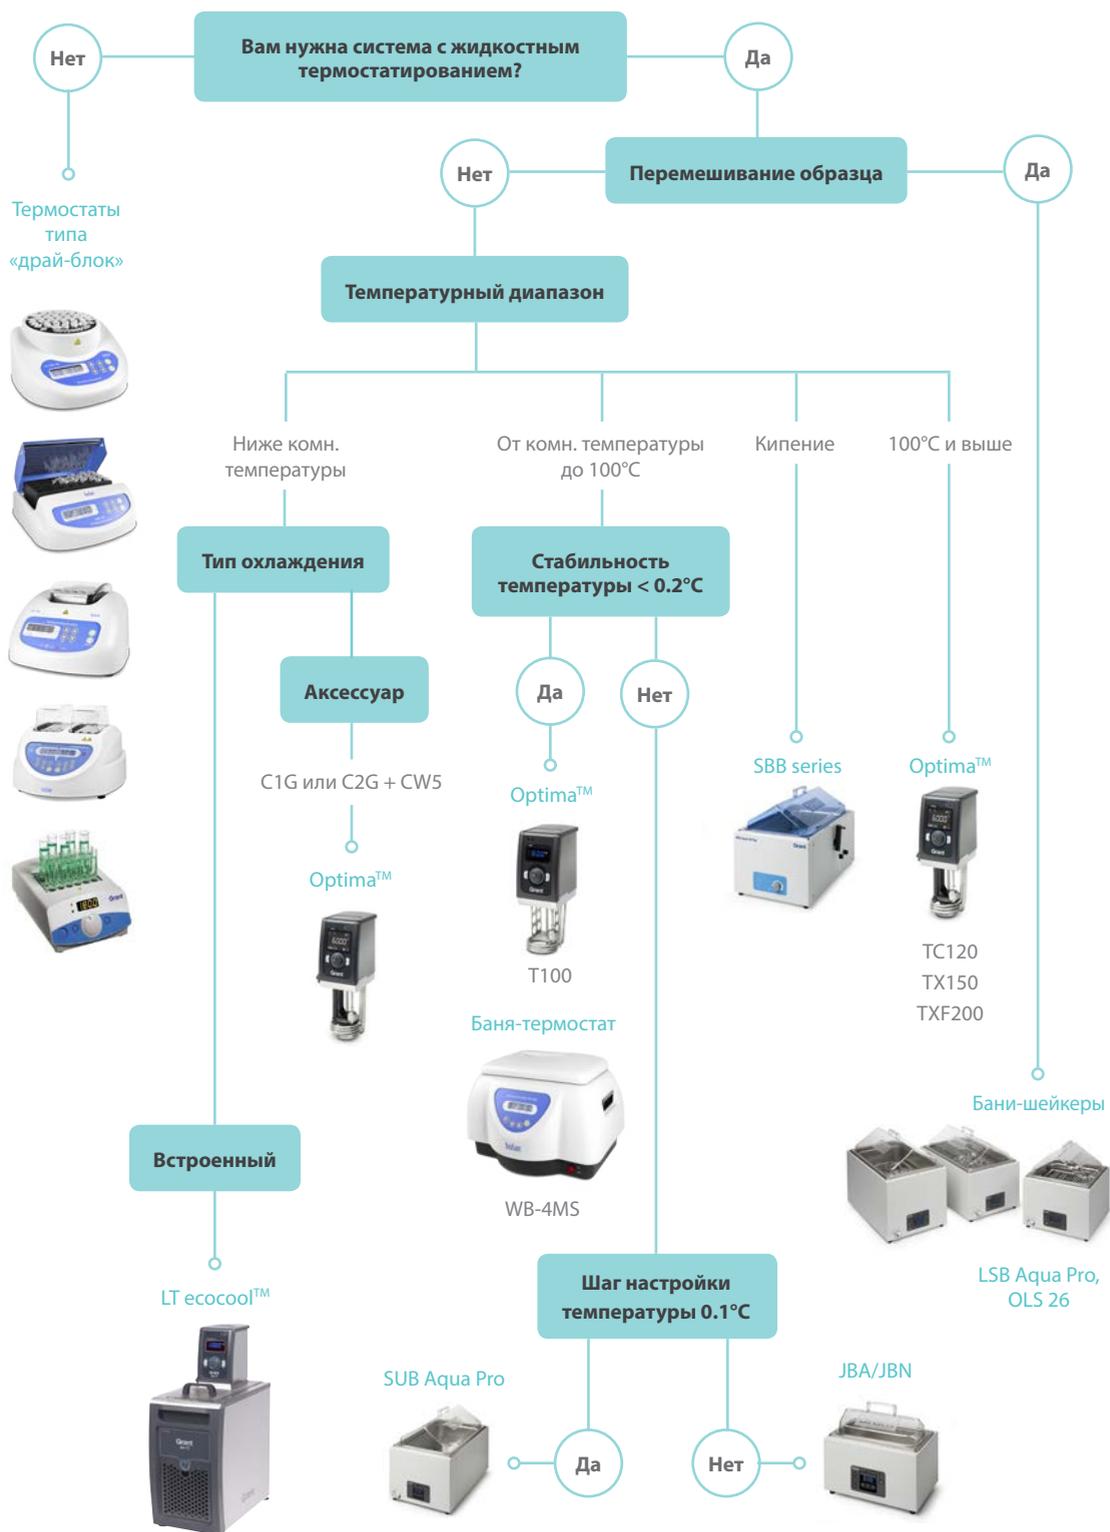

# МАГНИТНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ



**Intelli-Stirrer MSH-300i**  
Магнитная мешалка с нагревом



**MMS-3000**  
Высокоскоростная  
магнитная мешалка



**MM-1000**  
Лабораторная программируемая  
механическая мешалка

## MS-3000 и MMS-3000, Высокоскоростные магнитные мешалки

ОПИСАНИЕ

**MS-3000** и **MMS-3000** представляют собой компактные магнитные мешалки с рабочей поверхностью, изготовленной из нержавеющей стали. Приборы обеспечивают перемешивание жидкости со скоростью вращения магнитного элемента до 3000 об/мин. На сегодняшний день это самый высокий показатель максимальной скорости перемешивания среди магнитных мешалок мировых производителей.

Благодаря сильным магнитам, ведомый магнитный элемент не выпадает из магнитной муфты. При этом перемешивание не сопровождается нежелательным нагреванием и шумом.

Корпус мешалки **MS-3000** изготовлен из прочной стали, покрытой порошковой эмалью, химически устойчивой к кислотам и щелочам.

**MMS-3000** имеет съемный штатив, позволяющий поддерживать различные датчики (температурные, pH и пр.) внутри перемешиваемой жидкости.

В комплект мешалки входит стандартный магнитный перемешивающий элемент цилиндрической формы (6 × 25 мм) для универсального перемешивания, инкапсулированный в PTFE.


Магнитные мешалки идеально подходят для pH-метрии, экстракции и диализа с небольшими количествами вещества в лабораториях.

Температурный диапазон эксплуатации от +4°C до +40°C (от холодной комнаты до инкубатора) при макс. относительной влажности 80%.

Basic Plus  
Product Class



Basic Plus  
Product Class

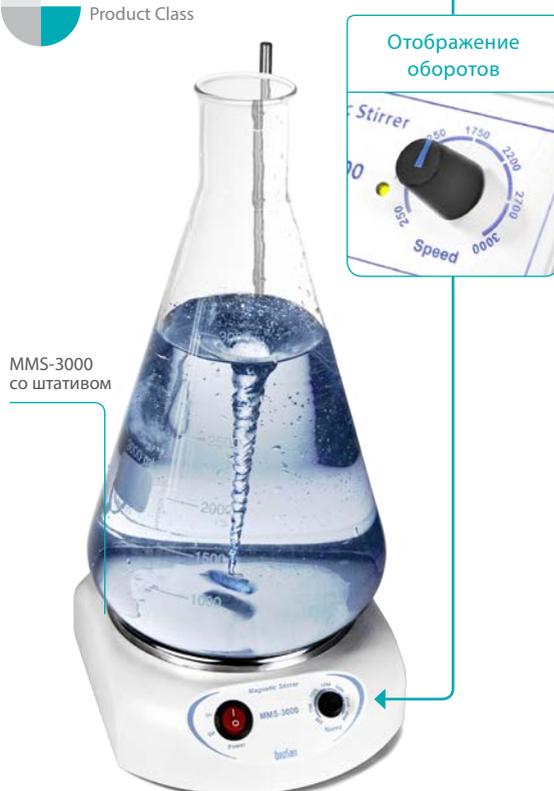

## MS-3000 и MMS-3000, Высокоскоростные магнитные мешалки

	MS-3000	MMS-3000
Диапазон регулирования скорости	0–3000 об/мин	
Максимальный объем перемешивания (H <sub>2</sub> O)	5 л	20 л
Материал рабочей поверхности	нержавеющая сталь	
Размер съемного штатива SR-1	—	Ø 8 × 320 мм
Макс. размер перемешиваемого элемента	50 мм	70 мм
Макс. коэффициент вязкости перемешиваемой жидкости	до 1170 мПа × с	
Макс. время непрерывной работы	24 часов	
Температурный диапазон эксплуатации	при комнатной температуре от +4°C до +40°C	
Размеры рабочей поверхности (Д×Ш)	110 × 110 мм	Ø160 мм
Размеры (Д×Ш×В)	120 × 150 × 65 мм	185 × 230 × 75 мм
Вес	0,8 кг	1,5 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 220 мА/2,6 Вт	12 В, 250 мА/3 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	

MMS-3000



MMS-3000



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**MS-3000** белый

**MS-3000** синий (по запросу)

**MMS-3000**

Принадлежности для MMS-3000:

**НТР-1**, Держатель температурного датчика (см. стр 85)

Кат. номер 

BS-010301-AAF

BS-010301-ABF

BS-010305-AAF

BS-010309-FK

## MSH-300 и Intelli-Stirrer MSH-300i, Магнитные мешалки с нагревом

ОПИСАНИЕ

**MSH-300** и **Intelli-Stirrer MSH-300i** представляют собой магнитные мешалки нового поколения.

Корпус мешалок изготовлен из металла, покрытого порошковой эмалью, химически резистентной к кислотам и щелочам. Мешалки имеют съемный штатив, позволяющий поддерживать внутри перемешиваемой жидкости различные датчики (температурные, *pH* и пр.).

В комплект мешалок входит стандартный магнитный перемешивающий элемент цилиндрической формы (6 × 25 мм) для универсального перемешивания, покрытый тефлоном.

Магнитные мешалки с подогревом используются в следующих видах лабораторных работ: органический синтез, экстракция, анализ нефтепродуктов, *pH*-метрия, диализ, суспендирование почвы, приготовление буферных растворов и т.д.

Встроенные средства диагностики неисправностей и автоматического отключения при перегреве обеспечивают безопасность приборов.

Температурный диапазон эксплуатации от +4°C до +40°C (от холодной комнаты до инкубатора) и макс. относительная влажность 80%.

**Intelli-Stirrer MSH-300i** — цифровая магнитная мешалка с подогревом, предназначенная для лабораторий с высокими требованиями. Обеспечивает цифровую установку температуры и скорости вращения.

Благодаря сильному магниту перемешивает жидкости повышенной вязкости (глицерин). Максимальный объем перемешиваемой жидкости (H<sub>2</sub>O) достигает 20 литров.

Предусмотрена возможность прямого контроля температуры перемешиваемой жидкости с помощью дополнительного внешнего датчика.

### Внешний температурный датчик:

Тип датчика	термопара
Тип соединения	тип K
Кабель покрыт тефлоном, механически прочен, эластичен и устойчив к маслам, кислотам, агрессивным реагентам и жидкостям	
Длина кабеля	1 м
Диапазон рабочей температуры	-50°C до +250°C

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**MSH-300** со штативом BS-010302-OAA

**Intelli-Stirrer MSH-300i** со штативом BS-010309-AAA

### Принадлежности:

**НТР-1**, держатель температурного датчика BS-010309-FK

**Внеш. температурный датчик** BS-010309-BK

### Basic Plus Product Class

MSH-300  
со штативом



### Premium Product Class

Intelli-Stirrer MSH-300i  
со штативом  
и темп. датчиком



## MSH-300 и Intelli-Stirrer MSH-300i, Магнитные мешалки с нагревом

	MSH-300	Intelli-Stirrer MSH-300i
Диапазон регулирования скорости	250–1250 об/мин	100–1250 об/мин (шаг 10 об/мин)
Максимальный объем перемешивания (H <sub>2</sub> O)	15 л	20 л
Диапазон установки температуры	+30°C ... +330°C	+30°C ... +330°C (шаг 1°C)
Диапазон измерения температуры жидкости внешним темп. датчиком	—	20°C ... +150°C
Дисплей	—	ЖК
Равномерность распределения температуры на плите	±3°C	
Время нагрева рабочей поверхности до 330°C	15 мин.	11 мин.
Диаметр рабочей поверхности	160 мм	
Материал рабочей поверхности	сплав алюминия	
Размер съемного штатива SR-1	Ø 8 × 320 мм	
Размер перемешивающего элемента	10–50 мм	20–70 мм
Макс. коэффициент вязкости перемешиваемой жидкости	до 1170 мПа × с	
Индикация перегрева или неисправности термодатчика	звуковой сигнал, отключение нагрева	вывод кода ошибки на дисплей, отключение нагрева
Размеры (Д×Ш×В)	190 × 270 × 100 мм	
Вес	2,9 кг	3,2 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность в режиме перемешивания	8,5 Вт	
Потребляемая мощность в режиме нагрева	550 Вт	

Подключение внешнего температурного датчика к Intelli-Stirrer MSH-300i



Время нагрева рабочей поверхности **MSH-300:**

от 25°C — **15 мин** — до 330°C

Время нагрева рабочей поверхности **MSH-300i:**

от 25°C — **11 мин** — до 330°C

Установка внешнего датчика



## ММ-1000, Лабораторная программируемая механическая мешалка

ОПИСАНИЕ

Лабораторная программируемая механическая мешалка **ММ-1000** (дизайн Bioforma) предназначена для перемешивания жидкостей и растворов объемом до 20 литров. Бесшумна и надежна в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может осуществлять 3 вида движений:

- 1 Вращательное
- 2 Возвратно-поступательное
- 3 Вибрирующее

**ММ-1000** реализовывает как отдельные циклы (моно) (1/2/3), так и последовательные бинарные циклы (n) типа  $(1-2) \times n / (1-3) \times n / (2-3) \times n$  и сложные трициклы  $(1-2-3) \times n$ .

Скорость, угол и время вращения мешалки регулируются микропроцессором и легко программируются оператором.

механическая мешалка может перемешивать растворы, достигающие уровня «средней вязкости» (от 1000 до 10 000 мПа × с).

Идеальный инструмент для биотехнологических, аналитических лабораторий и лабораторий органического синтеза. Инновационная комбинация 3 видов движения обеспечивает высокий уровень гомогенности при перемешивании за счет последовательного сочетания ламинарных и турбулентных потоков, ускоряющих растворение веществ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 1 Вращательное движение:

Диапазон регулирования скорости 40–1000 об/мин

Диапазон регулирования времени 0–250 сек.

### 2 Возвратно-поступательное движение:

Диапазон регулирования угла поворота 0–360° (шаг 30°)

Диапазон регулирования времени 0–250 сек.

### 3 Вибрирующее движение:

Диапазон регулирования угла поворота 0–5° (шаг 1°)

Диапазон регулирования времени 0–5 сек.

Звуковой сигнал таймера +

Максимальный объем перемешивания 20 л


Цифровая установка времени 1 мин. – 96 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)

Размеры (Д×Ш×В) 140×135×250 мм

Вес 2,4 кг

Потребляемый ток / мощность 12 В, 700 мА/8,4 Вт

Внешний блок питания вход АС 100–240 В, 50/60 Гц, выход DC 12 В

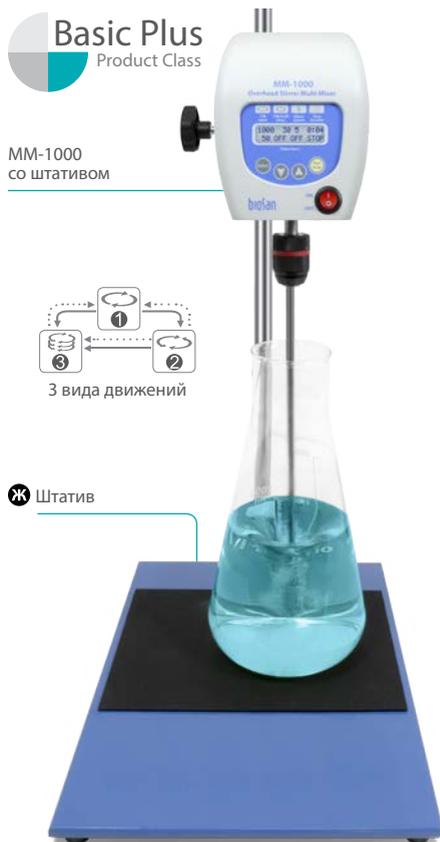

# ММ-1000, Лабораторная программируемая механическая мешалка


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер 

ММ-1000 без штатива

BS-010306-AAH

Принадлежности:	Тип	Описание	Кат. номер
<b>А</b> МР-1, перемешивающий элемент	Лопаточный	378 × (70 × 70) × 8 мм	BS-010306-AK
<b>Б</b> МР-2, перемешивающий элемент	Пропеллерный	2-лопастный, 326 × 55 × 8 мм	BS-010306-BK
<b>В</b> МР-3, перемешивающий элемент	Пропеллерный	3-лопастный, 325 × 50 × 8 мм	BS-010306-CK
<b>Г</b> МА-1, перемешивающий элемент	Якорный	332 × 90 × 8 мм	BS-010306-DK
<b>Д</b> МС-1, перемешивающий элемент	Центрифужный	358 × 60 (110) × 8 мм	BS-010306-EK
<b>Е</b> Двойной зажим	—	Для крепления прибора	VELA00001301
<b>Ж</b> SRB, штатив	—	Для крепления прибора, 40 × 30 × 87 см	VELA00001300

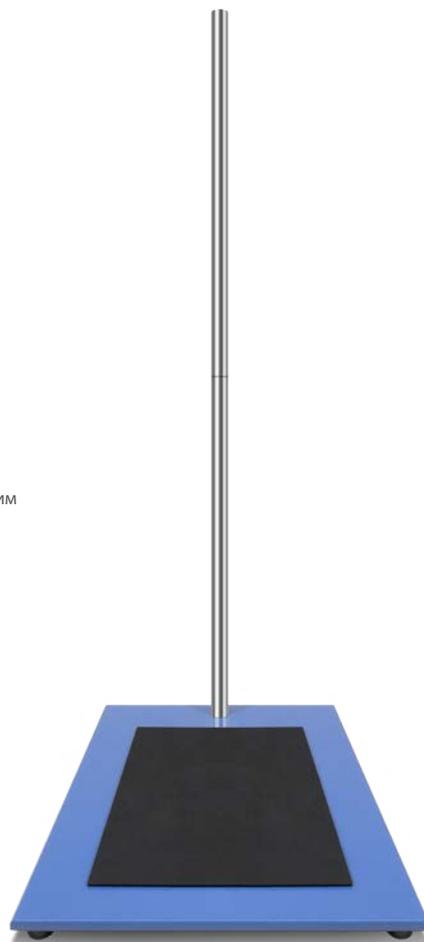**А** МР-1**Б** МР-2**В** МР-3**Г** SRB, штатив для крепления прибора**Д** МА-1**Е** МС-1**Ж** Двойной зажим



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БИОЗАЩИТЫ:  
**БИОЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ,  
БИОЗАЩИТА ВОЗДУХА,  
БИОЗАЩИТА ВОДЫ**



**UVC/T-M-AR**  
Бокс для стерильных работ



**UVT-S-AR**  
Бокс для стерильных работ



**UVR-Mi**  
Рециркулятор воздуха

## UVR-M и UVR-Mi, Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный

ОПИСАНИЕ

### Как работает проточный бактерицидный рециркулятор воздуха?

Принцип работы проточного бактерицидного рециркулятора воздуха основан на постоянной, активной циркуляции воздуха через камеру рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая максимальную эффективность дезинфекции. Кроме того, благодаря наличию зеркальной внутренней поверхности в камере рециркулятора, ультрафиолетовые лучи многократно отражаются, увеличивая плотность УФ-излучения и, следовательно, усиливая эффект обеззараживания.

### Из чего состоит прибор?

Прибор состоит из УФ-лампы (2 в UVR-Mi), вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в пластиковом корпусе.

### Каковы преимущества?

- Бактерицидные рециркуляторы воздуха UVR-M и UVR-Mi идеально подходят для обеззараживания воздуха в больницах (особенно в приёмных отделениях, операционных комнатах, родовых залах и т. д.), детских садах, исследовательских лабораториях, ветеринарных клиниках
- УФ излучение уничтожает болезнетворные вирусы, бактерии и грибки находящиеся в воздухе, что делает рециркуляторы высокоэффективным средством в борьбе с болезнями передающимися воздушно-капельным путём
- Обеспечивают полную защиту от воздействия прямого УФ-излучения
- Прост в установке, эксплуатации и обслуживании. Бесшумен в работе
- Встроенный таймер позволяет контролировать время работы УФ-ламп (только для UVR-Mi)
- Цифровой блок управления позволяет отслеживать общее время работы УФ-лампы (только для UVR-Mi)




Прибор **UVR-M** зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ

### Размещение прибора

- Удобное настенное размещение
- Доступен передвижной штатив **A**

### Чувствительность ДНК к излучению UVR-M и UVR-Mi

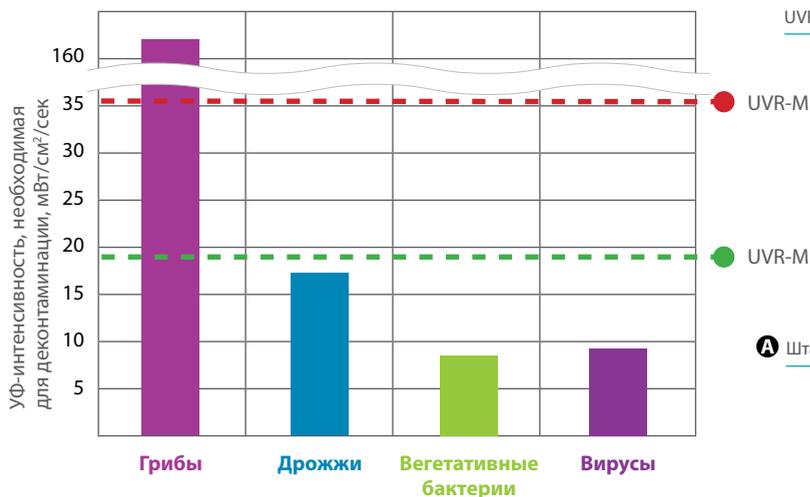


## UVR-M и UVR-Mi, Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	UVR-M	UVR-Mi
Источник УФ-излучения: 25 Вт, бактерицидные UV-C, TUV 25W 1SL/25	1 лампа	2 лампы
Интенсивность УФ-излучения	18 мВт/см <sup>2</sup> /сек	36 мВт/см <sup>2</sup> /сек
Продуктивность работы со стандартным фильтром	14 м <sup>3</sup> /ч	
Полная защита от воздействия прямого ультрафиолетового излучения		
Дисплей	—	ЖК
Индикатор работы УФ-ламп	присутствует	присутствует
Счетчик отработанного времени УФ-ламп	—	присутствует
Цифровая установка времени	—	1 мин. – 24 ч./непрерывно
Автоматическое включение/выключение рециркуляции	—	присутствует
Детекция неисправности ламп	—	присутствует
Размеры (Д×Ш×В)	110 × 135 × 660 мм	110 × 135 × 660 мм
Вес	3,4 кг	3,4 кг
Рабочее напряжение	230 В, 50 Гц или 120 В, 60 Гц	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	125 ВА (540 мА)/160 ВА (1,3 А)	110 Вт (0,5 А)

### Принцип работы прибора:

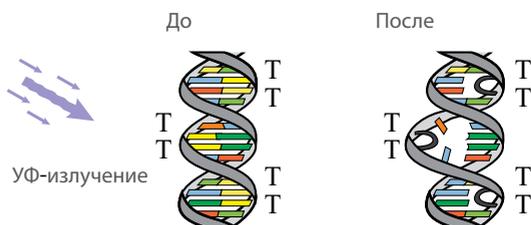

T — формирование диммеров тимина в результате облучения УФ

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: Кат. номер

**UVR-M** BS-040105-AAA

**UVR-Mi** BS-040110-AAA

#### Дополнительные принадлежности:

**UVR-S** штатив BS-040105-AK

### Уровень загрязнения в помещении до и после работы рециркулятора



## UVC/T-AR, UVC/T-M-AR, UVT-B-AR и UVT-S-AR Боксы для стерильных работ

Боксы для стерильных работ (UVC/T-AR, UVC/T-M-AR, UVT-B-AR и UVT-S-AR) применяются для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивают защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, состоят из металлической рамы, стекла (или оргстекла) и рабочей поверхности, покрытой порошковой эмалью или выполненной из нержавеющей стали (таблицу спецификаций см. на стр. 94).

Боксы оснащены одной открытой УФ-лампой, установленной в верхней части бокса. УФ-излучение дезинфицирует рабочую поверхность, инактивирует фрагменты ДНК/РНК в течение 15–30 минут. Цифровой таймер контролирует длительность прямого ультрафиолетового облучения. Лампа дневного света обеспечивает освещение рабочего места.

Боксы оснащены бактерицидным проточным УФ-рециркулятором воздуха AR, обеспечивающим постоянную дезинфекцию внутри бокса во время работы. Рекомендованы при работе с ДНК/РНК-ампликонами. УФ-рециркулятор воздуха AR состоит из УФ-лампы, вентилятора и антипылевого фильтра, заключенных в специальный корпус, т.е. персонал, работающий с боксом, не подвергается воздействию УФ-излучения. Включенный рециркулятор увеличивает максимум плотности УФ-лучей, что является достаточно эффективным для ДНК/РНК-инактивации, при этом через него прокачивается 100 объемов бокса за 1 час, что создает постоянные асептические условия работы внутри бокса.

### Преимущества боксов Биосан:

- УФ-деконтаминация высокой плотности без озона
- Длительный срок службы УФ-ламп (9000 ч.)
- Автоматическое выключение УФ-ламп в случае открытия передней дверцы
- Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы
- Стенки из ударопрочного стекла
- Низкий уровень шума и энергопотребления
- Стол для установки боксов
- Боксы с рециркулятором воздуха AR запатентованы фирмой Биосан



# UVC/T-AR, UVC/T-M-AR, UVT-B-AR и UVT-S-AR Боксы для стерильных работ




ПЦР-боксы UVT-S-AR с оборудованием для выделения нуклеиновых кислот



Рис. 1.1. Падение интенсивности УФ в зависимости от расстояния до поверхности источника УФ



Рис. 1.2. Гермицидная эффективность УФ для микроорганизмов различных классов

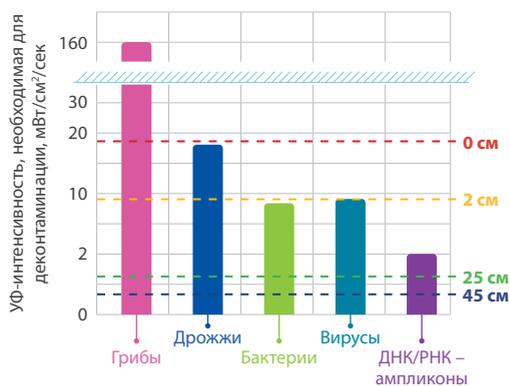

### Средняя доза облучения для поверхностей бокса

Внутренняя поверхность	УФ-доза за 15 мин.	УФ-доза за 30 мин.
Рабочая поверхность (40–50 см)	570–680 мВт/см²	1140–1360 мВт/см²
Боковые стенки (10–50 см)	570–2500 мВт/см²	1140–5000 мВт/см²
Передняя панель (10–50 см)	570–2500 мВт/см²	1140–5000 мВт/см²

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кат. номер

**UVC/T-AR** с входом для сетевых шнуров

BS-040102-AAA

**UVT-B-AR** со встроенной сетевой розеткой и с входом для сетевых шнуров

BS-040109-A06

**UVC/T-M-AR** со встроенной сетевой розеткой и с входом для сетевых шнуров

BS-040104-A06

**UVT-S-AR** со встроенными сетевыми розетками и с входом для сетевых шнуров

BS-040107-AAA


## UVC/T-AR, UVC/T-M-AR, UVT-B-AR и UVT-S-AR

### Боксы для стерильных работ



Модель	<b>UVT-S-AR</b> (двойной размер)
Материал стенок бокса	Задняя: нержавеющая сталь. Боковые и фронтальная: стекло (EUROGLASS, Германия)
Материал рабочей поверхности бокса	Нержавеющая сталь
УФ-лампа открытого типа	2 × 30W built-in bactericidal UV-C, TUV 30W 1SL/25
УФ-интенсивность	18 мВт/см <sup>2</sup> /сек
Тип излучения	Ультрафиолет (λ = 253,7 нм), без озона
Цифровая установка времени прямого УФ-излучения	1 мин. – 24 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)
УФ-рециркулятор	1 × 30 Вт (эффektivность > 99% за 1 час)
Лампа для освещения раб. поверхности бокса	1 × TLD-30 Вт
Толщина боковых стенок	4 мм
Толщина передней стенки	8 мм
Толщина защитного экрана	5 мм
Светопропускание	95%
Защита от ультрафиолета при прямом УФ-излучении	> 96% защита от ультрафиолета Пленка 4 MIL CLEAR
Размер рабочей поверхности	1210 × 500 мм
Размер проёма (Ш × В, полностью поднятый защитный экран)	1185 × 190 мм
Меры безопасности	Автоматическое отключение прямого УФ-света при открытом защитном экране
Электропитание внутри бокса	3 встроенные сетевые розетки, 1000 Вт макс., вход для сетевых шнуров
Рабочее напряжение	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	135 Вт
Размеры (Д×Ш×В)	1250 × 600 × 590 мм
Вес (нетто/брутто)	58/68,5 кг
Размеры стола для установки бокса	T-4L (Д × Ш × В): 1290 × 600 × 770 мм

UVT-S-AR

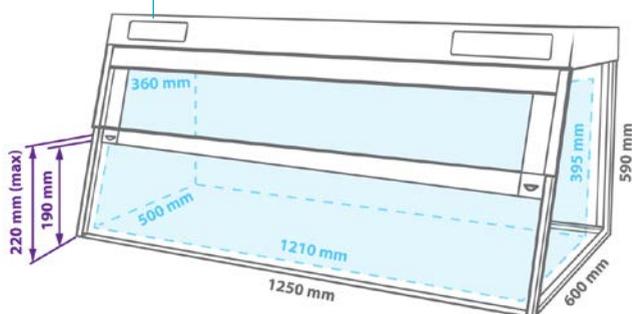


# UVC/T-AR, UVC/T-M-AR, UVT-B-AR и UVT-S-AR

## Боксы для стерильных работ




UVC/T-AR (компактный размер)	UVC/T-M-AR (компактный размер)	UVT-B-AR (компактный размер)
Оргстекло – полиметилакрилат (ALTUGLAS EX)	Задняя: нержавеющая сталь. Боковые и фронтальная: стекло (EUROGLASS, Германия)	Задняя: нержавеющая сталь. Боковые: сталь покрытая порошковой эмалью. Фронтальная: стекло (EUROGLASS, Германия)
Сталь, покрытая порошковой эмалью	Нержавеющая сталь	
1 × 25W built-in bactericidal UV-C, TUV 25W 1SL/25		
18 мВт/см <sup>2</sup> /сек		
Ультрафиолет (λ = 253,7 нм), без озона		
1 мин. – 24 ч./непрерывно (шаг 1 мин.)		
1 × 25 Вт (эффективность > 99% за 1 час)		
1 × TLD-15 Вт		
4 мм	4 мм	2 мм
8 мм		
8 мм	4 мм	4 мм
92%	95%	
> 99,90% Полиметилакрилат ALTUGLAS EX	> 96% защита от ультрафиолета Пленка 4 MIL CLEAR	
645 × 490 мм		
645 × 165 мм	630 × 190 мм	
Автоматическое отключение прямого УФ-света при открытом защитном экране		
Вход для сетевых шнуров	Вход для сетевых шнуров и 1 встроенная сетевая розетка, 1000 Вт макс.	
100–240 В, 50/60 Гц		
67 Вт		
720 × 535 × 555 мм	700 × 580 × 555 мм	
23/33 кг	28,8/39 кг	31,2/42 кг
Т-4 (Д × Ш × В): 800 × 600 × 745 мм		

UVC/T-AR

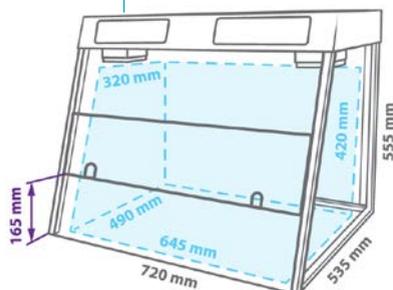

UVC/T-M-AR, UVT-B-AR

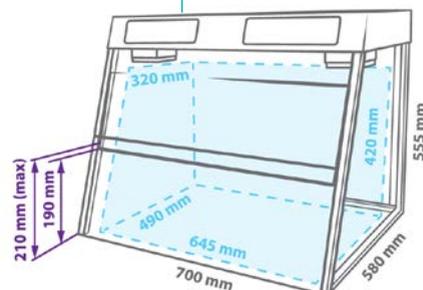

## P-5, F-1, Полки для ПЦР-боксов

ОПИСАНИЕ

Для ПЦР-боксов разработаны два вида полок: **P-5** – полка держатель для 5 пипеток и полка **F-1**, увеличивающая эффективную площадь бокса.

На полке **F-1** можно разместить лабораторную посуду, реагенты и другие предметы, которые удобно держать в непосредственной доступности.


### A P-5, полка для пипеток:

Размер (Д×Ш) 230 × 140 мм

Количество мест 5 пипеток

### B F-1, полка:

Размер (Д×Ш) 400 × 140 мм

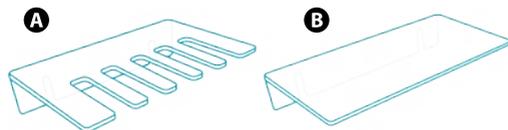

### A P-5, полка для пипеток



### B F-1, полка



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**P-5**, полка для пипеток

BS-040107-DK

**F-1**, полка

BS-040107-FK

## PDS-250 и PDS-10L, Раствор для дезактивации ДНК/РНК

ОПИСАНИЕ

Загрязнение особенно проблематично в высокочувствительной технике ПЦР. Происходящая из аэрозольных фрагментов, загрязняющая НК может привести к перекрестному загрязнению, что приводит к неточным данным и, как результат, к неверно истолкованному анализу.

**PDS** — это раствор для удаления ДНК, РНК, ДНКаз и РНКаз с поверхностей перед постановкой ПЦР реакции. ДНК/РНК удаляются в течение нескольких секунд после применения. Раствор содержит поверхностно-активное вещество, которое является нещелочным и неканцерогенным агентом.

**PDS** предназначен для использования в ПЦР-боксах, лабораторных устройствах – BioMagPure 12 Plus, термо-шейкерах для пробирок и планшетов, шейкерах-инкубаторах и т.д.

### Преимущества — Высокая эффективность.

**PDS** эффективен при удалении ампликона, плазмидной или геномной НК с большинства поверхностей, за исключением чистых легких или цветных металлов (например, алюминия, меди, свинца, никеля, олова, титана, цинка и т. д.).

**PDS** является температуроустойчивым и стабильным раствором в течение нескольких лет.

PDS-10L



PDS-250

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**PDS-250**, Раствор для дезактивации ДНК/РНК, 250 мл

BS-040107-DK

**PDS-10L**, Раствор для дезактивации ДНК/РНК, 10 л

BS-040107-FK

## Лабораторная мебель

**A** T-4, стол



**B** T-4L, стол



**C** LF-1, лабораторная тумбочка



Модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает функциональное размещение и удобное использование боксов.

### **A** T-4, стол для — UVC/T-AR, UVC/T-M-AR, UVT-B-AR

Максимальная нагрузка	50 кг
Полки	1
Подвижность	Колеса с тормозами
Материал	ЛДСП
Размеры (Д×Ш×В)	800 × 600 × 745 мм
Вес	23 кг

### **B** T-4L, стол для — UVT-S-AR

Максимальная нагрузка	75 кг
Полки	1
Подвижность	Колеса с тормозами
Материал	ЛДСП
Размеры (Д×Ш×В)	1290 × 600 × 770 мм
Вес	36 кг

### **C** LF-1, лабораторная тумбочка

Полки	5
Подвижность	Колеса с тормозами
Материал	ЛДСП
Размеры (Д×Ш×В)	300 × 450 × 705 мм
Вес	28 кг

UVT-S-AR на столе T-4L с лабораторными тумбочками LF-1



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**T-4**, стол

BS-040101-BK

**T-4L**, стол

BS-040107-BK

**LF-1**, лабораторная тумбочка

BS-050101-BK

## Системы сверхчистой воды: Labaqua

Системы сверхчистой воды **Labaqu** доступна в трёх исполнениях **Labaqu Trace**, **HPLC**, **Bio** – это multifunctional системы очистки воды, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды соответствующую требованиям стандарта ISO 3696.

Сверхчистая вода, производимая системами Labaqua, обладает удельным сопротивлением 18,2 МОм·см (0,055 мкСм/см), что превосходит требования всех соответствующих стандартов (ISO 3696 класс 1, ASTM тип I, CLSI тип I). Очищенная вода накапливается в резервуаре. Встроенная система рециркуляции предохраняет от бактериологического загрязнения и обеспечивает постоянное качество воды (класс 2) а также значительно уменьшает содержание общего органического углерода: < 2 ppb.

Системы **Labaqu HPLC** производят воду, предназначенную как для высокоэффективной, так и прочих методов жидкостной хроматографии. Так же вода, произведенная системой Labaqua HPLC, может использоваться в некоторых методах микро- и молекулярной биологии.

Получение сверхчистой воды (класса 1) происходит через микрофильтр, расположенный под передней панелью, тогда как получение чистой воды (класса 2) происходит непосредственно из накопительного резервуара.

Сверхчистая вода, произведенная системой **Labaqu BIO**, предназначена для использования в методах с высочайшими требованиями стандартов, включая, среди прочего, следующие: молекулярная биология – в том числе ПНКазочувствительные методы, разбавление праймеров, подготовка сред и прочие.

Чистая вода систем **Labaqu Trace** предназначена для пламенной спектрометрии и может использоваться так же для промывки лабораторной посуды, «мокрой» химии, и т. д.

Все картриджи и фильтры легкодоступны для сервисного обслуживания, их замена не требует никаких дополнительных инструментов. Системы **Labaqu** могут быть установлены на стене или под столом, не занимая лишнего рабочего пространства.

### В комплект систем сверхчистой воды Labaqua входят:

- насос повышения давления для работы модулей обратного осмоса
- набор предварительных фильтров
- модуль обратного осмоса
- модуль деионизации
- модуль полировки
- накопительный резервуар объемом 30 литров со встроенным краном
- система рециркуляции

### Специализированные модули:

- **Labaqu Trace** — микрофильтр
- **Labaqu HPLC** — модуль контроля общего органического углерода, микрофильтр
- **Labaqu Bio** — модуль контроля общего органического углерода, ультрафильтр, модуль УФ-стерилизации



### Особенности:

- **Дозирование объемов** — позволяет пользователю устанавливать точный объем раздачи для каждого цикла дозирования. Объем раздачи можно установить либо на клавиатуре, либо с помощью режима программирования.
- **Качество воды** — встроенный контур рециркуляции поддерживает стабильное качество воды.
- **Низкие эксплуатационные расходы** — постоянно контролируется работа модулей деионизации и полировки. Алгоритм монитора позволяет сократить эксплуатационные расходы, так как замена модулей запрашивается только тогда, когда срок службы близится к концу.
- **Подсчет общего органического углерода (ТОС)** — органические загрязняющие вещества могут не влиять на проводимость воды, поэтому датчики проводимости не могут использоваться для мониторинга ТОС. Для измерения уровня ТОС используется специальный модуль мониторинга ТОС.
- **Цветной графический ЖК-дисплей** — статус системных компонентов отображается на дисплее в интуитивно понятной цветовой палитре (зеленый / желтый / красный).
- **Системная блок-схема** — наглядно отображает все параметры компонентов и параметры качества воды.



## Системы сверхчистой воды: Labaqua

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры очищенной воды	Labaqu Trace	Labaqu HPLC	Labaqu Bio
Удельное сопротивление воды класса 1	18,2 МОм × см		
Электропроводимость воды класса 1	0,055 мкСм/см		
Удельное сопротивление воды класса 2	> 10 МОм × см		
Электропроводимость воды класса 2	< 0,1 мкСм/см		
Содержание общего органического углерода	< 30 ppb	< 2 ppb	
РНКаза	—	—	< 0.01 нг/мл
ДНКаза	—	—	< 4 нг/мкл
Бактерии	< 1 КОЕ/мл		< 0.01 КОЕ/мл
Эндотоксины	< 0.15 ЕЭ/мл		< 0.001 ЕЭ/мл
Частицы > 0,22 мкм	< 1/мл		
Ресурс модуля деионизации (стандартный модуль)	1 м <sup>3</sup>		
Размеры (Д × Ш × В)	560 × 320 × 620 мм		
Полезный объем накопительного резервуара	25 л		
Допустимое давление воды на входе системы	0.5 – 5 атм		
Электропроводимость воды на входе системы	< 1300 мкСм/см		
Вес	24 кг	25 кг	26 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность	130 Вт		

	Применение	Labaqu Trace	Labaqu HPLC	Labaqu Bio
Общие лабораторные применения	Полоскание посуды	+	+	+
	Лабораторные промыватели планшетов	+	+	+
	Автоклавы	+	+	+
	Электрохимия	+	+	+
	Жидкостная химия	+	+	+
	Спектрофотометрия	+	+	+
	Подготовка буферных растворов и сред	+	+	+
	Подготовка реагентов	+	+	+
Методы неорганического анализа	Спектрофотометрия атомной абсорбции пламени	+	+	+
	Атомная абсорбционная спектрофотометрия	+	+	+
	Плазменная масс-спектрометрия (ICPMS)	+	+	+
	Плазменная спектрофотометрия (ICPOES)	+	+	+
	Ионная хроматография	+	+	+
Методы органического анализа	Жидкостная хроматография (HPLC/ UHPLC)		+	+
	Газовая хроматография		+	+
	Определения Общего органического углерода (TOC)		+	+
Молекулярная биология	Проточная цитометрия			+
	Культуры клеток и тканей			+
	Молекулярная биология			+

## Системы сверхчистой воды: Labaqua

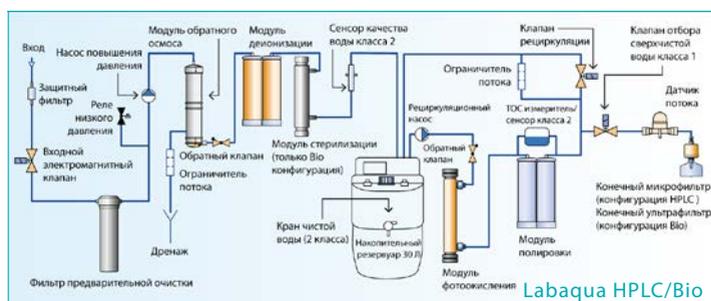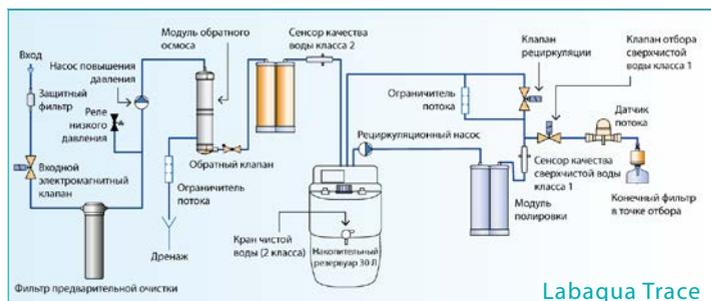

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**Лabaqua Trace** с 30 л резервуаром, шнур питания

BS-070105-A02

**Лabaqua HPLC** с 30 л резервуаром, шнур питания

BS-070104-A02

**Лabaqua Bio** с 30 л резервуаром, шнур питания

BS-070106-A02

**Дополнительные принадлежности:**

Комплект внешних предварительных фильтров (полифосфат/угольный/1µm) с манометром

BS-070104-LK

Комплект внешних предварительных фильтров (угольный/1µm) с манометром

BS-070104-KK

Накопительный резервуар с датчиком уровня, 50 Л

BS-070102-DK

Накопительный резервуар, 60 Л

BS-070102-EK

Накопительный резервуар, 100 Л

BS-070102-FK

Накопительный резервуар, 200 Л

BS-070102-GK

Накопительный резервуар, 300 Л

BS-070102-HK

**Запасные части:**

Комплект внутренних предварительных фильтров

BS-070104-AK

Модуль деионизации

BS-070104-IK

Полировочный модуль

BS-070104-BK

Микрофильтр - 0,22 мкм нестерильные

BS-070104-EK

Микрофильтр - 0,22 мкм стерильный

BS-070104-FK

Ультрафильтр

BS-070104-GK

УФ-лампа 254 нм

BS-070104-CK

УФ-лампа 185 нм

BS-070104-DK

Воздушный фильтр для накопительного резервуара 0,22 мкм

BS-070102-AK

# ДЕНСИТОМЕТРЫ, ФОТОМЕТР



**DEN-1**  
Денситометр



**DEN-1B**  
Денситометр



**DEN-600**  
Фотометр

## DEN-1 и DEN-1B, Денситометры

ОПИСАНИЕ

Денситометры **DEN-1** и **DEN-1B** предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона:

0 ... 6,0 единиц Мак-Фарланда (McF)  
(0 ...  $180 \times 10^7$  клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких пределах (6,0–15,0 единиц Мак-Фарланда), но следует учитывать, что при этом возрастает и ошибка измерений.

Денситометр используют для определения концентрации клеток (бактериальных, дрожжевых) в процессе ферментации, при определении чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, идентификации микроорганизмов при помощи различных тест-систем, для измерения абсорбции при фиксированной длине волны, а также для количественной оценки концентрации окрашенных растворов, абсорбирующих зеленый свет.

Принцип работы прибора основан на измерении оптической плотности с последующим цифровым представлением результатов в виде единиц Мак-Фарланда.

Прибор откалиброван изготовителем и сохраняет данные калибровки. При необходимости возможно выполнение калибровки по 2–6 точкам в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц Мак-Фарланда. Для выполнения калибровки можно использовать как стандарты поставленные Biosan, так и клеточные суспензии, приготовленные непосредственно в лаборатории.

### Дополнительные принадлежности:

- **СКГ16** Набор для работы со стеклянными пробирками диаметром 16 мм, стандарты – 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (латексные частицы)
- **СКГ1802** Набор для работы со стеклянными пробирками диаметром 18 мм, стандарты – 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 (BaSO<sub>4</sub>)
- **СКГ12** Набор для работы со стеклянными пробирками диаметром 12 мм, стандарты – 0.0; 0.5; 2.0; 3.0; (латексные частицы)
- **Стеклопипетки** — Стеклопипетки без крышки (Ø16 мм, высота 100 мм), 78 шт. Подходят для DEN-1, DEN-1B – заводской калибровки

### Доступны две версии прибора:

1. **DEN-1**, работающий от внешнего блока питания.
2. **DEN-1B**, работающий как от внешнего блока питания, так и от батареек (AA).

Premium  
Product Class



Basic Plus  
Product Class



Адаптер А-16




DEN-1B кнопки для калибровки



## DEN-1 и DEN-1B, Денситометры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	DEN-1	DEN-1B
Источник света	светодиод	
Длина волны	$\lambda = 565 \pm 15$ нм	
Диапазон измерения	0,00–15,00 McF	
Разрешение дисплея	0,01 McF	
Точность	(0,0–6,0 McF) $\pm 3\%$	
Время измерения	1 сек.	
Объем образца	не менее 2 мл	
Внешний диаметр пробирок	18 мм (без адаптера) 16 мм (с адаптером A-16) 12 мм (с адаптером A-12)	
Функция возврата к заводской калибровке		
Дисплей	ЖК	
Размеры (Д×Ш×В)	165 × 115 × 75 мм	
Вес	0,7 кг	
Независимый источник питания	—	3 × батарейки типа AA
Потребляемый ток/мощность	12 В, 7 мА/0,1 Вт	
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	
Стандартный набор	Адаптер A-16, внешний блок питания	Адаптер A-16, внешний блок питания, 3 × батарейки типа AA

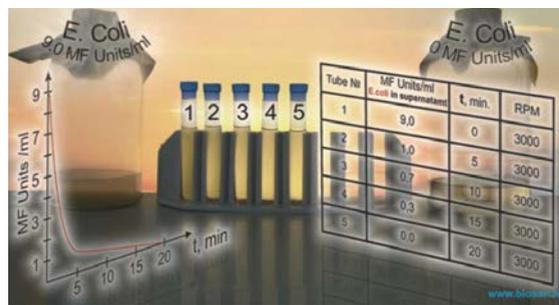

Применение денситометров для определения концентрации микробных клеток супернатанта в пробирках в течение центрифугирования. Показатель мутности измеряется в единицах Мак-Фарланда.



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**DEN-1** с адаптером **A-16**

BS-050102-AAF

**DEN-1B** с адаптером **A-16**

BS-050104-AAF

**Дополнительные принадлежности:**

**A-12** адаптер для 12 мл пробирок

BS-050102-1K

**СКГ16** калибровочный набор  $\varnothing 16$  мм, стандарты – 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

BS-050102-BK

**СКГ1802** калибровочный набор  $\varnothing 18$  мм, стандарты – 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 McF

BS-050102-GK

**СКГ12** калибровочный набор  $\varnothing 12$  мм, стандарты – 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; McF

BS-050102-DK

**Стеклонные пробирки без крышек** (16 × 100 × 0,8 мм), 78 шт.

BS-050102-LK

Подходят для DEN-1, DEN-1B – заводской калибровки.

## DEN-600, Фотометр НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

**DEN-600** — это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. **DEN-600** использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод ОП600, который оценивает общее количество клеток, 2) метод измерения мутности Макфарланда (McF), 3) метод анализа Брэдфорда для измерения концентрации белка.

Устройство служит недорогой альтернативой спектрофотометру, который обычно используется для этих применений. Поскольку **DEN-600** питается от батареи и компактен, его можно удобно разместить в боксе биобезопасности, анаэробной камере или быстро переместить в другое лабораторное помещение. Кроме того, механизм удержания сосуда позволяет размещать стандартные 10-миллиметровые кюветы, пробирки с круглым, коническим дном, или Falcon типа пробирки, что позволяет измерять поглощение и мутность в единицах Abs, OD или McF.

USB-подключение и программное обеспечение DEN позволяют передавать, обрабатывать и вычислять данные, настраивать калибровку для метода анализа белка Брэдфорда или для особых пробирок также для использования персонализированных стандартов мутности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света	Светодиод
Фотодетектор	Кремниевый фотодиод
Длина волны (λ)	600 нм ±10 нм
Типы сосудов	Кюветы, круглодонные пробирки
Тип батареи	Литий-ионная

Требования к компьютеру Intel/ AMD процессор, 1 Гб RAM, ОС Windows Vista/7/8/10, USB

Размеры (Д×Ш×В) 120 × 145 × 65 мм

Вес 0.5 кг

Внешний блок питания вход. AC 100–240 В 50/60 Гц; выход. DC 12 В


Методы измерения	Абсорбция	Макфарланд
Диапазон измерений	0–3.0 Abs	0–16.00 McF
Разрешение	0.001 Abs	0.01 McF
Точность	±0.006 @ 1 Abs	±0.1 @ 0–8 McF
Повторяемость	±0.003 @ 1 Abs	±0.05 @ 0–8 McF

Smart Plus  
Product Class



### ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Измерение концентрации клеток
- Оценка данных роста клеток
- Оценка логарифмической фазы роста для индукции микробных клеток
- Подготовка компетентных клеток
- Метод количественного определения белка по Брэдфорду
- Тесты на чувствительность к антибиотикам
- Тесты на ингибирование

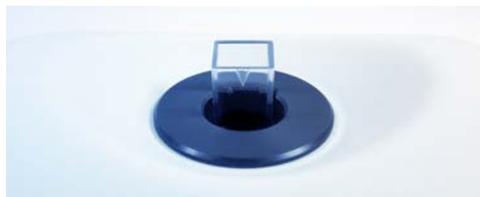

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

**DEN-600**

Дополнительные принадлежности:

**СКГ16** калибровочный набор Ø16 мм, стандарты – 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

Кат. номер

BS-050109-AAA

BS-050102-BK

# АСПИРАТОРЫ, ДОЗАТОРЫ



**Assist**  
Серия пипеток



**Assistboy**  
Пипеточный дозатор



**FTA-2i**  
Аспиратор с сосудом-ловушкой

## FTA-2i, Аспиратор с сосудом-ловушкой

ОПИСАНИЕ

Аспиратор с сосудом-ловушкой **FTA-2i** предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК, РНК и других технологий пересаживания макромолекул).

Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывки клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере.

Принцип работы аспиратора заключается в создании отрицательного давления в сосуде-ловушке при помощи микрокомпрессора, встроенного в корпус.

Сосуд-ловушка соединен полиэтиленовой трубкой с аспирационным наконечником.

Жидкость удаляется из пробирки при контакте наконечника и жидкости.

На правой стороне прибора находится держатель для двух пробирок объемом 1,5–2 мл (например, для раствора соляной кислоты и дистиллированной воды), необходимых для полоскания и хранения аспирационного наконечника, для повторного использования.

**FTA-2i** оборудован датчиком уровня жидкости для определения избытка жидкости для предупреждения переполнения путём отключения насоса, со звуковым сигналом.

Прибор укомплектован, по умолчанию, ручкой-регулятором вакуума для плавной установки желаемой скорости аспирации.

Дополнительно предоставляется ручной контроллер для более удобного использования опциональных принадлежностей. (см. стр.107)

Автоклавируемый ручной контроллер имеет чувствительную к давлению кнопку для регулирования скорости аспирации.

### Область применения:

Удаление и утилизация жидкостей с разнообразных реакционных сосудов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Скорость аспирации до 10 л/мин (воздух)

Регулировка вакуума от -200 до -800 мбар

Сосуд-ловушка 2 л, полипропилен (автоклавируемый)

Тип датчика инвазивный

Звуковой сигнал таймера +

Защита от переполнения остановка мотора, звуковой и световой сигнал

Фильтрация: микробиологический фильтр 2200/02 гидрофобный (устраняет риск выхода бактерий, вирусов и инфекционных частиц из сосуда-ловушки)

Диаметр пор фильтра 0,027 мкм

Потребляемый ток, мощность 12В, 1 А/10,8 Вт

Внешний блок питания вход AC 100–240В 50/60Гц, выход DC 12В

Размеры (Д×Ш×В) 185 × 290 × 390 мм

Вес\* 1,85 кг

\* — С точностью ±10%



Микробиологический гидрофобный фильтр


Держатель для двух пробирок объемом 1,5-2 мл

## FTA-2i, Аспиратор с сосудом-ловушкой


### Дополнительные принадлежности:

**HAS-1**, комплект ручного контролера

- ❶ Рукоятка с контролем вакуума;
- ❷ Одноканальный адаптер для наконечников объемом 200 мкл;
- ❸ Одноканальный адаптер с иглой из нержавеющей стали 125 мм;
- ❹ Одноканальный адаптер с иглой из нержавеющей стали 40 мм;
- ❺ 8-канальный адаптер для наконечников объемом 200 мкл;
- ❻ 8-канальный адаптер с иглами из нержавеющей стали 35 мм;
- ❼ Штатив SH-6

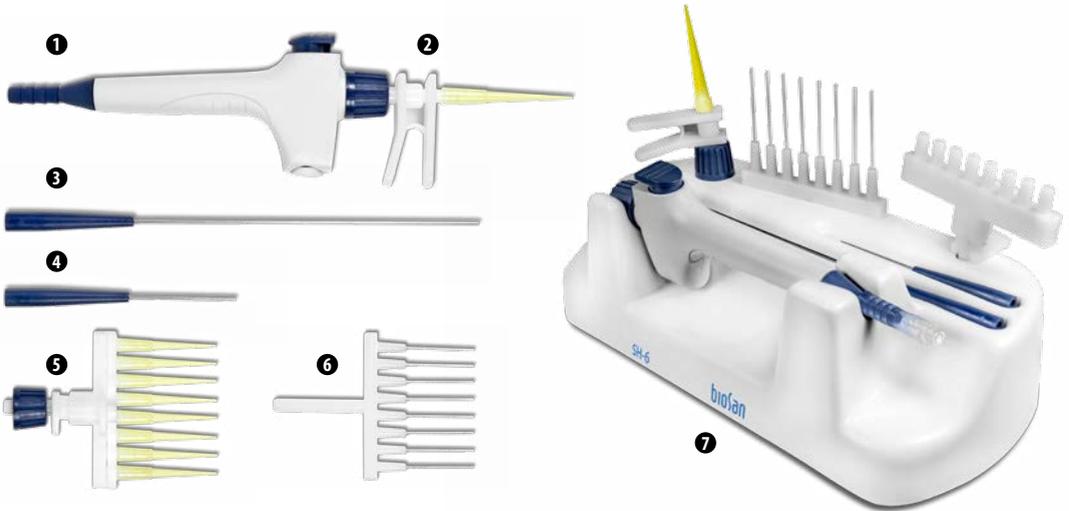

❽ MA-8, 8-канальный адаптер-коллектор



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер 

**FTA-2i**, 2 л сосуд-ловушка, универсальный адаптер MA-U (для объёма 200/1000 мкл)

BS-040120-A02

### Дополнительные принадлежности:

**HAS-1**, комплект ручного контролера

BS-040118-PK

**MA-8**, 8-канальный адаптер-коллектор

BS-040108-BK

Удлиненная трубка длиной 2 м, с фитингами и адаптером MA-U

BS-040120-DK

### Запасные части:

Аспирационный микробиологический фильтр

BS-040120-S10

**MA-U**, универсальный адаптер для одноразовых наконечников объёмом 200/1000 мкл

BS-040118-AK

## FTA-1, Аспиратор с колбой-ловушкой

ОПИСАНИЕ

Аспиратор с колбой-ловушкой FTA-1 предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорфа при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул.

Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывания клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере. Принцип работы аспиратора заключается в создании отрицательного давления в колбе-ловушке при помощи микрокомпрессора, встроенного в корпус. Колба-ловушка соединена полиэтиленовой трубкой с наконечником. Жидкость удаляется из пробирки в колбу-ловушку при соприкосновении наконечника с поверхностью раствора. Для удобства с правой стороны прибора находится мини-штатив-органайзер, предназначенный для двух пробирок (например, раствора соляной кислоты и дистиллята), необходимых для отмывки и хранения наконечника с целью его повторного использования.

❶ Аспирационный микробиологический фильтр устраняет риск выхода бактерий, вирусов и инфекционных частиц из колбы-ловушки. Аспирационный микробиологический фильтр гидрофобен: задерживает частицы размером больше 0,027 микрон, что меньше вирусов гепатитов А, В и С, с эффективностью до 99,9%.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вакуум	-500 мбар
Объем колбы-ловушки	1 литр
Размеры с колбой-ловушкой (Д×Ш×В)	160×210×340 мм
Вес с колбой-ловушкой	1,7 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В, 300 мА/3,6 Вт
Внешний блок питания	вход АС 100–240 В; 50/60 Гц; выход DC 12 В



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

**FTA-1** с колбой-ловушкой (1л) BS-040108-ААГ  
и аспирационным микробиологическим фильтром

#### Дополнительные принадлежности:

**МА-8**, 8-канальный адаптер-коллектор BS-040108-ВК

#### Запасные части:

Аспирационный микробиологический фильтр BS-040108-S25

Basic Plus  
Product Class

❶ Аспирационный гидрофобный микробиологический фильтр



Прибор зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

Дополнительный 8-канальный адаптер-коллектор МА-8



## Серия пипеток Assist

I LOVE PIPETTE



ОПИСАНИЕ

Серия пипеток **Assist** — это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема.

Одноканальные пипетки выпускаются в 10 диапазонах устанавливаемого объема для дозирования жидкости в пределах от 0,2 до 2,0 мкл, от 0,5 до 10,0 мкл, от 2 до 20 мкл, от 5 до 50 мкл, от 10 до 100 мкл, от 20 до 200 мкл, от 50 до 250 мкл, от 100 до 1000 мкл, от 500 до 5000 мкл или от 1000 до 10000 мкл.

Многоканальные (8 и 12 каналов) пипетки выпускаются в четырех диапазонах устанавливаемого объема от 0,5 до 10 мкл, от 5 до 10 мкл, от 20 до 200 мкл или от 20 до 300 мкл.

Пипетки оснащены аналоговым счетчиком, указывающим отмеряемую дозу жидкости. Изменение объема достигается путем поворота воротка в кнопке пипетирования, либо путем вращения в нужном направлении черного калибровочного воротка регулирования объема. Диапазон объемов, которые можно отмерять с помощью пипетки обозначен на клавише пипетирования.

Предназначение пипеток в зависимости от объема	
AP2, AP10, AP8-10, AP12-10	Измерение, перенос, малых количеств делений ДНА и определение ферментов.
AP20, AP50, AP100, AP200, AP250, AP1000, AP8-50, AP12-50, AP8-200, AP12-200, AP8-300, AP12-300	Измерение, перенос, водных, кислотных и щелочных растворов.
AP5000, AP10000	Измерение, перенос больших объемов.

Пипетки:	Объем (мкл)	Цветовой код	Тип наконечника	Кат. номер
<b>Одноканальные:</b>				
AP2	0,1–2,0	●	10 мкл	BS-010501
AP10	0,5–10,0	●		BS-010502
AP20	2–20	●	200 мкл	BS-010503
AP50	5–50	●		BS-010504
AP100	10–100	●		BS-010505
AP200	20–200	●		BS-010506
AP250	50–250	●	300 мкл	BS-010507
AP1000	100–1000	●	1000 мкл	BS-010508
AP5000	500–5000	○	5000 мкл	BS-010509
AP10000	1000–10000	○	10000 мкл	BS-010510
<b>Многоканальные:</b>				
AP8-10	0,5–10	–	10 мкл	BS-010511
AP12-10				BS-010512
AP8-50	5–50	–	200 мкл	BS-010513
AP12-50				BS-010514
AP8-200	BS-010515			
AP12-200	BS-010516			
AP8-300	50–300	–	300 мкл	BS-010517
AP12-300				BS-010518
<b>Комплекты:</b>				
AP10, AP20, AP200, AP1000, линейный штатив – 4 места, демо наконечники				BS-010519
AP10, AP100, AP1000, AP5000, линейный штатив – 4 места, демо наконечники				BS-010520

## Серия пипеток Assist

### Особенности


- Эргономичный дизайн и облегченный вес;
- Исключительная точность и воспроизводимость дозирования;
- Устойчивый к УФ и полностью автоклавируемый корпус;
- Пипетки на 5 и 10 мл укомплектованы фильтрами, защищающими поршень от агрессивных веществ;
- Доступны 8- и 12-канальные пипетки;
- Цветовая кодировка пипеток для быстрого определения нужного объема;
- Регулируемая высота сбрасывателя наконечников – совместимость с наконечниками разных производителей;
- Система двойного настраивания объема, как с использованием устройства, расположенного в корпусе дозатора, так и с помощью вращения круглой кнопки для пипетирования;
- Мягкая система пружин позволяет осуществлять точное дозирование с гораздо меньшим усилием.

Цветовая кодировка пипеток для быстрого определения нужного объема



### Особенности наконечников:

- Наконечники изготовлены из высококачественного медицинского полипропилена, а фильтрующий элемент – из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обладающего хорошей гидрофобностью;
- Фильтрующий элемент эффективно защищает пипетку от влаги, чтобы гарантировать безопасность аспирации образца;
- Нет внутреннего покрытия поверхности, не загрязняет образец;
- Имеет точные отметки;
- Не содержит ДНКаз, РНКаз и пирогенов;
- Можно автоклавировать;
- Подходит для обычных пипеток, таких как Biosan (серия Assist) Eppendorf и Gilson;
- Поставляется в стерильных штативах.

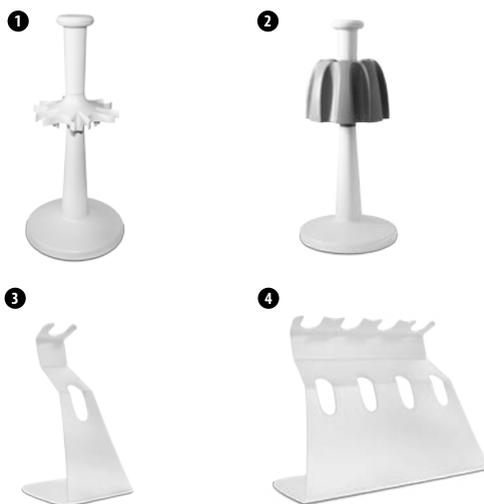

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Штативы:	Кат. номер
1 Штатив-карусель (вращающаяся) для 6 пипеток	BS-010522
2 Универсальный штатив (фиксированный) для 8 пипеток	BS-010523
3 Линейный штатив, 1 место	BS-010524
4 Линейный штатив, 4 места	BS-010525



### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Наконечники:	Размер (В×Ø)	Упаковка	Цвет	Совместимость	Кат. номер
1 10 мкл с фильтром	32 × 0.4 мм	96 шт. в штативе	Натуральный	Универсальные	BSH31S1
2 200 мкл с фильтром	59 × 0.5 мм	96 шт. в штативе	Натуральный	Универсальные	BSH35S1
3 1000 мкл с фильтром	86 × 0.8 мм	96 шт. в штативе	Натуральный	Универсальные	BSH37S1

## Пипеточный дозатор Assistboy



Штатив для подзарядки аккумулятора



Пипеточный дозатор **Assistboy** – это устройство, предназначенное для забора жидкости с применением мерных (серологических) пипеток. Устройство предназначено для работы со всеми видами серологических пипеток емкостью от 0,5 мл до 100 мл, как стеклянными, так и пластиковыми.

Прибор оснащен сменными мембранами фильтрами, которые защищают механизм устройства от загрязнения парами собираемых растворов.

Два режима дозирования позволяют подобрать оптимальные условия работы в зависимости от нужд пользователя. Настройка функций пипеточного дозатора отображается на дисплее.

### Безопасность и эффективность

- Дозатор оснащен гидрофобным защитным тефлоновым (PTFE) фильтром, который предотвращает попадание жидкости внутрь
- Автоклавируемый фильтр, фиксатор пипеток и наконечник
- Устойчивый к УФ излучению корпус обеспечивает безопасную стерилизацию
- Мощные и экологически чистые Ni-MH аккумуляторы гарантируют многочасовую непрерывную работу дозатора
- ЖК дисплей отображает уровень заряда аккумулятора

### Регулирование скорости и режима работы

- Эргономичное расположение кнопок для контроля скорости и режима работы дозатора. Управление осуществляется большим пальцем руки
- Скорость набора жидкости регулируется силой нажатия кнопок на внутренней стороне рукоятки дозатора

### Комфорт

- Подходит для работы с пластиковыми и стеклянными серологическими пипетками объемом 0,5-100 мл
- Эргономичный дизайн
- Удобное расположение кнопок управления
- Функциональный штатив для подзарядки аккумуляторов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер



**Assistboy**, с штативом для подзарядки аккумуляторов

BS-010521



БИОПРОЦЕССЫ:

# ШЕЙКЕРЫ-ИНКУБАТОРЫ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БИОРЕАКТОРЫ, CO<sub>2</sub> ИНКУБАТОР



**S-Bt Smart Biotherm**  
Компактный CO<sub>2</sub> инкубатор



**ES-20/80**  
Шейкер-инкубатор



**RTS-1 и RTS-1C**  
Персональные биореакторы

**S-Bt Smart Biotherm, Компактный CO<sub>2</sub> инкубатор** НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

S-Bt Smart Biotherm предназначен для работы в областях клеточной биологии (работа с культурами животных клеток и тканей), молекулярной биологии (анализ ДНК/РНК, реакции гибридизации), биотехнологий (синтез целевого белка и др. молекул), иммунологии (синтез антител и др. белков иммунной системы).

Прибор обеспечивает шестисторонний обогрев стенок камеры и двери, тем самым обеспечивая равномерное распределение температуры внутри инкубатора.

Встроенный высокоточный инфракрасный CO<sub>2</sub> –датчик позволяет измерять и контролировать уровень CO<sub>2</sub> и не чувствителен к изменению температуры и влажности внутри инкубатора.

Гладкая поверхность внутренней камеры, сделанной из нержавеющей стали, минимизирует контаминацию и облегчает очистку.

Прибор оснащен системой УФ–рециркуляции воздуха — 1 УФ–лампа и вентиляторы, установленные за задней стенкой инкубатора, обеспечивают деконтаминацию рабочего объема инкубатора.

В стенке прибора встроен удобный порт доступа для вывода проводов датчиков или приборов, установленных в инкубаторе. Порт подогревается, чтобы предотвратить образование конденсата.

Прибор оборудован системами выявления ошибок и оповещений, что существенно снижает возможные риски связанные с работой прибора.

Прибор оборудован системой «чёрного ящика», записывающего такие данные, как температура, влажность и уровень CO<sub>2</sub> во внутреннюю память.

Программное обеспечение подключения прибора к ПК по Bluetooth® поставляется с прибором.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал камеры	Нержавеющая сталь (1 мм)
Диапазон установки температуры	+25°C ... +60°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность температуры на 37°C	±0,3°C
Звуковой сигнал таймера	+
Рабочий объем камеры	46 литров
Количество полочек	3 (макс. 6)
Наличие внутренней стеклянной двери	
Относительная влажность	>90% на 37°C
Система увлажнения	Водяная ванна
Диапазон установки CO <sub>2</sub> *	0–20%
CO <sub>2</sub> сенсор	Инфракрасный сенсор
Установка температуры, уровня CO <sub>2</sub>	Цифровая
УФ лампы	1 × 6 Вт, TUV G6T5
Вывод данных	Беспроводной
Порт доступа	1 (Ø 26 мм)
Питание	230В, 50/60 Гц; 115 В, 50/60 Гц
Вес	37,7 кг
Размеры (Д×Ш×В)	500 × 560 × 550 мм
Размеры внутренней камеры (Д×Ш×В)	350 × 330 × 390 мм

\* — при выставленной температуре: от комн. до 50°C



Bluetooth®  
соединение

**Области применения:**

- Клеточная биология: работы с культурами животных клеток и тканей
- Молекулярная биология: анализ ДНК/РНК, реакция гибридизации
- Биотехнологии: синтез целевого белка и др. молекул
- Иммунология: синтез антител и др. белков иммунной системы

**Особенности:**

- Шестисторонний обогрев, обеспечивающий равномерное распределение температуры в камере
- Инфракрасный сенсор CO<sub>2</sub>, на который не влияют изменения температуры и влажности
- Система УФ рециркуляции для циклов деконтаминации
- Перенос данных на ПК с помощью Bluetooth®
- Система «чёрного ящика» с записью параметров
- Системы выявления ошибок и оповещений работы прибора
- Отдельно нагреваемый блокируемый порт доступа в камеру для проводов.

## S-Bt Smart Biotherm, Компактный CO<sub>2</sub> инкубатор

Простое присоединение баллона




Система УФ-рециркуляции воздуха внутри камеры




Фильтр очистки газа



Программное обеспечение для ПК

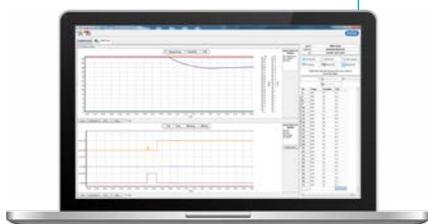

Приспособление для многоуровневой установки инкубаторов

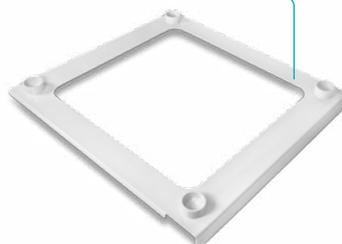

RS6, штатив с тремя полками

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

S-Bt Smart Biotherm с программным обеспечением + RS6, штатив с тремя полками

Кат. номер 

BS-010425-A01

S-Bt Smart Biotherm, с программным обеспечением + RS2, штатив для установки CPS-20

BS-010425-A10

### Дополнительные принадлежности:

CPS-20, CO<sub>2</sub> шейкер

BS-010172-A01

Полка

BS-010425-AK

USB Bluetooth® адаптер

BS-010425-FK

Приспособление для многоуровневой установки инкубаторов

BS-010425-CK

**CPS-20, CO<sub>2</sub> Шейкер** **НОВИНКА**

ОПИСАНИЕ

CO<sub>2</sub> шейкер **CPS-20** обеспечивает регулируемое орбитальное движение платформы и разработан специально для CO<sub>2</sub> инкубатора. **CPS-20** разработан для использования в агрессивной среде угольной кислоты, обеспечивая воспроизводимые результаты культивации клеток. Выбор из 5 взаимозаменяемых платформ позволяет осуществлять различные техники, используя разнообразную посуду для культивации.

В **CPS-20** используется бесщеточный мотор с гарантированным сроком службы до 35 000 часов. Прибор оборудован тройным эксцентриковым механизмом для движения платформы, который позволяет добиться превосходных характеристик по балансу, надежности и тихой работе. Специально разработанный модуль дистанционного управления позволяет предохранить электронику от неблагоприятного влияния агрессивной среды инкубатора, а также позволяет управлять шейкером не нарушая гомогенности среды внутри инкубатора в процессе эксперимента.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	50–250 об/мин (шаг 10 об/мин)
	максимальная скорость зависит от нагрузки и формы сосуда

Цифр. установка времени	1 мин–96 ч./ непрерывно
-------------------------	-------------------------

Цифровой контроль скорости	+
----------------------------	---

Макс. время непрерывной работы	168 ч
--------------------------------	-------

Орбита	20 мм
--------	-------

Максимальная нагрузка	3 кг
-----------------------	------

Размер (Д×Ш×В)	255 × 255 × 100 мм
----------------	--------------------

Вес	3.4 кг
-----	--------

Потребляемый ток/мощность	470 мА / 5.7 Вт
---------------------------	-----------------

Питание	вход AC 100–240 В; 50/60 Гц выход DC 12 В
---------	--



RS2, штатив для установки CPS-20



## Платформы для CPS-20

Платформа	Описание	Размер	Рабочие размеры	Кат. номер
<b>UP-12</b> 	Универсальная платформа с силиконовым коввриком	285 × 220 × 40 мм	270 × 185 × 40 мм	BS-010108-AK
<b>Bio PP-4</b> 	Платформа с силиконовым коввриком для чашек Петри и планшет	255 × 255 мм	230 × 230 мм	BS-010116-AK
<b>P-12/100</b> 	Платформа для колб 100–50 мл (12 мест)	250 × 190 мм	250 × 190 мм	BS-010108-EK
<b>P-6/250</b> 	Платформа для колб 250–300 мл (6 мест)	250 × 190 мм	250 × 190 мм	BS-010108-DK
<b>P-16/88</b> 	Платформа с универсальными пружинными держателями для 88 пробирок, диаметром до 30 мм	275 × 205 × 75 мм	275 × 205 × 75 мм	BS-010116-BK

S-Bt Smart Biotherm, компактный CO<sub>2</sub> инкубатор

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CPS-20, CO<sub>2</sub> Шейкер

RS2, штатив для установки CPS-20

Кат. номер 

BS-010172-A01

BS-010425-НК

## RTS-1 и RTS-1C, Персональные биореакторы



Инновационная технология перемешивания: **Reverse - Spin**



USB соединение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	RTS-1	RTS-1C
Теоретически возможный диапазон измерений (ОП <sub>850</sub> ), при 10 мл рабочего объёма*: Стержевидные бактерии (пр. <i>E.coli</i> ) Дрожжи (пр. <i>P.pastoris</i> )	0–25 (0–45.6 ОП <sub>600</sub> эквивалент**) 0–50 (0–75 ОП <sub>600</sub> эквивалент)	
<i>E.coli</i> BL21 диапазон измерения заводской калибровки, ОП <sub>850</sub> : при объёме 10–20 мл при объёме 20–30 мл	0–10 ОП (0–19 ОП <sub>600</sub> эквивалент) 0–8 ОП (0–15.2 ОП <sub>600</sub> эквивалент)	
Точность измерения при заводской калибровке	±0.3 ОП <sub>850</sub>	
Коэффициент массопередачи k <sub>a</sub> (h <sup>-1</sup> )	до 350 ±26 h <sup>-1</sup> при 5 мл	
Длина волны для измерений (λ)	850 ±15 нм	
Источник света	Светодиод	
Измерение в реальном времени (мин)	1–60	
Диапазон установки температуры	+25°C ... +70°C (шаг 0.1°C)	+4°C ... +70°C (шаг 0.1°C)
Нижний уровень контроля температуры	5°C выше комн.	15°C ниже комн.
Верхний уровень контроля температуры	70°C	
Стабильность температуры	±0.1°C	
Точность температуры образца: 20°C – 45°C < 20°C > 45°C	± 1 ± 2 ± 3	
Скорость нагрева/охлаждения образца	0.7°C/мин	
Объём образца	10–30 мл	
Диапазон регулировки скорости	50–2000 об/мин (шаг 10 об/мин)	
Точность регулировки скорости	±15 об/мин	
Время реверсивного перемешивания	1–60 с (шаг 1 с)	
Дисплей	ЖК	
Минимальные требования к ПК	Intel/AMD Процессор, ОП (RAM) 1 Гб, Windows Vista/7/8/8.1/10, 2.0 USB порт	
Системные требования	Intel/AMD Процессор, ОП (RAM) 3 Гб, Windows 7/8/8.1/10, 2.0 USB порт	
Размеры (Д × Ш × В)	130 × 212 × 200 мм	
Вес	1.7 кг	2.2 кг
Потребляемый ток/мощность	12 В DC, 3.3 А / 40 Вт	12 В DC, 5 А / 60 Вт
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В	

\* — Максимальный k<sub>a</sub> (h<sup>-1</sup>) достигается при рабочем объеме 5 мл, который является оптимальным для аэробного культивирования

\*\* — Коэффициенты конверсии от ОП850 до ОП600 варьируются между штаммами и фазами роста



## RTS-1 и RTS-1C, Персональные биореакторы

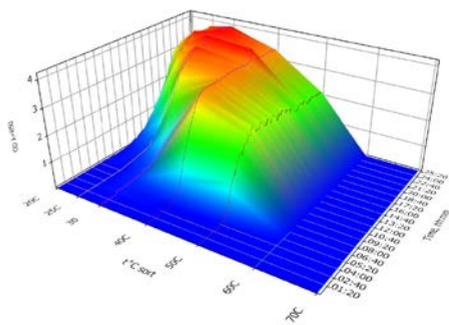


Рис. 1. 3D график кинетики роста *E.coli* BL21 показывающий эффект разных температур проведённых на 7 RTS биореакторах одновременно

## Возможности программного обеспечения:

- Регистрация кинетики роста клеток в реальном времени
- Пользовательские графики и 3D-график
- Пауза
- Сохранить/загрузить результаты
- PDF- и Excel- отчеты
- Подключение до 10 приборов одновременно
- Возможность удаленного слежения за экспериментом
- Возможность задачи циклов/профилеирования
- Возможность создания собственной калибровки под любой вид микроорганизмов

**RTS-1 и RTS-1C** являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением направления вращения, что приводит к высокоэффективному перемешиванию и оксигенации для аэробного культивирования. В сочетании с ближней ИК оптической системой можно регистрировать кинетику роста клеток неинвазивно в реальном времени.

- Принцип смешивания Reverse-Spin® в 50-миллилитровых фальконах-биореакторах, позволяет достичь высоких значений  $k_a$  ( $h^{-1}$ ) до 450, что необходимо для эффективного аэробного культивирования
- Индивидуально контролируемый биореактор ускоряет процесс оптимизации
- Возможность культивировать микроаэрофильные и облигатно анаэробные микроорганизмы (не строгие анаэробные условия)
- Принцип смешивания Reverse-Spin® позволяет проводить неинвазивное измерение биомассы в режиме реального времени
- Оптическая система в ближней инфракрасной области позволяет регистрировать кинетику роста клеток
- Бесплатное программное обеспечение для хранения, демонстрации и анализа данных в режиме реального времени
- Компактный дизайн с низким профилем и небольшим размером для личного применения
- Контроль температуры для биопроцесса
- Активное охлаждение для быстрого регулирования температуры, например для экспериментов с флуктуациями температуры
- Профилеирование задач для автоматизации процессов
- Хранение облачных данных для удаленного мониторинга процесса культивирования дома или с помощью мобильного телефона

## Аппликации:

- Выращивание бактерий с контролем кинетики роста в реальном режиме времени
- Скрининг штаммов
- Эксперименты с температурным стрессом
- Скрининг сред и их оптимизация
- Синтетическая и системная биология
- Тесты на токсичность
- Контроль качества штаммов

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер

RTS-1C с TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®, 20 шт.

BS-010160-A04

RTS-1 с TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®, 20 шт.

BS-010158-A04

## Дополнительные принадлежности для RTS-1 и RTS-1C:

TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®, 20 штук

BS-010158-AK

TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®, 180 штук

BS-010158-CK

USB 2.0 хаб 10 портов

BS-010158-BK

## RTS-1 и RTS-1C, Персональные биореакторы

### Рекомендации, которым следует пользоваться при создании персональных установок для культивирования микроорганизмов:

1. Скорость роста напрямую зависит от скорости вращения пробирки, поскольку она прямо пропорционально связана (в диапазоне от 1500 до 2500 об/мин) со скоростью насыщения среды кислородом.
2. Естественно, что при аэробном метаболизме изменение ОП от времени также будет пропорционально расти в зависимости от скорости вращения пробирки.
3. Это будет также сказываться на удельной скорости роста  $\Delta\text{ОП}/\Delta t$
4. А также Времени выхода кривой роста на стационарную фазу роста при аэробной ферментации (чем скорость вращения пробирки выше — тем скорость выхода культуры на стационарную фазу быстрее)

5. Насыщение среды кислородом будет зависеть от частоты переключения вращения пробирки на противоположное (RST) Время (hh:mm) (чем чаще переключение направления вращения пробирки на противоположное — тем массообмен кислорода выше)
6. ОП  $\lambda=850$  — эта длина волны измерения концентрации клеток микроорганизмов выбрана потому, что питательные среды а также клетки микроорганизмов имеют цветность и это надо учитывать при контроле специфической динамики роста микроорганизмов. Для того, что бы уйти в «теневую» область (не зависящую от цвета среды и цвета м. о. мы предлагаем ближний инфракрасный (не видимый для человеческого глаза) диапазон измерения светорассеяния — 850 нм. Поскольку при этом мы еще находимся в чувствительном диапазоне длины волны и в тоже время независимы от естественных раскрасок колоний м. о. разработанных микробиологами и связанных с ограниченностью чувствительности нашего зрения (от 400 до 700 нм). Коэффициент пересчёта  $\text{ОП}_{850}/\text{ОП}_{600}$  около 2.

### Рост клеток в зависимости от интенсивности ротации

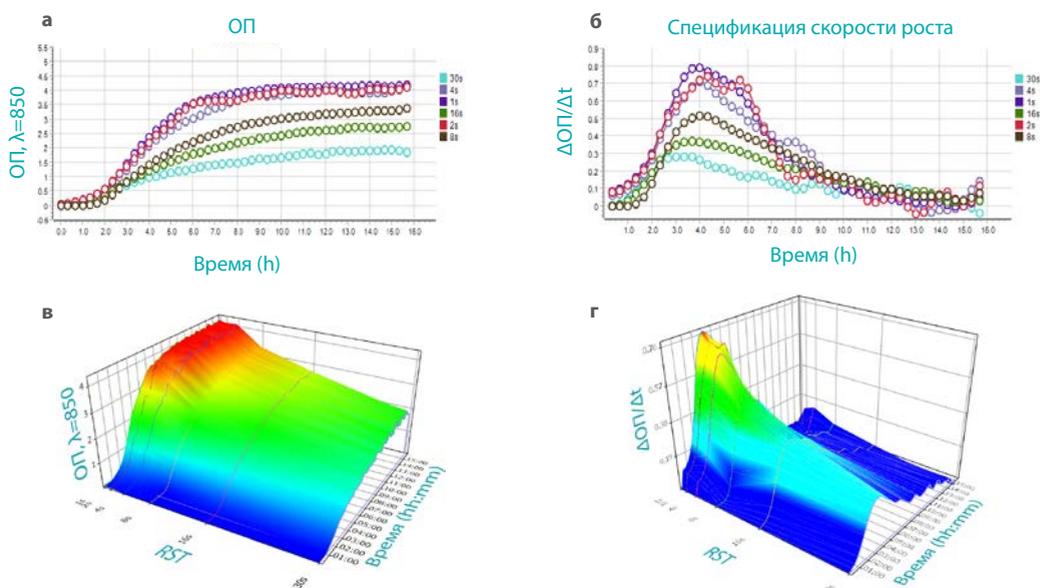


Рис. 2, а-в. Влияние интервала между реверсивными вращениями пробирки (RST) на кинетику роста *E. coli* BL21 (а-в) рост биомассы клеток; (б-г) специфическая скорость роста клеток; культивирование проводили в 50 мл TPP Bioreactor tubes, объём среды 30%, обороты вращения пробирки 2000 об/мин; время между сменой вращения пробирки (RST) на противоположное составляло 1, 2, 4, 8, 16, 30 секунд; среда культивирования LB; температура культивирования 37 °С. Для того, чтобы перевести ОП<sub>850</sub> на ОП<sub>600</sub> помножьте ОП<sub>850</sub> в 1.9 раза.

Известно, что аэробный рост бактерии *E. coli* зависит от интенсивности аэрации. Чем она выше, тем скорость роста клеток выше. Рис. 2 а-в служит в качестве иллюстрации оптимизации роста клеток бактерии и показывает связь между частотой смены направления вращения пробирки RST (сек.) и газообменом. Вывод: при снижении времени RST специфическая

скорость роста возрастает и вместе с ним увеличивается выход биомассы клеток. Таким образом, наиболее высокий уровень аэрации с учетом оптимальных условий для роста *E. coli* BL21 были установлены для режима скорости вращения пробирки 2000 об/мин показатель частоты смены вращения пробирки (RST) составил 1 раз в секунду.

## RTS-1 и RTS-1C, Персональные биореакторы

$k_{La}$  (h<sup>-1</sup>) значение в RTS-1/C



Рис. 3. Влияние различных объемов среды на скорость ее насыщения кислородом в 50 мл TPP Биореакторе при интенсивном реверсивном вращении на RST-1C. Заполнение осуществляли де-ионизированной водой объемом 5, 10, 20 и 30 мл и измерения осуществляли не инвазивным O<sub>2</sub> датчиком и оптикой (PreSens, Германия) при 37 °C используя метод полного вытеснения растворенного кислорода-азотом. На Рис. 3 представлены средние значения как минимум 5 экспериментов а также их среднеквадратичные отклонения.

Значение  $k_{La}$  исследовали для оптимальных для аэробной ферментации варьируемых значений интенсивности аэрации, составляющих 2000 об/мин и частоте смены направления вращения составляющей 1 раз в секунду. Во всем исследованном диапазоне рабочих объемов среды показана линейная и обратно пропорциональная зависимость значения  $k_{La}$  от объема среды (см. Рис. 3). Наиболее высокий показатель O<sub>2</sub>  $k_{La}$  350 мг/л/ч был показан для 10% объема среды (5 мл среды в 50 мл реакторе).

Список клеток микроорганизмов и клеточных культур успешно культивированных на биореакторе RTS-1C

*Saccharomyces cerevisiae*, *Pichia pastoris*, *Yarrowia lipolytica*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Hybridoma*, *Jurkat* and CHO cells.

Типы пробирок рекомендуемые для реверс-спин технологии

Для аэробных ферментаций мы рекомендуем использовать пробирки поставляемые TPP — TubeSpin® Bioreactor 50 мл (TPP, Швейцария). Для обеспечения оптимальных условий культивирования аэротолерантных микроорганизмов – анаэробов, рекомендуем те же реакторы, однако закручиваемая крышка не должна иметь мембранные дыхательные фильтры. Допустимо также использование аналогичных пробирок других производителей, например Corning 50 мл Mini Bioreactor (США), но в этом случае ротор RTS необходимо модифицировать. Такая опция осуществляется по запросу.

Заводская калибровка полипропиленовыми частицами заданного размера и коэффициент пересчета

600 нм / 850 нм

Заводская калибровка прибора разработана для полочковидных бактерий близких по размерам *E.coli* BL21. Если объект ваших исследований превышает эти размеры, система измерений может работать не корректно. Коэффициент конверсии ОП<sub>850</sub> в ОП<sub>600</sub> при заводских настройках составляет 1.9.

Заводская калибровка и влияние фазы роста микроорганизмов на точность измерения

В процессе культивирования клеток *E.coli*, клетки проходят различные фазы роста вызывающие физиологические и морфологические изменения, включая снижение объемных размеров и формы клеток. По этому, независимые референтные значения ОП полученные на клетках, образцы которых отобраны на различных участках фаз роста могут отличаться от спецификации калибровки производителя.

Какой коэффициент конверсии ОП<sub>850</sub> к ОП<sub>600</sub> рекомендуем

Коэффициент конверсии оптической плотности ОП<sub>850</sub> к ОП<sub>600</sub> зависит от линейных размеров и объема. Поэтому коэффициент будет различаться для других размеров клеток. Прибор может быть калиброван на требуемой длине с учетом дальнейшего перевода пользователем на оптическую плотность 600 нм.

## RTS-8 и RTS-8 Plus, Многоканальные биореакторы НОВИНКА

**RTS-8 и RTS-8 plus** являются многоканальными персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением пробирки вокруг своей оси с изменением направления вращения, что приводит к высокоэффективному перемешиванию и оксигенации необходимых аэробным культурам клеток. В сочетании с системой измерения в ближнем инфракрасном диапазоне можно регистрировать кинетику роста клеток и дополнительно на **RTS-8 plus**, флуоресцентной и люминесцентной системой измерения можно регистрировать кинетику роста рН и O<sub>2</sub> неинвазивно в режиме реального времени. Для измерения рН и O<sub>2</sub> внутри пробирок используются инновационные одноразовые датчики.

Хотя подача O<sub>2</sub> является одной из основных проблем при выращивании аэробных организмов, особенно в условиях ограниченного кислорода, отсутствовали адекватные методы мониторинга растворенного кислорода в реальном времени, и обычно предполагалось наличие достаточного количества O<sub>2</sub>. Инновационные неинвазивные кислородные датчики, встроенные в пробирки типа Falcon, теперь позволяют осуществлять онлайн-мониторинг кислорода и дают новое представление о метаболической активности.

рН — одна из основных проблем при выращивании клеток, дрожжей или бактерий. Сосуды для выращивания, ограниченные сенсором, широко применяются в академических и промышленных разработках биопроцессов. Поскольку адекватные методы для реального мониторинга рН не были доступны, использовался громоздкий отбор проб на линии, с низкой плотностью данных и с вмешательством в процесс роста. Неинвазивное измерение рН в реальном времени позволяет по-новому взглянуть на метаболическую активность и изменения в метаболических процессах.

### ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Регистрация кинетики роста клеток в реальном времени;
- Пользовательские графики и 3D-график;
- Пауза;
- Сохранить/загрузить результаты;
- PDF- и Excel- отчеты;
- Возможность удаленного слежения за экспериментом;
- Возможность задачи циклов/профилеирования;
- Возможность создания собственной калибровки под любой вид микроорганизмов;



**только для RTS-8 Plus**

- Измерение и регистрация рН и O<sub>2</sub> в реальном времени.

Пробирки с датчиками для RTS-8 Plus



### Smart Plus Product Class



Инновационная технология перемешивания: **Reverse - Spin®**

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Параллельное культивирование в восьми 50-миллилитровых фальконах-биореакторах позволяет сэкономить время и ресурсы для оптимизации биопроцесса;
- Индивидуально контролируемый биореактор ускоряет процесс оптимизации;
- Возможность культивировать микроаэрофильные и облигатно анаэробные микроорганизмы (не строгие анаэробные условия);
- Принцип перемешивания Reverse-Spin® позволяет проводить неинвазивное измерение биомассы в режиме реального времени;
- Оптическая система с источником света (ближний ИК) позволяет регистрировать кинетику роста клеток;
- Бесплатное программное обеспечение для хранения, демонстрации и анализа данных в режиме реального времени;
- Компактный дизайн с низким профилем и небольшим размером для личного применения;
- Индивидуальный контроль температуры;
- Активное охлаждение для быстрого регулирования температуры, например для экспериментов с флуктуациями температуры;
- Профилеирование задач для автоматизации процессов
- Облачное хранение данных для удаленного мониторинга процесса выращивания, находясь дома или с помощью мобильного телефона;



**только для RTS-8 Plus**

- Неинвазивное измерение O<sub>2</sub> и рН позволяет проводить точный мониторинг метаболической активности.

### Преимущества датчиков:

- Они маленькие;
- Их сигнал не зависит от скорости потока образца;
- Их можно физически отделить от измерительной системы, это позволяет проводить неинвазивные измерения;
- Они могут быть использованы в одноразовых пробирках;
- Поэтому они идеально подходят для исследования небольших объемов образцов, для высокопараллельных измерений в одноразовых пробирках и для биотехнологических применений.

**НОВИНКА RTS-8 и RTS-8 Plus, Многоканальные биореакторы**

USB  
соединение

**АППЛИКАЦИИ**

- Кинетика роста ферментации в реальном времени
- Скрининг штаммов
- Экспрессия белка
- Эксперименты с температурным стрессом
- Скрининг сред и их оптимизация
- Характеристика роста
- Тесты на ингибирование и токсичность
- Контроль качества штаммов
- Первоначальные исследования по оптимизации биологических процессов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	RTS-8	RTS-8 Plus
Источник света		лазер
Длина волны измерения (λ)		850 ±15 нм
Диапазон измерения		0–100 ОП <sub>600</sub>
<i>E. coli</i> диапазон измерения заводской калибровки		0–50 ОП <sub>600</sub>
<i>S. cerevisiae</i> диапазон измерения заводской калибровки		0–75 ОП <sub>600</sub>
Достижимая ошибка измерения калибровки пользователя (диапазон 0.1–6 ОП <sub>600</sub> )		±0.3
Достижимая ошибка измерения калибровки пользователя (диапазон 6–50 ОП <sub>600</sub> )		≤5%
Достижимая ошибка измерения калибровки пользователя (диапазон 50–75 ОП <sub>600</sub> )		≤10%
Периодичность измерения в час		1–60 (шаг 1 мин)
Диапазон установки температуры		+15°C ... +60°C
Диапазон регуляции температуры		+15°C ниже комн. ... +60°C (шаг 0.1°C)
Стабильность температуры		±0.3°C
Точность температуры образца (20–37°C)		±1°C
Количество измерительных каналов для пробирок		8
Диапазон рабочего объема образца		3–50 мл
Диапазон регулирования скорости		150–2700 об/мин (шаг 1 об/мин)
Дисплей		ЖК
Размеры (Д×Ш×В)		350 × 690 × 300 мм
Вес		20 кг
Питание		АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность		3.15 А / 500 Вт
O <sub>2</sub> датчик* / pH датчик**	— / —	+ / +

**\*O<sub>2</sub> датчик**

Диапазон	0–100%
Точность	±0.05% O <sub>2</sub> при 0.2%, ±0.4% O <sub>2</sub> при 20.9%
Дрейф	<0.03% O <sub>2</sub> в течение 30 дней
Диапазон температур	до 40°C
Время отклика (t <sub>90</sub> )	<6 с
Стабильность при хранении	18 месяцев

**\*\*pH датчик**

Диапазон	4.0–8.5 pH
Точность	±0.10 pH при pH 7
Дрейф	<0.005 pH в день
Диапазон температур	до 40°C
Время отклика (t <sub>90</sub> )	<120 с
Стабильность при хранении	18 месяцев

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Кат. номер



RTS-8 с пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor 50 мл, 20 шт.

BS-010168-A01

RTS-8 Plus с пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor 50 мл, 20 шт.

BS-010170-A01

и стерильными пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor, 50 мл, с датчиками pH и O<sub>2</sub>, 10 шт.**Дополнительные принадлежности:**

TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®, 20 шт.

BS-010158-AK

TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®, 180 шт.

BS-010158-CK

USB 2.0 хаб 10 портов

BS-010158-BK

Стерильные пробирки TPP TubeSpin® Bioreactor, 50 мл, с датчиками pH и O<sub>2</sub>

200001368

## ES-20/60, Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор **ES-20/60** для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых. Шейкер-инкубатор предусмотрен для выращивания термофильных бактерий.

Шейкер-инкубатор имеет прямоприводной механизм вращения платформы, надежен и стабилен при длительных процессах выращивания клеточных культур.

Шейкер-инкубатор **ES-20/60** обеспечивает плавное (или интенсивное) перемешивание в колбах, установленных на платформе. Высокоточное распределение температуры по всему объему камеры шейкера инкубатора (от комнатной температуры до +80 °C) достигается за счет встроенного бесшумного термостойкого бесщеточного вентилятора. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. Современный тип двигателя, использование новейших теплоизоляционных материалов, микропроцессорное обеспечение мягкого старта движения платформы и современная регуляция термостатирования снижают потребление энергии и делают шейкер-инкубатор, несмотря на его относительно большие размеры, высокоэкономичным.

**НОВИНКА**

## ES-20/80, Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор **ES-20/80** для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Стандартное применение – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, а также другие виды применения в области биологии и химии.

Устройство имеет новый трехэксцентриковый механизм вращения платформы, обеспечивающий характеристики отличного балансирования, надежность и тихую работу даже при максимальных оборотах (до 400 об/мин). Стабильность устройства во время интенсивного перемешивания позволяет устанавливать до 3-х устройств друг на друга, помогая сэкономить рабочее пространство. Новый дисплей и простой пользовательский интерфейс обеспечивают четкий и интуитивный контроль параметров и позволяют архивировать, хранить данные и отображать их в динамике. Благодаря таким дополнительным функциям, как датчик дисбаланса и автоматическое выявление отказа термостата, шейкер-инкубатор становится современным и безопасным изделием. Подключение к компьютеру, используя технологию Bluetooth®, позволяет осуществлять управление данными, архивирование, контроль параметров и профилирование в специальном программном блоке.

Высокоточное распределение температуры по всему объему камеры шейкера-инкубатора (от 5°C выше комнатной температуры до +80°C) достигается за счет встроенного бесшумного термостойкого бесщеточного вентилятора. К тому же, при температуре 37°C можно добиться отличной равномерности температуры образца в пределах  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ . Внутренняя камера сделана из нержавеющей стали. Современный тип двигателя, использование новейших теплоизоляционных материалов, микропроцессорное обеспечение мягкого старта движения платформы и современная регуляция термостатирования снижают потребление энергии и делают шейкер-инкубатор высокоэкономичным, несмотря на его относительно большие размеры.

**Premium**  
Product Class

Ø 20 мм  
орбита



### Время нагрева ES-20/60

от 25°C + 90 мин до 80°C



Прибор ES-20/60 зарегистрирован  
Министерством здравоохранения РФ

**Smart Plus**  
Product Class

Ø 20 мм  
орбита



Bluetooth®  
соединение



50–400 об/мин

### Время нагрева ES-20/80

от 25°C + 75 мин до 80°C

## ES-20/60 и ES-20/80, Шейкеры-инкубаторы

	ES-20/60	ES-20/80
Диапазон установки температуры	+25°C... +80°C	
Диапазон установки скорости	50–250 об/мин	50–400 об/мин
Диапазон регулирования температуры	10°C выше комн. ... +80°C	5°C выше комн. ... +80°C
Шаг установки	0,1°C; 10 об/мин	0,1°C; 10 об/мин
Стабильность температуры	±0,5 °C	±0,1 °C при 37 °C
Точность температуры	±0,5 °C	±0,1 °C при 37 °C
Равномерность температуры	±0,5 °C	±0,3 °C при 37 °C
Орбита	20 мм	
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков	TFT, 5 дюймов
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч. / непрерывно (шаг 1 мин.)	
Максимальная нагрузка	8 кг	10,6 кг
Вывод данных	—	Bluetooth®
Многоуровневая установка	—	до 3*
Размеры (Д×Ш×В)	590 × 525 × 510 мм	620 × 530 × 510 мм
Размеры внутренней камеры (Д×Ш×В)	460 × 400 × 310 мм	
Вес	41,1 кг	48 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	450 Вт (2 А)/450 Вт (4.5 А)	500 Вт (2.2 А)
Программное обеспечение	—	+

\* — Необходим дополнительный набор для штабелирования

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. номер



ES-20/60 без платформы

BS-010135-AAA

ES-20/80 с программным обеспечением, без платформы

BS-010167-A05

## Дополнительные принадлежности:

USB Bluetooth® адаптер

BS-010425-FK

Набор для штабелирования 2× ES-20/80

BS-010167-OK

Набор для штабелирования 3× ES-20/80

BS-010167-PK

Кат. номера платформ для ES-20/60 находятся на странице 23

Кат. номера платформ для ES-20/80 находятся на странице 126



Описание всех платформ  
для ES-20/60 см. на стр. 23


Описание всех платформ  
для ES-20/80 см. на стр. 126

## Платформы для ES-20/80

Платформа	Описание	Размер (Рабочий размер)	Кат.номер
<b>HSP-30/100</b> 	Платформа с обжимающими клипсами для колб 100-150 мл (30 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010167-KK
<b>HSP-16/250</b> 	Платформа с обжимающими клипсами для колб 250-300 мл (16 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010167-MK
<b>HSP-9/500</b> 	Платформа с обжимающими клипсами для колб 500 мл (9 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010167-NK
<b>HSP-6/1000</b> 	Платформа с обжимающими клипсами для колб 1000 мл (6 мест)	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010167-LK
<b>PP-400</b> 	Платформа с несскользящим силиконовым покрытием	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-FK
<b>UP-168</b> 	Универсальная платформа для различных колб	360 × 400 мм (360 × 400 мм)	BS-010135-JK
+			
<b>HSC-50</b> <b>HSC-100</b> <b>HSC-250</b> <b>HSC-500</b> <b>HSC-1000</b> 	Обжимающие клипсы для колб 50, 100, 250, 500, 1000 мл (для UP-168)	Ø 50 мм Ø 65 мм Ø 85 мм Ø 105 мм Ø 130 мм	BS-010167-DK BS-010167-EK BS-010167-FK BS-010167-JK BS-010167-IK
+			
<b>SPML</b> 	Набор из трёх двусторонних клейких ковриков в качестве альтернативы обычным держателям колб (для UP-168)	390 × 80 × 3 мм	BS-010135-MK
+			
<b>TR-21/50</b> 	Штатив для 50 мл пробирок с 21 отверстием (для UP-168)	340 × 124 мм (2 на платформу)	BS-010135-KK
+			
<b>TR-44/15</b> 	Штатив для 15 мл пробирок с 44 отверстиями (для UP-168)	340 × 124 мм (2 на платформу)	BS-010135-LK

Basic Plus  
Product Class

Ø 10 мм  
орбита

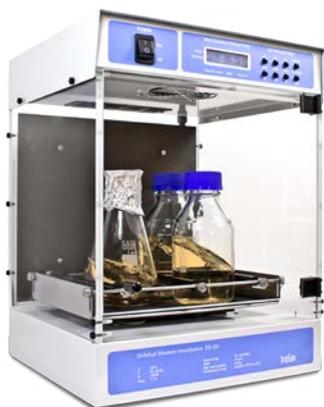

#### Время нагрева ES-20:

от 25 °C — 16 мин — до 42 °C



## ES-20, Шейкер-инкубатор

**ES-20** — настольный компактный шейкер-инкубатор. Предназначен для культивирования клеток по заданной оператором программе.

Встроенный микропроцессорный термоконтроллер обеспечивает постоянный температурный контроль в камере инкубатора и позволяет устанавливать и поддерживать температуру внутри инкубатора (5°C выше комнатной). Принудительная циркуляция нагретого воздуха внутри прозрачной плексигласовой камеры гарантирует равномерное распределение температуры в рабочем объеме инкубатора. Разборная конструкция дает возможность транспортировать прибор.

Процесс перемешивания контролируется цифровым тахометром и цифровым таймером. Система прямого привода вращения платформы обеспечивает надежную, стабильную работу (до 30 суток непрерывного перемешивания).

Дисплей показывает установленные и текущие значения температуры, скорости и времени работы.

Шейкер-инкубатор можно использовать в биотехнологических и биомедицинских лабораториях.

#### Съемные платформы позволяют использовать ES-20 для:

- Выращивания культур клеток в колбах и других лабораторных сосудах
- Экстракции образцов тканей в условиях физиологических температур
- При других процессах пробоподготовки

Диапазон установки температуры	+25 °C ... +42 °C
Диапазон установки скорости	50–250 об/мин
Диапазон регулирования темп.	5°C выше комн. ... +42 °C
Шаг установки	0,1 °C; 10 об/мин
Стабильность температуры	± 0,5 °C
Точность температуры	± 0,5 °C
Равномерность температуры	± 0,5 °C
Орбита	10 мм
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч. / непрерывно (шаг 1 мин.)
Звуковой сигнал таймера	+
Толщина стенок из плексигласа	7 мм
Максимальная нагрузка	2,5 кг
Размеры (Д×Ш×В)	340 × 340 × 435 мм
Размеры внутренней камеры	305 × 260 × 250 мм
Вес	13,2 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (230/120 В)	160 Вт (0,7 А) / 170 Вт (1,6 А)

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: Кат. номер

**ES-20** без платформы BS-010111-AAА

#### Дополнительные принадлежности:

Платформы: **UP-12** BS-010108-AK  
**PP-4** BS-010108-BK  
**P-12/100** BS-010108-EK  
**P-6/250** BS-010108-DK  
**P-16/88** BS-010116-BK

Описание всех платформ для ES-20 см. на стр. 22



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА:  
**ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК/РНК,  
ИММУНОДИАГНОСТИКА**



**3D-IW8 Inteliwasher**  
Промыватель планшетов  
автоматический



**PST-60HL**  
Термошейкер для планшетов



**HiPo MPP-96**  
Фотометр для микропланшетов

## ○ Автоматическая экстракция ДНК/РНК

Дозаторы жидкостей

Серия пипеток Assist



Инкубация

TS-100



TS-100C



Центрифугирование  
и сброс капель

FVL-2400N



Автоматическое  
выделение

BioMagPure 12 Plus  
и реагенты



## Ручная экстракция ДНК/РНК на магнитных частицах

Центрифугирование  
и сброс капель

FVL-2400N



Пробоподготовка  
в УФ-боксе для ПЦР

UVC/T-M-AR, или похожее,  
см. УФ-боксы для ПЦР



Перемешивание  
и ресуспендирование

MPS-1



V-1 plus



Multi Bio RS-24



Осаждение  
магнитных частиц

MagSorb-16



Центрифугирование

Microspin 12



Вакуумная  
аспирация

FTA-1



FTA-2i



Инкубация

TDB-120



TS-100C



Реагенты

Реагенты для выделения \*



## BioMagPure 12 Plus, Компактная настольная роботизированная система для автоматического выделения нуклеиновых кислот

ОПИСАНИЕ

Прибор **BioMagPure 12 Plus** представляет собой компактную настольную роботизированную систему для автоматического выделения нуклеиновых кислот. Использование готовых картриджей с реагентами и одноразовых материалов обеспечивает полностью автоматизированное и высококачественное выделение нуклеиновых кислот. Хорошо зарекомендовавшая себя технология на основе магнитных частиц, делает процесс очистки удобным, надежным и рентабельным.

Особый дизайн реакционных ёмкостей (полигональная конструкция с запатентованными решениями), входящих в состав наборов, обеспечивает высокую эффективность лизиса и элюции, а также минимизирует остатки магнитных частиц и спирта в конечных образцах. Запатентованная технология позволяет перемешивать образец перед переносом, что минимизирует возникновение проблем с дозированием вследствие засорения наконечников. Полигональная конструкция реакционной ёмкости обеспечивает более плотное прилегание магнита и нагревающей пластины, что, в свою очередь, позволяет существенно повысить сбор магнитных частиц. В набор реагентов входит всё необходимое для проведения процесса выделения. Наличие отдельных насадок для пробивания защитного покрытия картриджа обеспечивает максимальную защиту от кросс-контаминации.

Приборы **BioMagPure 12 Plus** можно использовать для выделения от 1 до 12 образцов одновременно, благодаря этому свойству прибор хорошо подходит для применения в небольших клиниках и лабораториях. Приборы этой серии занимают мало места на рабочей поверхности и экономят рабочее время работников лабораторий, что позволяет организациям вести работы экономически эффективно.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Время выделения	45–60 минут
Количество образцов	1–12 образцов за один цикл работы
Метод выделения	при помощи магнитных частиц
Протоколы	программируются путем сканирования штрих-кода
Объем образца	10–2000 мкл (В зависимости от набора)
Объем элюата	50–400 мкл
Подключение к ПК	не требуется
Дисплей	ЖК (20 × 4)
Сертификаты	CE IVD
Электропитание	AC 110–240 В, 50/60 Гц
Размеры (Д×Ш×В)	560 × 590 × 510 мм
Вес	55 кг

НОВИНКА



### 3 лёгких шага

#### 1 ЗАГРУЗКА



#### 2 ЗАПУСК



#### 3 ЭКСТРАГИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ



### Особенности:

- Современная технология с использованием магнитных частиц
- Реакционная камера с запатентованными решениями
- Полная автоматизация (система Walk-away)
- Наличие специальных, отдельных насадок для вскрытия картриджа с реагентами
- Надежное качество
- Подключение к ПК не требуется
- Готовые к использованию картриджи с реагентами
- 3 простых шага: ЗАГРУЗИТЬ, ЗАПУСТИТЬ, ПОЛУЧИТЬ

## Реагенты для BioMagPure 12 Plus

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:



Название	Описание	Кат. номер
BioMagPure 12 Plus	Компактная настольная роботизированная система для автоматического выделения нуклеиновых кислот	BS-060202-AAA
Набор для выделения ДНК из крови 200	Набор реагентов 200 для выделения ДНК из 10 - 400 мкл цельной крови млекопитающих, суспензии клеток крови млекопитающих.	BS-060201-AK
Набор для выделения ДНК из крови 1200	Набор реагентов 1200 для выделения ДНК из 400-1000 мкл цельной крови и суспензии клеток крови млекопитающих.	BS-060201-BK
Набор для выделения вирусных нуклеиновых кислот	Набор реагентов для выделения вирусных нуклеиновых кислот из биологических жидкостей человека, таких как сыворотка, плазма и другие бесклеточные жидкости.	BS-060201-CK
Набор для выделения геномной ДНК из тканей	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных, мазков и засохшей крови.	BS-060201-DK
Набор для выделения геномной ДНК из клеточных культур	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из клеточных культур и лейкоцитарных пленок.	BS-060201-EK
Набор для выделения геномной ДНК из бактерий	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из грамположительных и грамотрицательных бактерий.	BS-060201-FK
Набор для выделения ДНК ВПЧ из мазков	Набор реагентов для выделения ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) из клеток цервикального канала, собранных цервикальным ершиком или ватной палочкой в жидкую среду	BS-060201-GK
Набор для выделения ДНК ТБ	Набор реагентов для выделения геномной ДНК <i>Micobacteria spp.</i> (например, <i>Mycobacterium tuberculosis</i> ) из бактериальных образцов любого типа	BS-060201-IK
Набор для выделения геномной ДНК из тканей	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из образцов тканей, зафиксированных в формалине и залитых парафином.	BS-060201-JK
Набор для выделения ДНК для судмедэкспертизы	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из образцов для судебно-медицинской экспертизы.	BS-060201-KK
Набор (тип А) для выделения вирусных и бактериальных ДНК/РНК	Набор реагентов тип А для выделения вирусных и бактериальных ДНК/РНК из бесклеточных образцов, таких как сыворотка, плазма и другие бесклеточные биологические жидкости.	BS-060201-LK
Набор (тип Б) для выделения вирусных и бактериальных ДНК/РНК	Набор реагентов тип В для выделения вирусных и бактериальных ДНК/РНК из мазковых проб (образцы богатые клетками).	BS-060201-MK
Набор для выделения вирусной РНК	Набор реагентов для выделения вирусной РНК из биологических жидкостей человека, таких как сыворотка, плазма и другие бесклеточные биологические жидкости.	BS-060201-NK
Набор для выделения геномной ДНК из тканей растений	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей растений (листьев, семян и спор) и тканей грибов. Объем образца — до 100 мг.	BS-060201-OK
Набор для выделения общей РНК	Набор реагентов для выделения общей РНК из цельной крови, кровяных клеток, тканей животных и растений, дрожжей и культур клеток.	BS-060201-PK
Набор для выделения вирусных нуклеиновых кислот из больших объемов	Набор реагентов для выделения вирусных нуклеиновых кислот из больших объемов биологических жидкостей человека, таких как сыворотка, плазма и другие бесклеточные жидкости.	BS-060201-QK
Набор для выделения СFC ДНК (большой объем)	Набор реагентов для выделения свободно циркулирующей ДНК (СFC) из больших объемов плазмы, сыворотки или других бесклеточных жидкостей организма. Объем образца — до 5 мл.	BS-060201-RK

## MagSorb-16, Магнитный штатив для ручного выделение нуклеиновых кислот

ОПИСАНИЕ

**MagSorb-16** — это магнитный штатив предназначенный для выделения нуклеиновых кислот на магнитных частицах. В штатив встроены высокоэффективные постоянные неодимовые магниты.

**MagSorb-16**, состоит из двух удобных быстросъемных держателей пробирок, которые вмещают до 16 пробирок (1,5-2 мл) и магнитного штатива на который ставятся держатели пробирок.

Методы экстракции нуклеиновых кислот на основе магнитных частиц предлагают быстрое и эффективное отделение генетического материала от клеточных остатков. Широкий выбор имеющихся в продаже наборов для экстракции, производимых такими компаниями, как ThermoFisher Scientific, Promega, Qiagen и т. д.

Наш магнитный штатив **MagSorb-16** можно использовать вместе с реагентами для экстракции нуклеиновых кислот на основе магнитных частиц любых производителей, которые позволяют работать в пробирках объемом 1,5–2,0 мл.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Число гнезд	16
Объем пробирок	1.5–2 мл
Производитель пробирок	Eppendorf или эквивалент

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кат. номер 

**MagSorb-16**, магнитный штатив и держатели пробирок

BS-010601

## ПЦР анализ

Центрифугирование  
и сброс капель



**FVL-2400N**  
(пробирки)



**CVP-2**  
(ПЦР-планшеты)

Обнаружение  
ПЦР в реальном  
времени



**BioQuant-96**

Реагенты



Реагенты для амплификации \*

**НОВИНКА** BioQuant-96, Система ПЦР в реальном времени


## ОПИСАНИЕ

**BioQuant-96** – это новейший инструмент из семейства приборов Biosan для молекулярной диагностики.

В нём применены передовые технологии термоэлектрического охлаждения, совершенно новый источник света и дизайн светового пути. Уникальный метод контроля постоянного тока и 6-зонного независимого температурного контроля обеспечивает более быстрый, корректный и стабильный флуоресцентный количественный анализ продукта, сохраняя преимущество исключительной производительности при наиболее возможно низком потреблении электричества.

Доступны версии на 5 и 6 каналов. Так же доступны такие функции, как независимый температурный контроль 6 зон, хранение образцов при низкой температуре в +4°C, автоматическое осушение воздуха между блоком и крышкой а так же режим FAST (просто удостовериться в соответствии реагентов протоколам FAST)

**BioQuant-96** автоматически осуществляет регулировку чувствительности и улучшает опыт работы пользователя. Таким образом, инструмент полностью соответствует требованиям научно-исследовательских лабораторий. Наличие европейской регистрации Медицинского изделия 1 (А) класса позволяет использовать прибор в лабораториях клинической диагностики.



Кол-во образцов	0,2 мл одна пробирка, 96 × 0,2 (0,1) мл микропланшет, 8-полосные пробирки (у всех прозрачная крышка)
Динамический диапазон	1~10 <sup>10</sup> копии
Длина волны возбуждения	300–800 нм
Длина волны излучения	500–800 нм
Каналы	5
Диапазон установки температуры	4~105°C (шаг: 0.1°C)
Скорость нагревания/охлаждение	Макс 6.0 °C/c / 5.5 °C/c
Точность температуры	≤ ±0.1°C
Колебания температуры	≤ ±0.3°C
Гомогенность температуры	≤ ±0.3°C
Режим контроля температуры	Блок/6-зональный градиент
Объем образца	5~100 мкл
Диапазон градиента	1~36°C
Диапазон температуры для крышки	30~110°C (настраиваемое) предустановленное: 105°C
Повторяемость	5%
Режим сканирования	Вся плашка разом
Программа	Макс. 20 сегментов для каждой программы, макс. 99 циклов
Время непрерывной работы, не более	+
Время сканирования	5.5 с
Программное обеспечение	BioQuant-96 ПО
Операционная система	Windows 7/8/10
Необходимое программное обеспечение	Microsoft Excel
Минимальные требования к ПК	Встроенный компьютер, Touch-screen/ Память: 512 МБ, ЖД:10GB, CPU: Pentium® 4, Виртуальная память: ≥1000 МБ
Питание	100–240 В; ~50/60 Гц
Потребляемая мощность	600 Вт
Размеры (Д×Ш×В)	490 × 290 × 391 мм
Количество гнезд	USB адаптер, Bluetooth адаптер
Сертификация	CE-IVD
Интерфейс	WIN 10 на Встроенном сенсорном компьютере

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

BioQuant-96

Кат. номер

BS-050110





## Иммуноферментный анализ (ИФА)

Пробоподготовка  
в ламинарном боксе

Боксы биологической безопасности II класса



PST-60HL



PST-60HL-4



PSU-2T

Инкубация  
образцов



Аквamarin



3D-IW8

Отмывка  
(автоматическая)



FTA-1 с MA-8



FTA-2i

Отмывка  
(ручная)



HiPo MPP-96

Фотометр для  
микропланшетов  
и программа QuantAssay

+



Реагенты для ИФА\*

Измерение и Анализ

## 3D-IW8 Inteliwasher, Промыватель планшетов автоматический

Premium  
Product Class

4 CHW Logger

3D-IW8



ОПИСАНИЕ

Прибор представляет собой полностью программируемое промывочное устройство для 96 луночных планшетов и держателя слайдов с биочипами Fast Frame Multi-Slide Plate. Регулировка параметров заливки, замачивания, аспирации и встряхивания дает возможность легко настроить систему как для обработки текущих типовых программ, так и для выполнения более сложных задач.

### Прибор обеспечивает:

- Режим промывки
- Режим полоскания
- Режим перемешивания
- Перекрестную отмывку
- Возможность дополнительного перемешивания растворов во время выдержки между циклами работы
- Возможность использования планшетов различных фирм путем автоматической корректировки глубины опускания откачивающей гребенки (под различную глубину лунок планшета)
- Режим промывки как плоскдонных, так и круглодонных планшетов и стрипов
- Возможность создания собственных программ потребителя с изменяемыми параметрами
- Запоминание программ работы



 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**3D-IW8**

**3D-IW8, IVD сертифицирован**

**4 CHW Logger**


Кат. номер

BS-060102-AAI

BS-060102-IVD1

BS-060102-AK


## 3D-IW8 Inteliwasher, Промыватель планшетов автоматический

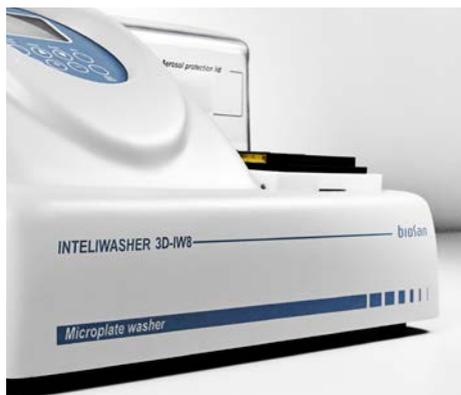

В приборе установлены 50 программ поделенных по типам аспирации (см. рисунок внизу):

- 1 **Тип 1 (1.0–1.9) IPF96 U/V** для круглодонных и V-образных планшетов, аспирация по 1 точке.
- 2 **Тип 2 (2.0–2.9) IPF96 FLAT-2** для плоскодонных планшетов, аспирация по 2 точкам.
- 3 **Тип 3 (3.0–3.9) IPF96 FLAT-C** для плоскодонных планшетов, аспирация по окружности лунки.
- 4 **Тип 4 (4.0–4.9) FastFRAME-2** для держателя слайда FAST Frame Multi-Slide Plate с квадратной геометрией лунок, аспирация по 2 точкам.
- 5 **Тип 5 (5.0–5.9) FastFRAME-C** для держателя слайда FAST Frame Multi-Slide Plate с квадратной геометрией лунок, аспирация по периметру лунки.

\* Держатель слайда FAST Frame Multi-Slide Plate или аналогичный планшет от других производителей, удерживающий стандартные стеклянные слайды (25 × 76 мм).

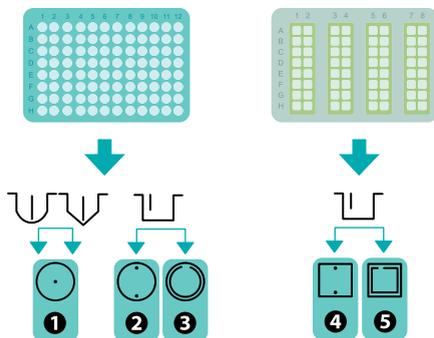

Минимальная доза	25 мкл
Максимальная доза	1600 мкл
Шаг дозирования	25 мкл
Неравномерность дозирования жидкости	±2,5%
Допускаемый остаток жидкости в лунке планшета	не более 2 мкл
Количество одновременно отмываемых лунок	8
Количество циклов отмывки	1–15
Время отбора жидкости	1–3 сек.
Время конечного отбора жидкости	1–3 сек.
Три скорости налива/откачки	
Макс. число каналов, задействованных в программе	2
Возможность промывания из трех буферов	
Время замачивания	0–300 сек. (шаг 10 сек.)
Время перемешивания	0–150 сек. (шаг 5 сек.)
Количество отмываемых рядов	1–12
Время однократной промывки планшета (300 мкл)	не более 45 сек.
Количество программ	50
Перемещение планшета и промывочной гребенки	автоматическое
Индикация режимов работ	8 строчный ЖК-дисплей
Размеры (Д × Ш × В)	375 × 345 × 180 мм
Вес прибора	9,9 кг
Прибор предназначен для использования в закрытых лабораторных помещениях при температурах от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C, линейно уменьшающейся до 50% при 35°C	
Потребляемый ток/мощность	12 В, 1,8 А/22 Вт
Внешний блок питания	вход АС 100–240 В 50/60 Гц, выход DC 12 В

Терминал контроля объема жидкости **4 CHW Logger** предназначен для установки 3 емкостей промывочных растворов и одной емкости для слива. **4 CHW Logger** снабжен весовым датчиком для определения степени заполнения емкостей.

### Спецификация 4 CHW Logger:

Макс. вес отдельной емкости	2 кг
Размеры (Д × Ш × В)	267 × 252 × 97 мм
Вес	3 кг



## Аквамарин, Промыватель планшетов автоматический



Аквамарин-Т



Терминал контроля объема жидкости **Аквамарин-Т** предназначен для установки 3 емкостей промывочных растворов и одной емкости для слива. **Аквамарин-Т** снабжен весовым датчиком для определения степени заполнения емкостей.

Время однократной промывки планшета (300 мкл) не более 45 сек.

Промывка в режимах «стрип» или «планшет»

Возможность замачивания лунок с раствором на определенное время 0–300 сек.

Регулировка интенсивности потока наполнения и аспирации с возможностью их изменения в каждом цикле конкретной программы (программирование скорости и времени)

Объем промывающего раствора на одну лунку 25–1600 мкл

Возможность работы в режиме перелива (тщательно промываются края лунок)

Остаточный объем жидкости после аспирации раствора на одну лунку не более 2 мкл

Установка и запоминание глубины текущего планшета

Встряхивание: устанавливается по времени макс. 150 сек.

Сохранение программ в памяти прибора 101 программа

Интерфейс ЖК дисплей (8-строчный) и 8 функциональных клавиш

Четыре канала: 3 — для промывочных растворов, 1 — для слива отходов

Аквамарин-Т — терминал контроля объема жидкости работает по всем четырем емкостям

В наливных бутылках № 1, 2, 3 находятся фильтры

В 5 бутылки имеется микробиологический фильтр размер 0,027 микрон

Возможность использовать любую емкость для промывающей жидкости при отключении терминала контроля объема жидкости

Удобный доступ к каналам и гребенке облегчает их очистку

Защитная крышка, предохраняющая от попадания аэрозоля и брызг в окружающее пространство

Функция промывки после работы прибора

Размеры (Д × Ш × В) 375 × 345 × 180 мм

Вес (с аксессуарами, без терминала) 9,6 кг

Низкий уровень шума — комфортные условия работы



# HiPo MPP-96, Фотометр для микропланшетов НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Микропланшетный фотометр **HiPo** – это компактное, настольное устройство для замера оптической плотности ИФА и микробиологических исследований в 96-луночных микропланшетах. Управление прибором и анализ данных происходит на компьютере. Программное обеспечение входит в стандартную комплектацию прибора. Также доступен широкий список дополнительных интерференционных фильтров (со сред. шагом 10 нм). Устройство поставляется со специальным программным обеспечением **QuantAssay**.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Измеряемая величина	поглощение света
Источник света	Светодиод, самокалибрующийся
Детектор	8 силиконовых фотодиодов
Тип планшета	96-луночные планшеты (включая стриповые планшеты)
Время измерения планшета на одной длине волны	5-8 сек.
Методы измерения	по конечной точке
Количество измерительных каналов	
Количество референтных каналов	
Диапазон измерений	0–4,3 ОП
Разрешение	0,0001 ОП
Диапазон длин волн	400–700 нм
Выбор длин волн	до 8 фильтров одновременно* 4 стандартных фильтра: 405, 450, 492 и 620 нм
Встроенный шейкер	4 скорости
Программное обеспечение	<b>QuantAssay</b>
Базовые требования к ПК	процессор Intel/AMD, ОП (RAM) 1 Гб, ОС Windows Vista/7/8/10, USB
Размеры (Д × Ш × В)	140 × 300 × 130 мм
Вес	4,6 кг
Внешний блок питания	вход AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход DC 12 В

\* — Возможно установить до 4 дополнительных фильтров по требованию клиента. Доп. фильтры доступны в двух спецификациях: с оптическим поглощением не меньше 3.5 ОП и не меньше 4.3 ОП.



Smart Plus  
Product Class



USB  
соединение



Функции программного обеспечения

### QuantAssay:

- ИФА любой сложности можно программировать через редактор методик с помощью функции Assay Editor;
- Количественный анализ: возможность установки до 20 стандартов;
- Анализы avidности/аффинности антител;
- Мультиплексные анализы до 7 анализов на одном планшете;
- Качественный анализ позволяет независимо интерпретировать до 11 типов контролей;
- Функция Best Fit позволяет автоматически выбрать самую лучшую калибровочную кривую;
- Удобный интерфейс: получите результаты в 3 клика;
- Сохранение, загрузка постановки экспериментов и их экспорт;
- Интеграция экспорта данных в Лабораторно-информационную систему (ЛИМС/LIMS);
- Создание визуальных отчетов.

### Точность (405, 450, 492, 620 нм)

0,000–2,000 ОП	≤ (0,5% ± 0,010 ОП)
2,000–3,000 ОП	≤ (1,0% ± 0,010 ОП)

### Воспроизводимость (405, 450, 492, 620 нм)

0,000–2,000 ОП	≤ (0,5% ± 0,005 ОП)
2,000–3,000 ОП	≤ (1,0% ± 0,005 ОП)

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**HiPo MPP-96** Кат. номер BS-050108-A02

Дополнительные принадлежности:

**OD Plate**, Проверочный инструмент BS-050108-AK

Доп. фильтр\* (запрашивать отдельно)



## OD Plate, Проверочный инструмент для MPP-96 HiPo




### ОПИСАНИЕ

OD Plate является инструментом проверки качества работы планшетного фотометра MPP-96 HiPo. Цель инструмента заключается в проверке точности и воспроизводимости измерений фотометра на 6 уровнях оптической плотности: 0,3; 0,6; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 ОП в видимом спектре света.


**Инструмент поставляется в ударопрочной контейнере с USB носителем, содержащим:**

- Копия результатов измерений в аккредитованной лаборатории
- Руководство пользования

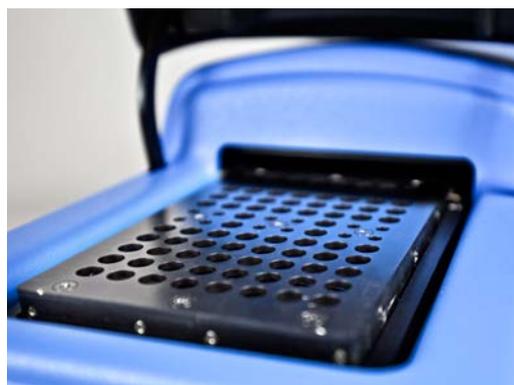

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Уровни оптической плотности	0,3; 0,6; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 ОП ( $\pm 0,1$ ОП)
Стандартный список длин волн проверки	405, 414, 450, 480, 492, 515, 540, 550, 560, 568, 580, 594, 620, 630, 650, 690, 700 нм
Размер (Д × Ш × В)	128 × 86 × 12 мм
Вес (без контейнера)	0,3 кг

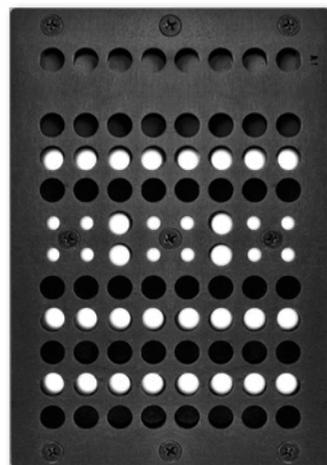

 **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:** Кат. номер

**OD Plate, Проверочный инструмент** BS-050108-AK

# как выбрать

## ШЕЙКЕР, РОКЕР, ВОРТЕКС

**bioan**

Medical-Biological  
Research & Technologies

**Объем образца**  
 **$10^3 \dots 10^2$  мл**

Колбы Эрленмейера и  
средние колбы для культивации



**PSU-20i,**  
Орбитальный шейкер

**ES-20/80**  
Орбитальный шейкер



**PSU-10i,**  
Орбитальный шейкер



**ES-20,**  
Орбитальный шейкер-инкубатор



**MR-12,**  
Рокер-шейкер

**Применение:**  
• Агглютинация  
• Окрашивание геля

**Применение:**  
• Микробиология  
• Экстракция  
• Культивирование клеток

**Объем образца**  
 **$10^1$  мл**

Чашки Петри,  
вакутайнеры и пробирки до 15 мл



**Multi RS-60,**  
Ротатор



**Bio RS-24,**  
Мини-ротатор



**RTS-1, RTS-1C,**  
Персональные биореакторы



**MR-1,**  
Мини-рокер-шейкер



**Multi Bio RS-24,**  
Ротатор

**Применение:**  
• Микробиология  
• Экстракция  
• Культивирование клеток  
• Гематология



**V-1,**  
Персональный вортекс



**MSV-3500,**  
Пробирочный вортекс

**Применение:**  
• Анализ нуклеиновых кислот  
• Генетический анализ  
• Анализ белков  
• Молекулярный анализ



**Multi Bio 3D,**  
Программируемый 3D шейкер

**Применение:**  
• Агглютинация  
• Экстракция  
• Блот-гибридизация  
• Отмывание геля

**Объем образца**  
 **$10^0 \dots 10^{-3}$  мл**

96-луночные планшеты  
для ПЦР и пробирки типа Eppendorf



**PST-60HL-4**  
Термошейкер



**PST-60HL**  
Термошейкер



**MPS-1,**  
Высокоскоростной шейкер



**TS-100, TS-100C, TS-100C Smart**  
Термошейкеры



**V-32,**  
Мульти-вортекс



**PST-100HL**  
Термошейкер



**TS-DW,**  
Термошейкер



**PSU-2T,**  
Мини-шейкер для иммунологии



**CVP-2,**  
Центрифуга-вортекс

**Применение:**  
• ИФА-анализ  
• Гибридизация  
• Генетический анализ  
• Иммунология

# COVID-19

Пандемия коронавируса (COVID-19) показывает необходимость быстрого и надёжного приготовления образцов, а также безопасной рабочей среды. Чтобы облегчить выбор продуктов, здесь показаны готовые линейки продуктов для быстрого начала анализа проб на COVID-19.

## Превентивный

### Обеззараживание



**UVR-M/UVR-Mi**  
Рециркуляторы воздуха проточные  
бактерицидные

Воздух



**PDS-250**  
Раствор для  
дезактивации ДНК/РНК

Поверхность

## Методы обнаружения на основе ИФА

### Шаги

#### Инкубация



**PST-60HL-4**  
Термошейкер  
для планшетов



**PST-60HL**  
Термошейкер  
для планшетов



**PSU-2T**  
Мини-шейкер  
для иммунологии

#### Отмывка



**Assist**  
Серия пипеток



**Assistboy**  
Пипеточный  
дозатор



**FTA-2i**  
Аспиратор  
с сосудом-ловушкой



**3D-IW8**  
Промыватель  
планшетов  
автоматический

#### Обнаружение и анализ



**HiPo MPP-96**  
Фотометр для  
микрочипов



**Quant Assay**  
ПО для HiPo MPP-96

# Ручное выделение ДНК/РНК с использованием сорбента и на колонках

Ручная пробоподготовка



Рабочая область

**UVT-S-AR**  
Бокс для стерильных работ

Ресуспензия проб и реагентов



**V-1 Plus**  
Термостат типа "Драй-блок"



**MSC-3000**  
Центрифуга-вортекс Мульти-Спин

Лизис образца



**TDB-120**  
Вортекс персональный

Отмывка образца



**FTA-2i**  
Аспиратор с сосудом-ловушкой



**Assist**  
Серия пипеток

Элюирование нуклеиновых кислот



**MagSorb 16**  
Магнитный штатив для ручного выделения нуклеиновых кислот



**Microspin 12**  
Высокоскоростная мини-центрифуга

Автоматизированная пробоподготовка



**TS-100C Smart**  
Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов



**Biomagpure 12 Plus**  
Компактная настольная роботизированная система для автоматического выделения нуклеиновых кислот (+ реагенты)

Обнаружение образца анализ

Подготовка



**CVP-2**  
Центрифугирование и встряхивание планшет



**MSC-6000**  
Центрифугирование и встряхивание пробирок

Обнаружение ПЦР в реальном времени



**BioQuant-96**  
Система ПЦР в реальном времени



**abTees COVID-19 qPCR kit**  
(Реагенты сертифицированы CE-IVD — среди наборов, внесенных в список ВОЗ.)

## Ручная и автоматическая экстракция ДНК/РНК

Дозаторы жидкостей

Серия пипеток Assist



Инкубация

TS-100, TS-100C или TS-100C Smart



Центрифугирование и осаждение

FVL-2400N



или

Ресуспендирование

MPS-1



Автоматическое выделение  
и реагенты

BioMagPure 12 Plus  
и реагенты

Центрифугирование

Microspin 12



Пробоподготовка в УФ-боксе для ПЦР

UVC/T-M-AR



Вакуумная аспирация

FTA-1



FTA-2i



Инкубация

TDB-120



Реагенты

Реагенты для выделения (по запросу)\*



## Ручная экстракция ДНК/РНК на магнитных частицах

Центрифугирование и сброс капель

FVL-2400N



Пробоподготовка в УФ-боксе для ПЦР

UVC/T-M-AR, или похожее, см. УФ-боксы для ПЦР



Перемешивание и ресуспендирование

MPS-1



V-1 plus



Multi Bio RS-24



Осаждение магнитных частиц

MagSorb-16



Центрифугирование

Microspin 12



Вакуумная аспирация

FTA-1



FTA-2i



Инкубация

TDB-120



TS-100C



Реагенты

Реагенты для выделения (по запросу)\*



ПЦР анализ

Центрифугирование  
и сброс капель



**FVL-2400N**  
(пробирки)



**CVP-2**  
(ПЦР-планшеты)

Обнаружение  
ПЦР в реальном  
времени



**BioQuant-96**

Реагенты



Реагенты для амплификации \*

## Иммуноферментный анализ (ИФА)

Пробоподготовка  
в ламинарном боксе

Боксы биологической безопасности II класса



PST-60HL



PST-60HL-4



PSU-2T

Инкубация  
образцов



Аквamarin



3D-IW8

Отмывка  
(автоматическая)



FTA-1 с MA-8



FTA-2i

Отмывка  
(ручная)



HiPo MPP-96

Фотометр для  
микропланшетов  
и программа QuantAssay

+



Реагенты для ИФА\*

Измерение и Анализ

## Культивирование бактериальных клеток

Пробоподготовка в  
ламинарном боксе

● Ламинарный бокс



ES-20



ES-20/60



ES-20/80



ES-20/80C

● Культивирование



S-Bt Smart Biotherm

● CO<sub>2</sub> культивирование

● Измерение  
концентрации клеток



Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)39-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-87  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (8452)49-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Хабаровск (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31